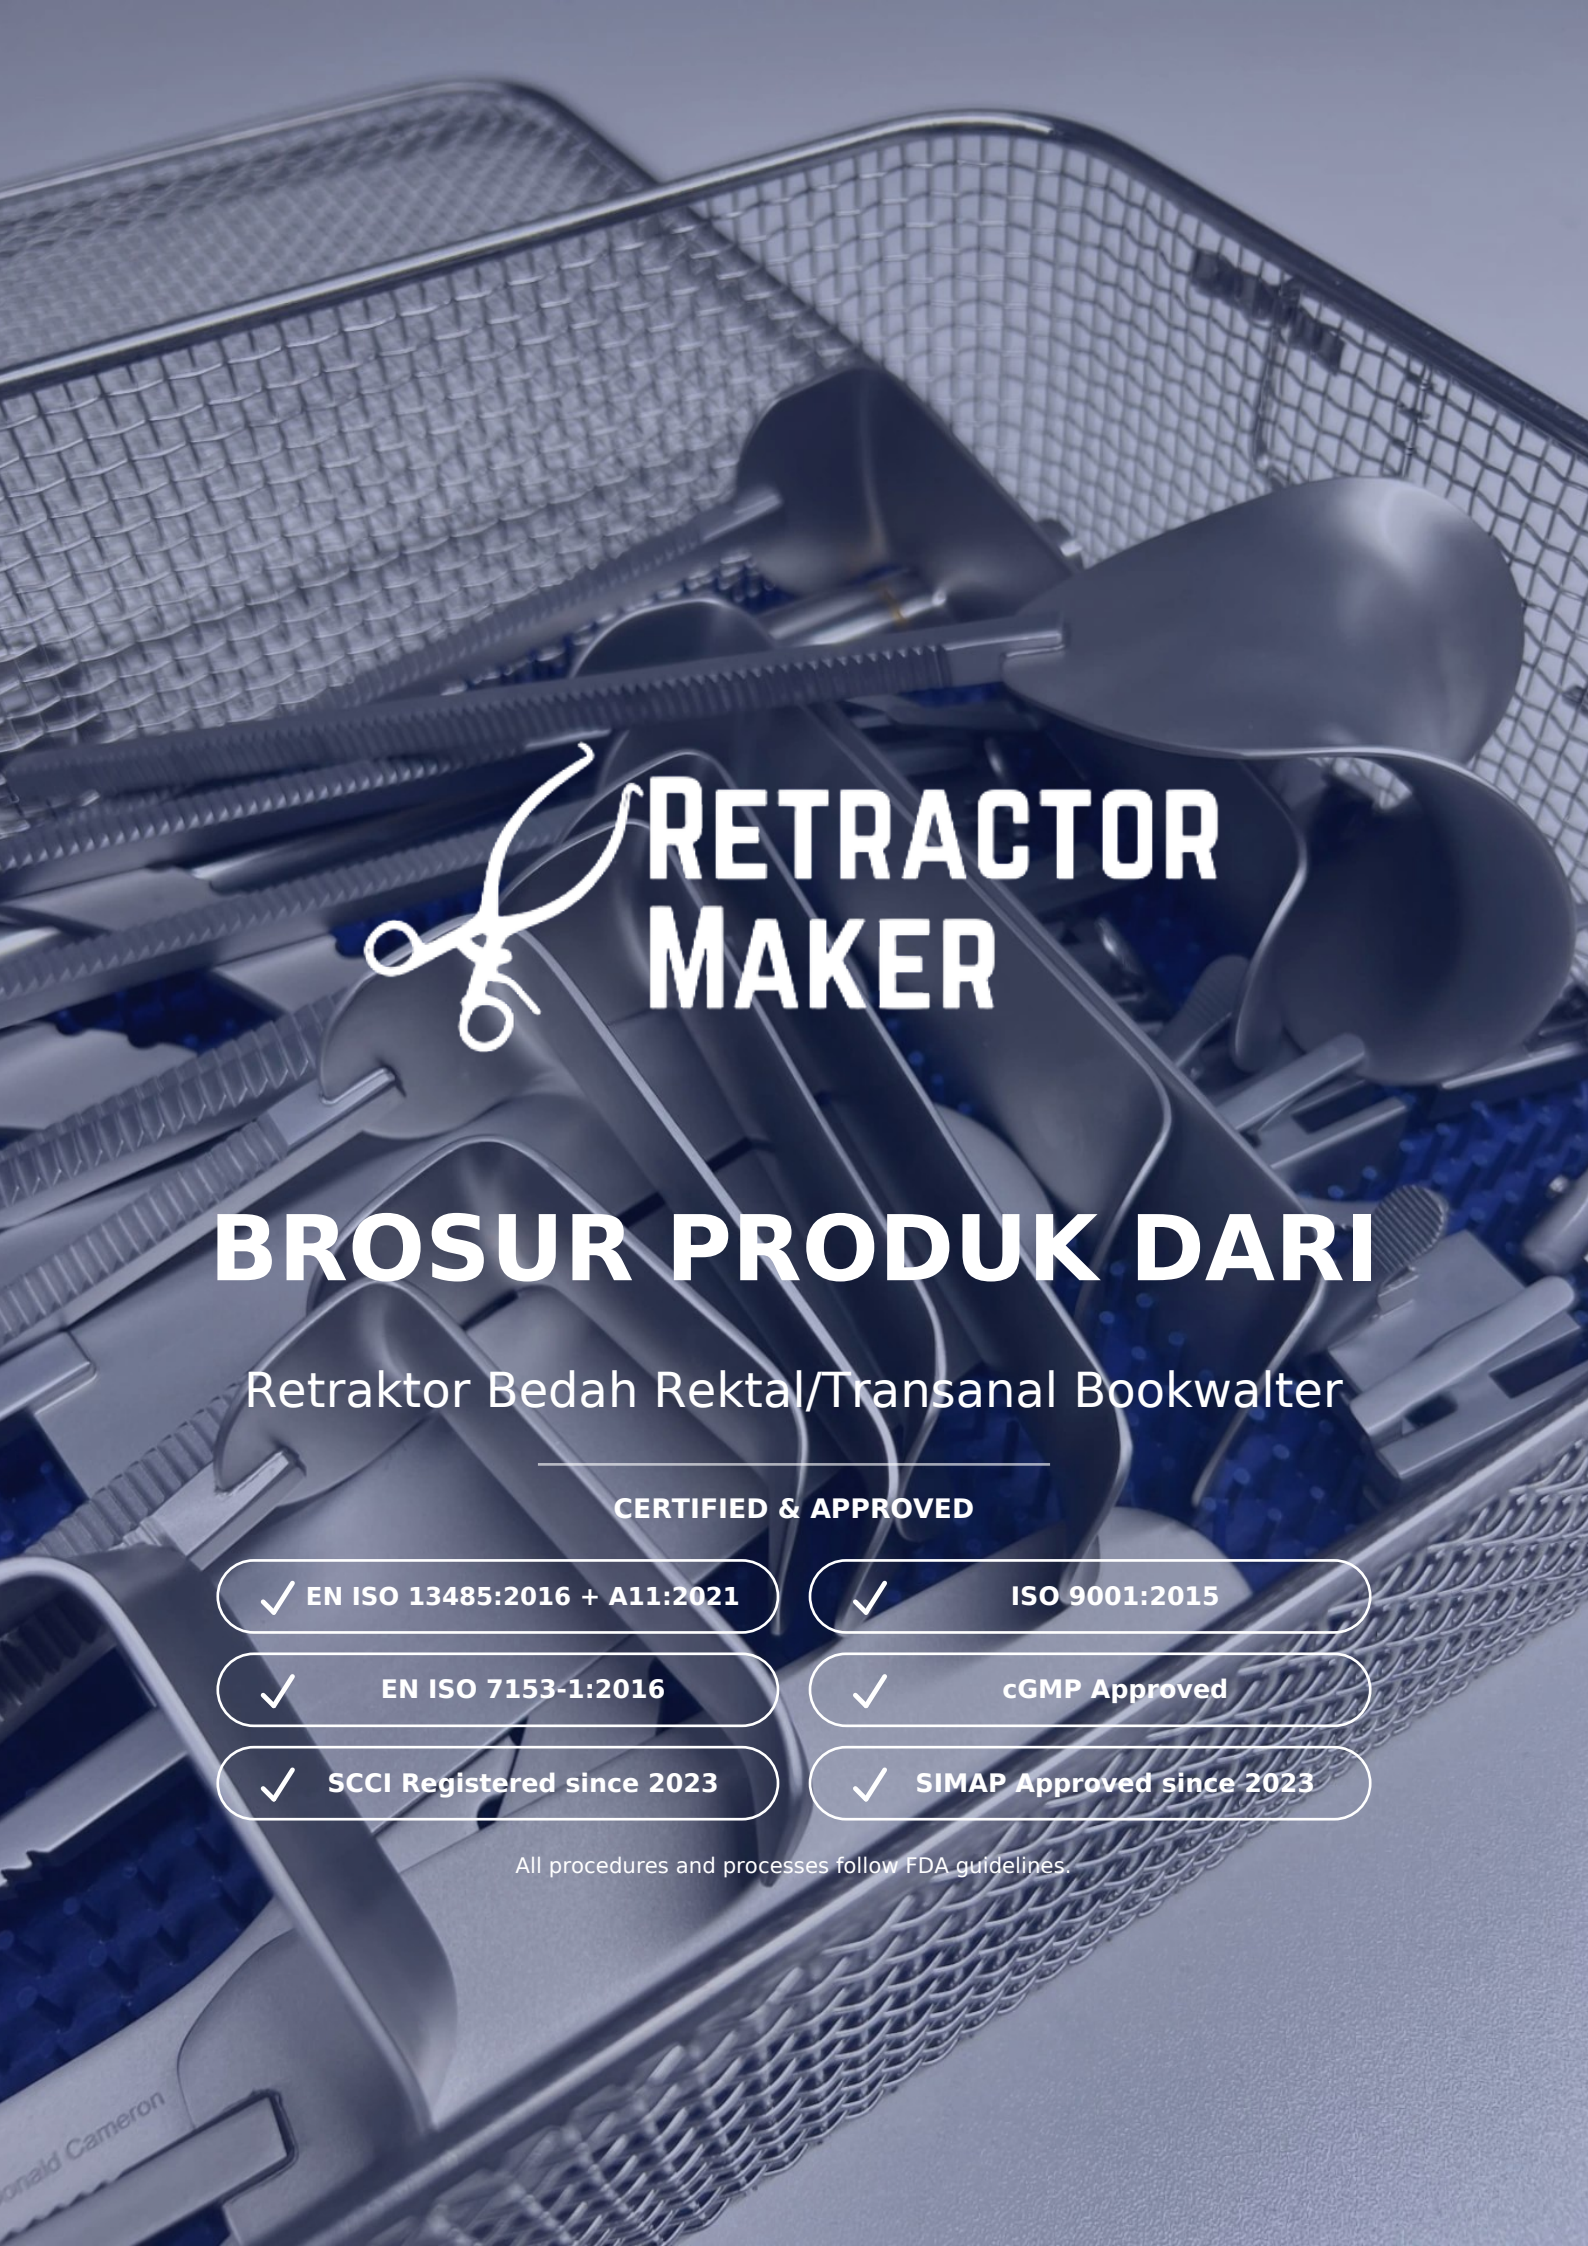


RETRACTOR MAKER


BROSUR PRODUK DARI

Retraktor Bedah Rektal/Transanal Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

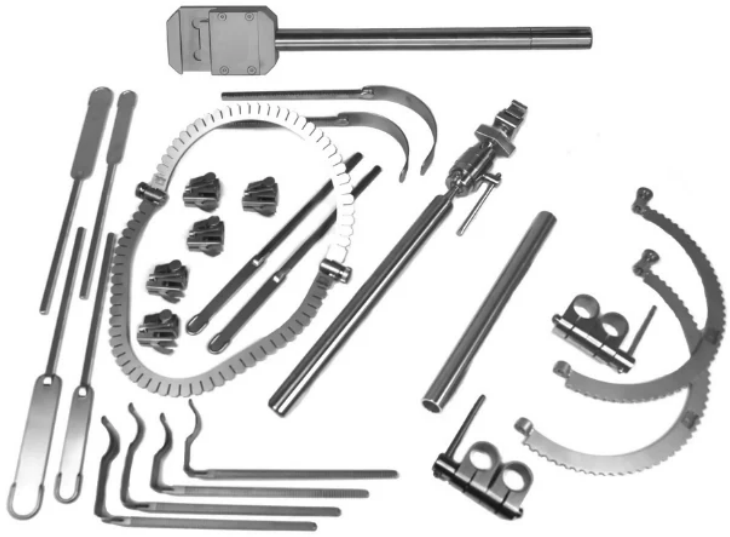

Retraktor Bedah Rektal/Transanal Bookwalter

SKU RM-BRTASR-1

$2,199 USD

DAFTAR KOMPONEN

JUMLAH	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12″ (30 cm)
2	Penghubung Tiang Baja Tahan Karat	1″ × 1″ (2.5 cm × 2.5 cm)
2	Batang Fleksibel Horizontal	Diameter 1″ (2.5 cm)
1	Batang Perpanjangan Vertikal	12″ (30 cm)
5	Mekanisme Ratchet Pengatur Kemiringan	Multi-Sudut Standar
1	Cincin Setengah Lingkaran Kecil	Diameter dalam 8½″ (21.3 cm)
1	Cincin Perineal Bersegmen	9½″ × 14½″ (23.8 cm × 36.3 cm)
2	Bilah Rektal	⅞″ × 3⅞″ (2.2 cm × 9.7 cm)
2	Bilah Rektal	⅞″ × 2⅞″ (2.2 cm × 7.2 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	1″ × 3½″ (2.5 cm × 10 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	½″ × 4″ (1.3 cm × 8.8 cm)
2	Bilah yang Dapat Dibentuk	¾″ × 4″ (1.9 cm × 10 cm)
2	Bilah Deaver	1″ × 3½″ (2.5 cm × 8.8 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung

DESKRIPSI PRODUK

Retraktor Bedah Rektal/Transanal Bookwalter adalah sistem retraktor penahan mandiri yang dipasang pada meja operasi, dirancang untuk memberikan paparan area bedah yang stabil tanpa perlu dipegang selama prosedur kolorektal, transanal, rektal, dan perineal. Rangka pemasangannya menggunakan tiang penyangga 12″ (30 cm), dua batang fleksibel horizontal berdiameter 1″, batang perpanjangan vertikal 12″ (30 cm), dan dua penghubung tiang baja tahan karat 1″ × 1″, sehingga posisi rangka dapat diatur secara fleksibel terhadap meja operasi dan posisi pasien.

Rangka kerja dapat dirakit menggunakan cincin perineal bersegmen 9½″ × 14½″ (23.8 × 36.3 cm) atau cincin setengah lingkaran kecil berdiameter dalam 8½″ (21.3 cm), sesuai pendekatan bedah. Lima mekanisme ratchet pengatur kemiringan multi-sudut standar dipasang pada cincin dan memungkinkan sudut serta tegangan setiap bilah diatur secara terpisah.

Set bilah yang disertakan memenuhi berbagai kebutuhan paparan area bedah: bilah rektal berukuran ⅞″ × 3⅞″ dan ⅞″ × 2⅞″, bilah yang dapat dibentuk berukuran 1″ × 3½″, ½″ × 4″, dan ¾″ × 4″, serta bilah Deaver berukuran 1″ × 3½″. Semua komponen dibuat dari Baja Tahan Karat AISI 304/316 Kelas Premium (Nonmagnetik) dan disediakan dalam kotak sterilisasi khusus.

Retraktor Bedah Rektal/Transanal Bookwalter disediakan dalam kondisi nonsteril, dapat digunakan kembali, dan seluruh komponennya dapat disterilkan dengan autoklaf. Retraktor Bedah Rektal/Transanal Bookwalter harus dibersihkan dan disterilkan sesuai prosedur tervalidasi fasilitas pelayanan kesehatan sebelum digunakan. Retractor Maker memproduksi sistem ini di Sialkot, Pakistan dan memasoknya langsung ke rumah sakit, dokter bedah, dan distributor.

TERIMA KASIH

Kami menantikan kesempatan untuk mendiskusikan kebutuhan retraktor bedah Anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Situs Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest