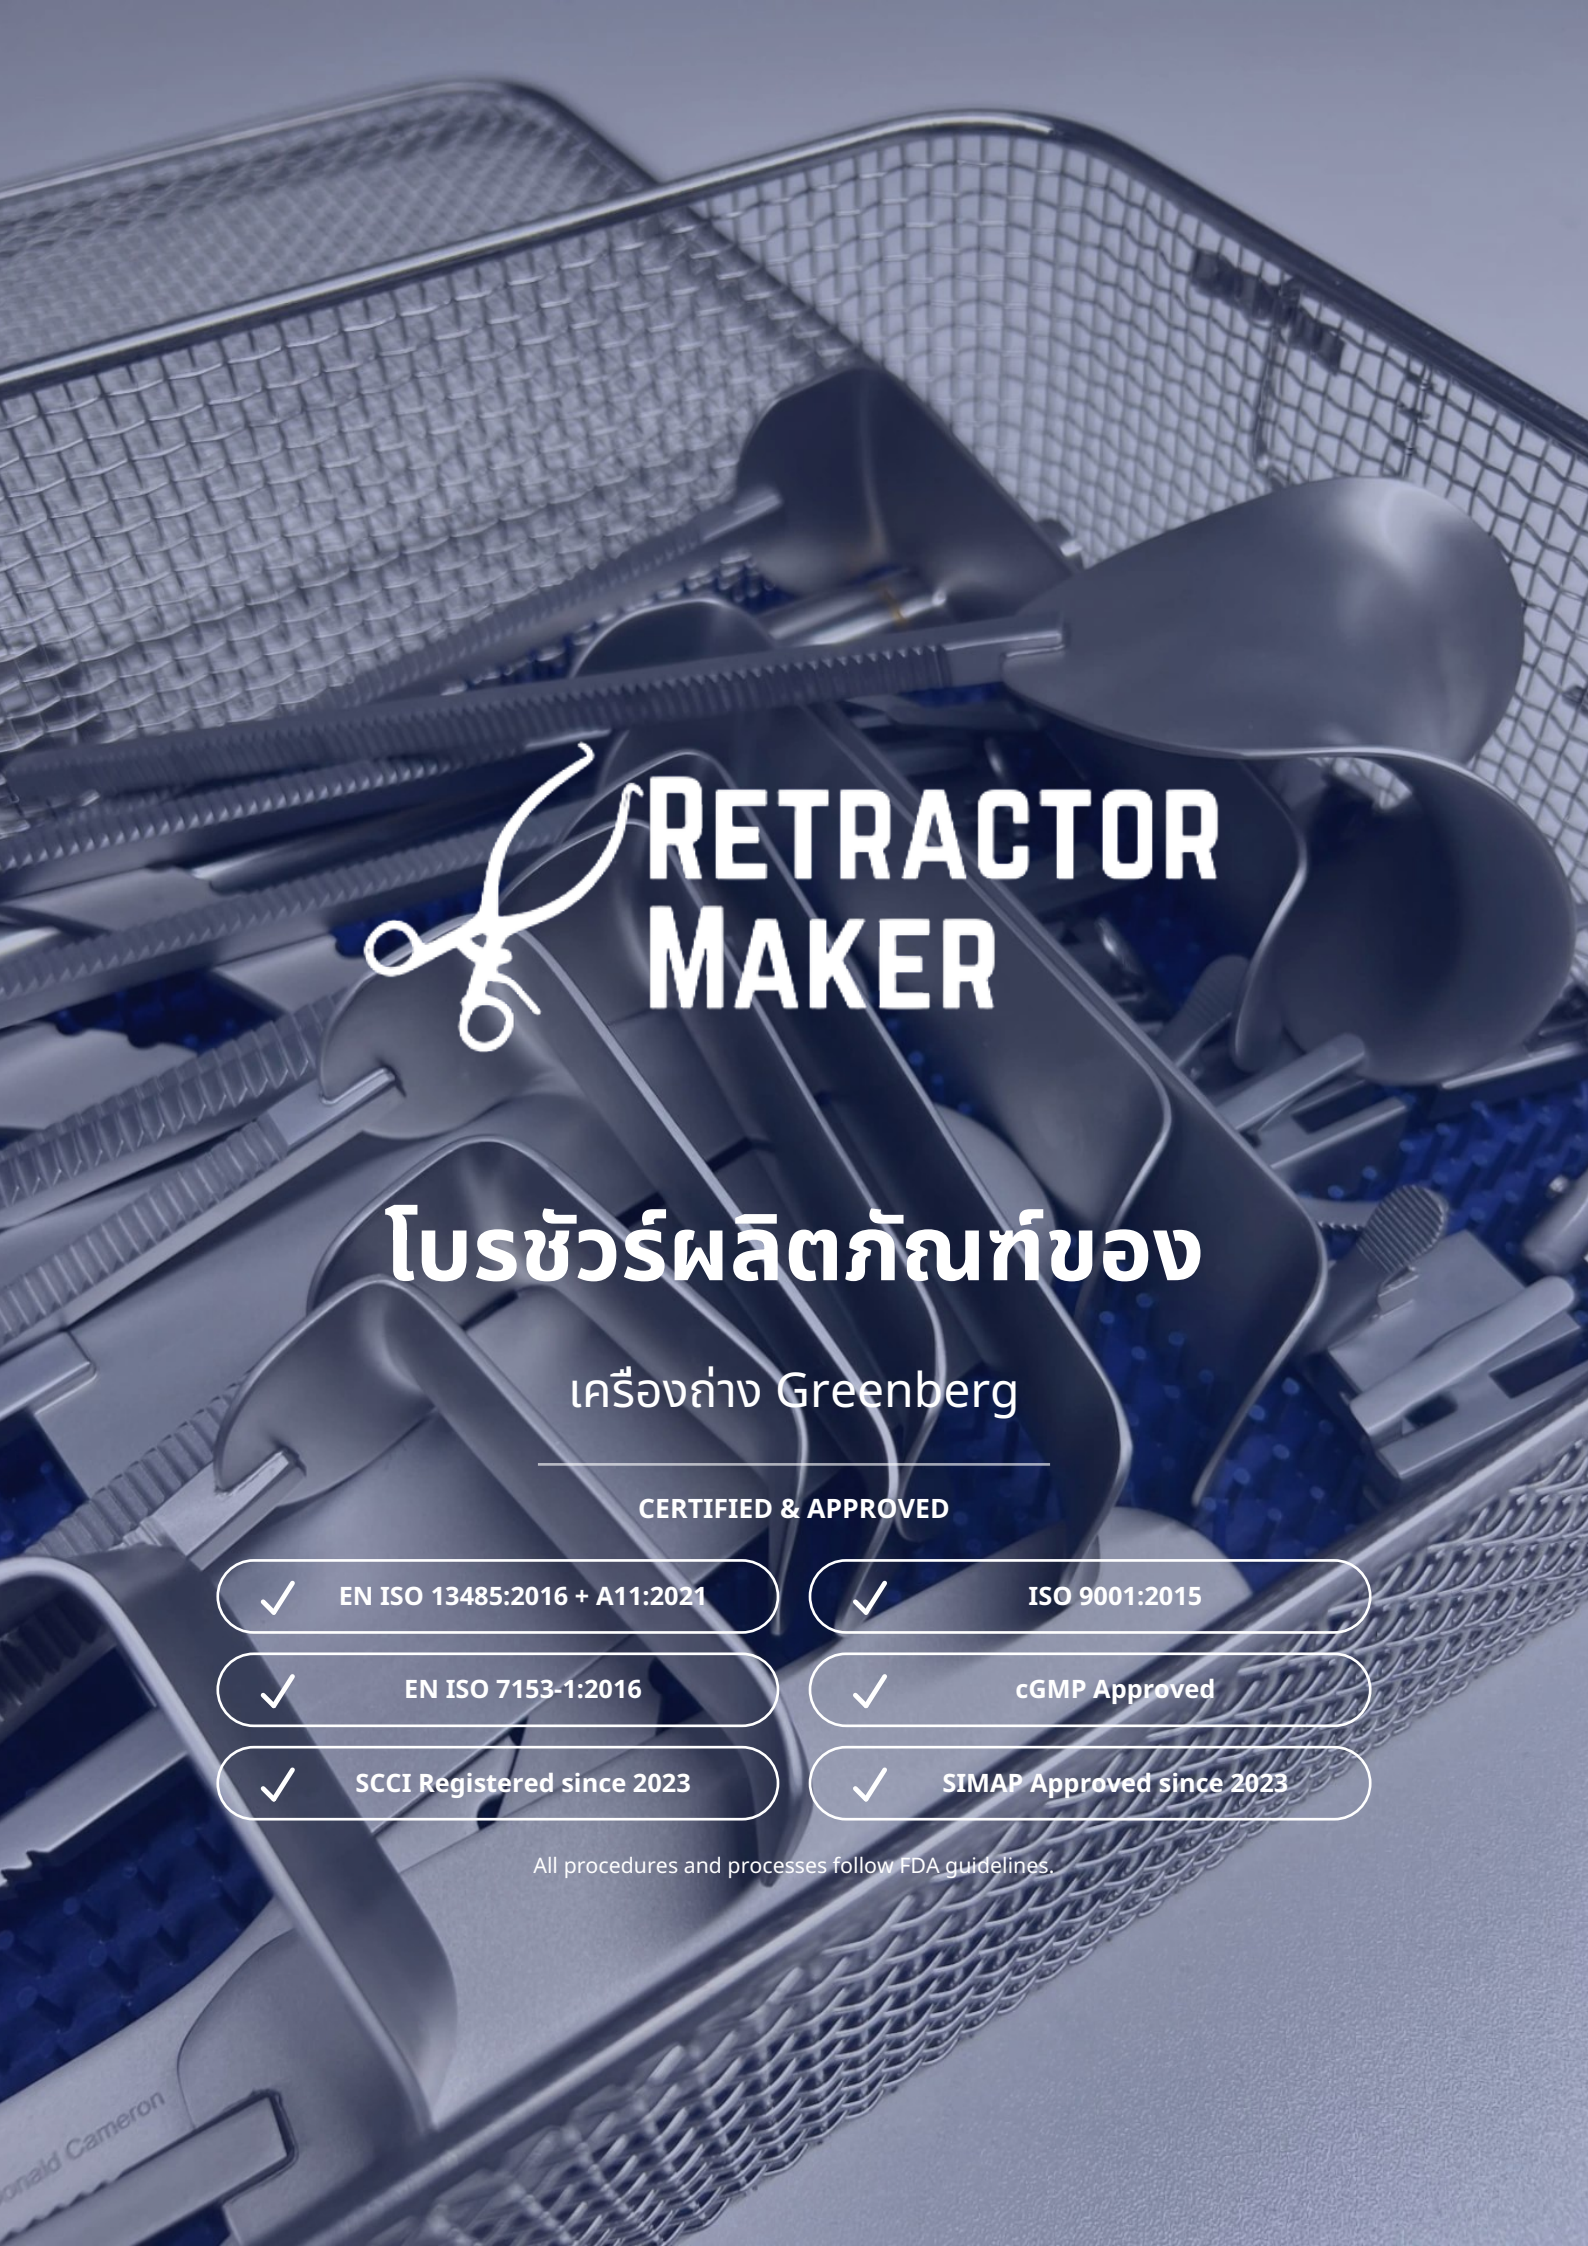


RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่าง Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

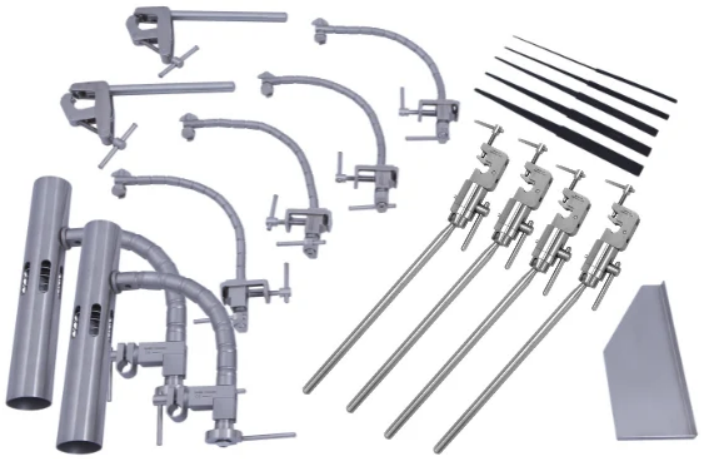

เครื่องถ่าง Greenberg

SKU RM-GR-1

$3,999 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	คานหลัก	6″ (15 cm) — ติดตั้งโดยตรงกับเสาของอุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะแบบแข็ง
4	คานรองแบบลอย	12″ (30 cm) — ขยายขอบเขตโครงรองรับด้านนอกรอบช่องเปิดกะโหลกศีรษะ
4	แขนปรับโค้งสำหรับเครื่องถ่างแบบยาว	9.5″ (24 cm) — แขนแบบหลายข้อต่อที่อาศัยแรงเสียดทานสำหรับจัดตำแหน่งใบถ่าง
2	ที่รองมือ	10″ (25 cm) — รองรับท่อนแขนเพื่อลดความเมื่อยล้าของศัลยแพทย์
1	ใบถ่างทรงเรียว	¼″ ถึง ¾″ (6 mm ถึง 19 mm) — ใบถ่างหน้ากว้างพิเศษสำหรับถ่างเปลือกสมองเป็นบริเวณกว้าง
1	ใบถ่างทรงเรียว	5/32″ ถึง ⅝″ (4 mm ถึง 16 mm) — ใบถ่างหน้ากว้างปานกลางสำหรับเข้าถึงกลีบสมองและบริเวณใต้กลีบขมับ
1	ใบถ่างทรงเรียว	⅛″ ถึง ½″ (3 mm ถึง 12.5 mm) — ใบถ่างมาตรฐานสำหรับช่องทางเข้าถึงส่วนลึกระหว่างสมองสองซีก
1	ใบถ่างทรงเรียว	3/32″ ถึง ⅜″ (2.4 mm ถึง 9 mm) — ใบถ่างทรงเรียวเล็กสำหรับช่องทางแคบบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ
1	ใบถ่างทรงเรียว	1/16″ ถึง ¼″ (1.5 mm ถึง 6 mm) — ใบถ่างขนาดเล็กสำหรับถ่างเส้นประสาท/หลอดเลือดอย่างละเอียดอ่อน
1	ถาดอะลูมิเนียมสำหรับวางแผ่นซับทางศัลยกรรมประสาท	3″ × 6¾″ (7.5 cm × 16.8 cm) — ติดตั้งกับโครงเพื่อจัดวางแผ่นซับทางศัลยกรรมประสาทให้เป็นระเบียบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	ถาดสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	17″ × 10″ × 2½″ (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — ถาดจัดเก็บเครื่องมือแบบมีรูพรุนที่แข็งแรงทนทาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่าง Greenberg เป็นระบบเครื่องถ่างสำหรับศัลยกรรมประสาทแบบครบชุดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยความสามารถในการเปิดพื้นที่ผ่าตัดแบบโมดูลาร์ที่เหนือชั้น และการยึดคงตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้มือจับระหว่างหัตถการลึกภายในกะโหลกศีรษะ โครงเครื่องถ่างหลายระดับนี้ยึดเข้ากับเสาของอุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะอย่างมั่นคง เพื่อสร้างขอบเขตพื้นที่ทำงานแบบ 3D ที่ปรับให้เหมาะกับการผ่าตัดได้โดยตรงรอบขอบช่องเปิดกะโหลกศีรษะ

ระบบเครื่องถ่าง Greenberg ครบชุดนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในจุลศัลยกรรม ประกอบด้วยคานหลักขนาด 6-inch จำนวนสองชิ้น คานรองแบบลอยขนาด 12-inch จำนวนสี่ชิ้น แขนปรับโค้งแบบข้อต่อขนาด 9.5-inch จำนวนสี่ชิ้น และที่รองมือออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ขนาด 10-inch จำนวนสองชิ้น เพื่อรองรับท่อนแขนของศัลยแพทย์ให้มั่นคง ระบบมาพร้อมใบถ่างทรงเรียวแบบสองปลายที่ดัดขึ้นรูปได้จำนวนห้าชิ้น (ตั้งแต่ใบถ่างขนาดเล็ก 1.5 mm ไปจนถึงใบถ่างหน้ากว้างสำหรับเปลือกสมองขนาด 19 mm) และถาดอะลูมิเนียมสำหรับวางแผ่นซับทางศัลยกรรมประสาทที่ติดตั้งกับโครงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

เครื่องถ่าง Greenberg ผลิตด้วยการตัดแต่งขึ้นรูปจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) พร้อมผิวด้านแบบซาตินเพื่อลดแสงสะท้อน Retractor Maker จัดส่งในสภาพไม่ปราศจากเชื้อ โดยทุกส่วนสามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันได้ บรรจุในถาดจัดเก็บเครื่องมือแบบมีรูพรุนสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อโดยเฉพาะ ขนาด 17″ × 10″ × 2½″ เพื่อความมั่นใจอย่างครบถ้วนในการผ่าตัดกะโหลกศีรษะที่ซับซ้อน

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest