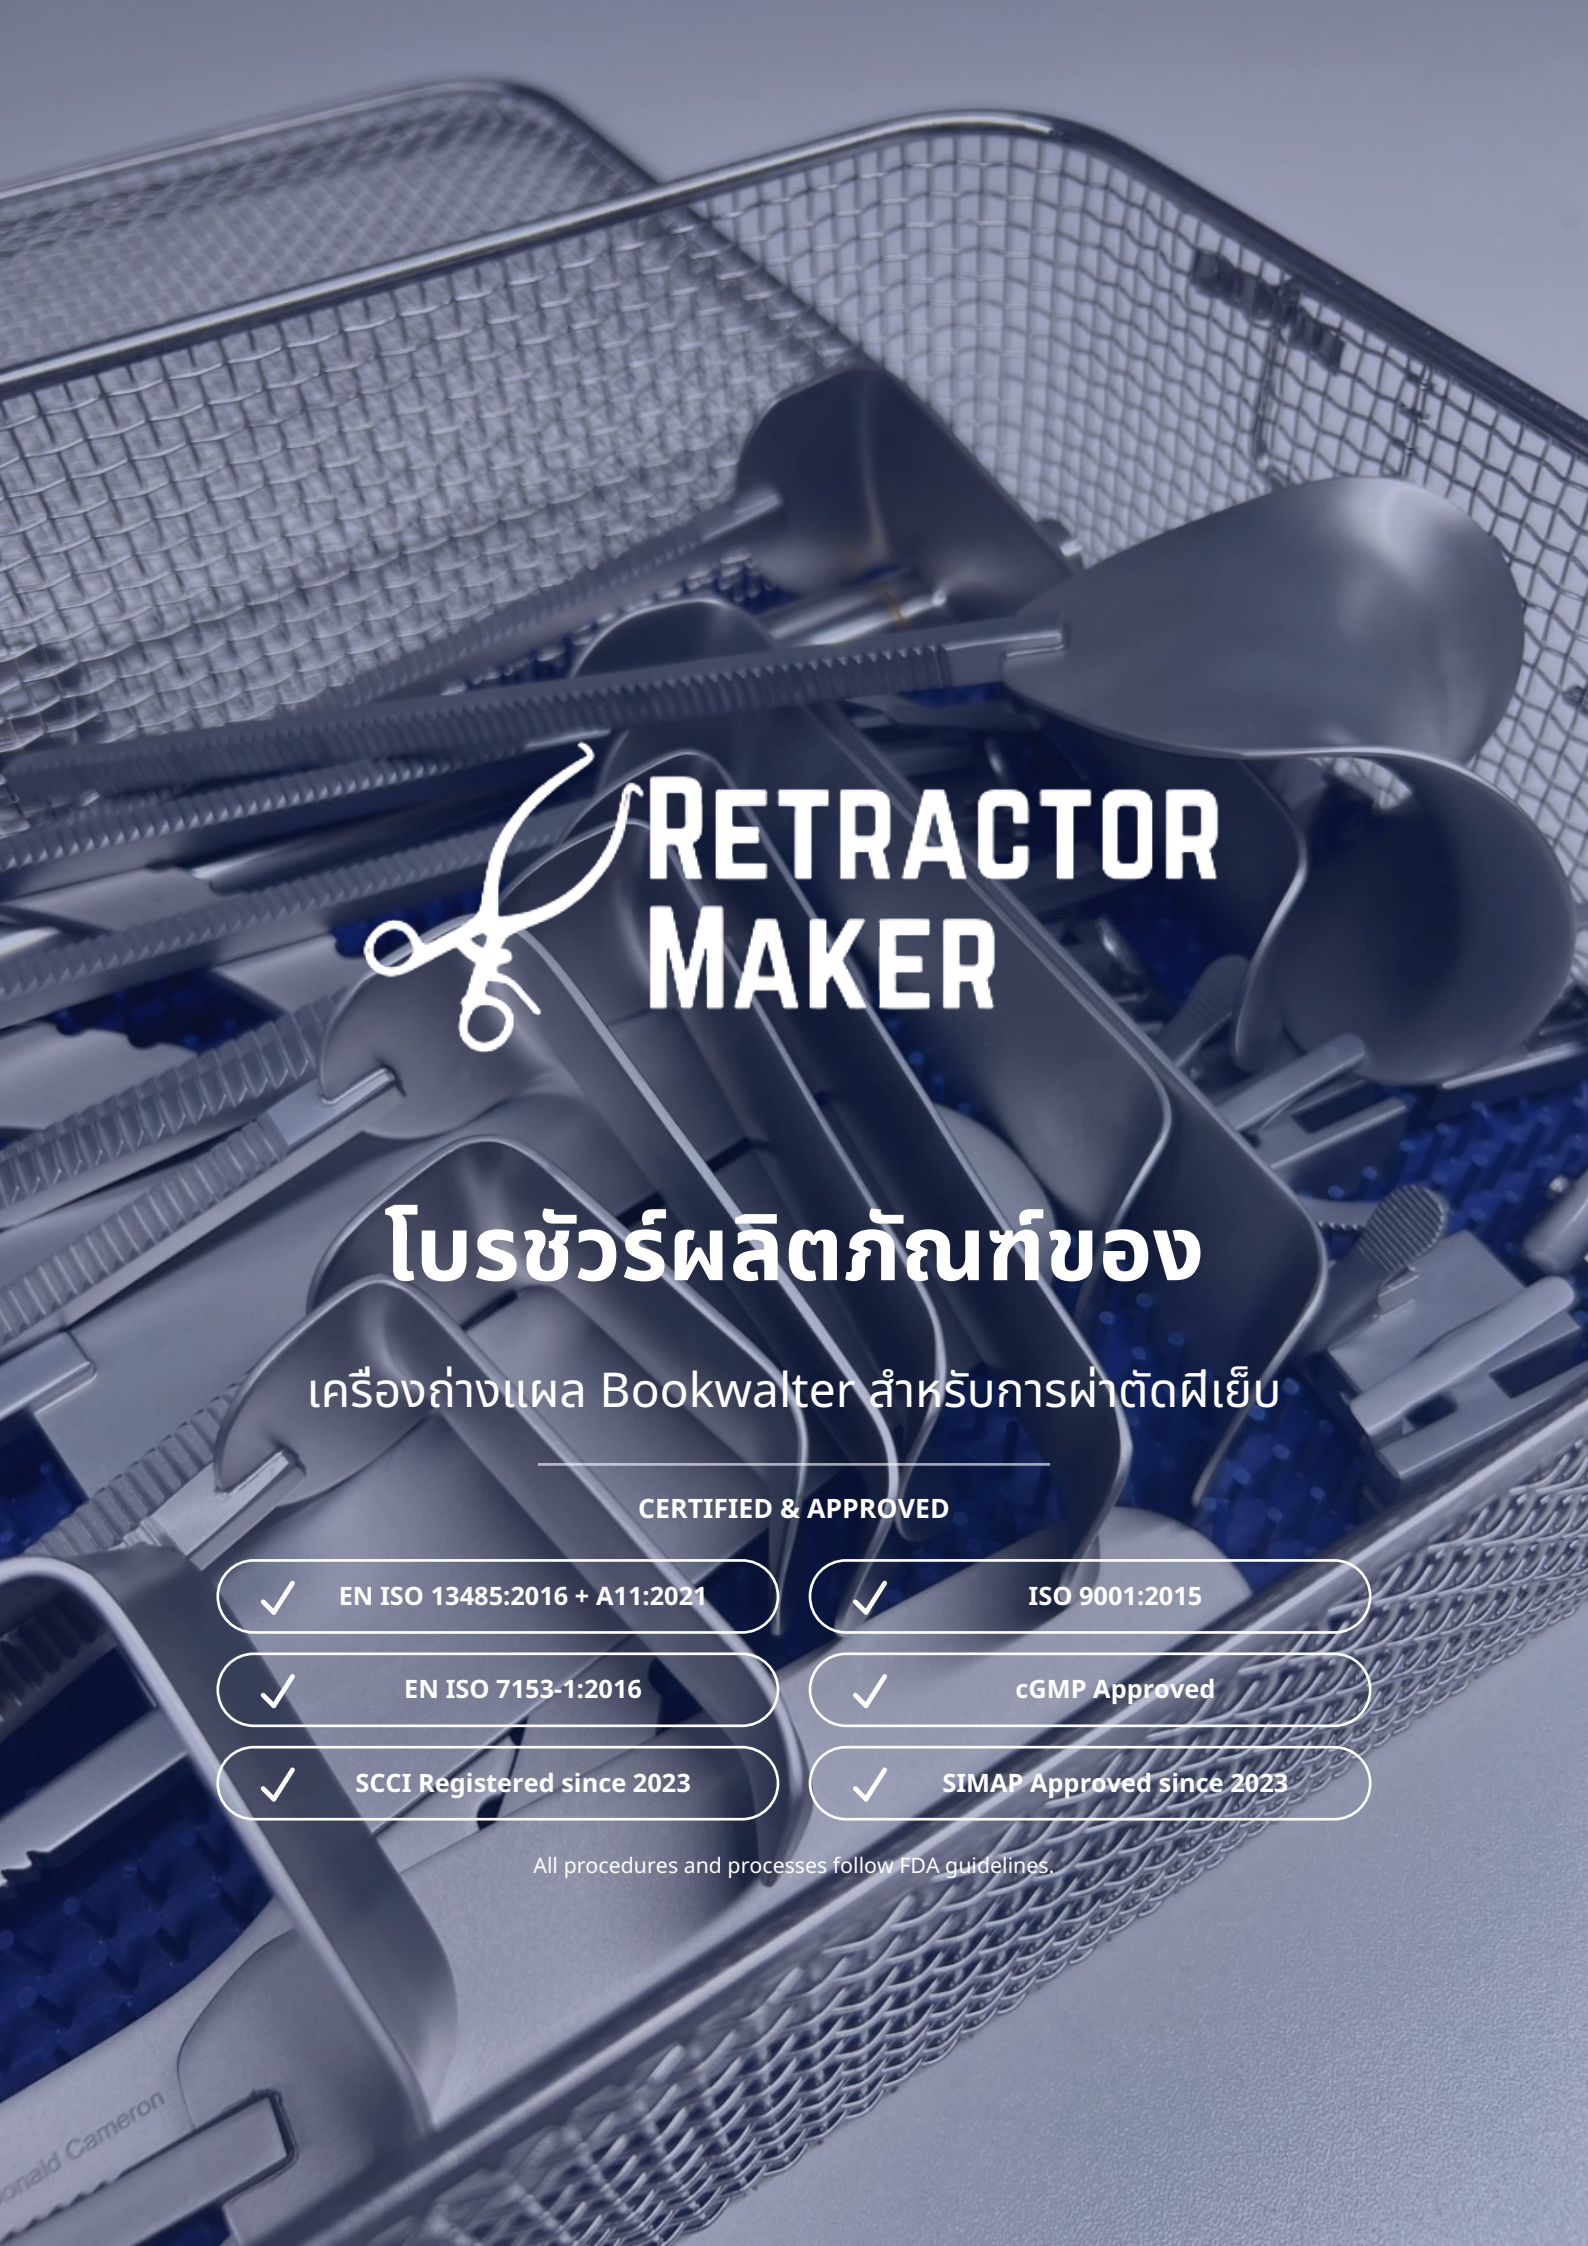


RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดฝีเย็บ

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

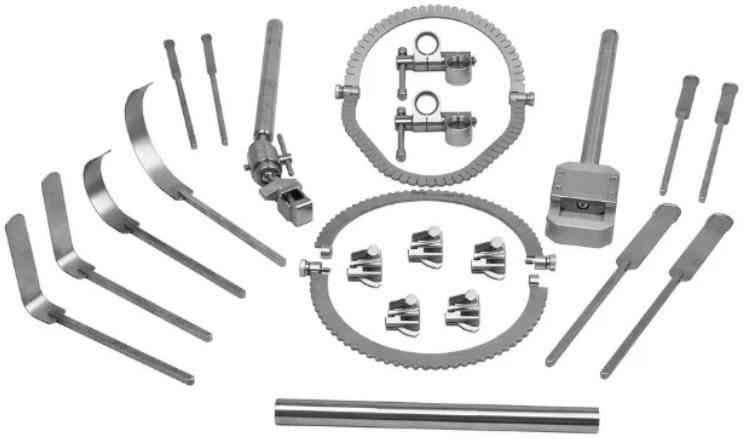

เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดฝีเย็บ

SKU RM-BPRS-1

$2,199 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสายึด	12″ (30 cm)
2	ข้อต่อเสายึด	มาตรฐาน
1	คานแนวนอน	มาตรฐาน
1	คานต่อแนวตั้ง	12″ (30 cm)
5	กลไกเฟืองล็อกปรับเอียง	แบบมาตรฐาน ปรับได้หลายมุม
1	โครงครึ่งวงกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8½″ (21.6 cm)
1	วงแหวนถ่างฝีเย็บแบบมีร่อง	9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm)
2	ใบถ่างผนังช่องคลอดด้านหลัง	1″ × 4½″ (2.5 × 11.4 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1	ใบถ่าง Deaver	1″ × 3½″ (2.5 × 8.9 cm)
2	ใบถ่างแบบดัดได้	½″ × 4″ (1.3 × 10.2 cm)
2	ใบถ่างแบบดัดได้	¾″ × 4″ (1.9 × 10.2 cm)
2	ใบถ่างแบบดัดได้	1″ × 5″ (2.5 × 12.7 cm)
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันความเสียหาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดฝีเย็บเป็นระบบถ่างแผลแบบยึดกับโต๊ะผ่าตัดและคงการถ่างได้เอง ออกแบบมาเพื่อเปิดบริเวณผ่าตัดให้เห็นได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้มือจับ ระหว่างการผ่าตัดฝีเย็บ ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง การผ่าตัดทางนรีเวช และการผ่าตัดอุ้งเชิงกราน โครงยึดประกอบด้วยเสายึดขนาด 12″ (30 cm) ข้อต่อเสายึดสองชิ้น คานแนวนอน และคานต่อแนวตั้งขนาด 12″ (30 cm) ช่วยให้เลือกยึดและจัดตำแหน่งสัมพันธ์กับโต๊ะผ่าตัดได้หลายรูปแบบ

โครงถ่างแผลประกอบด้วยวงแหวนถ่างฝีเย็บแบบมีร่องขนาด 9½″ × 14½″ (24.1 × 36.8 cm) รองรับด้วยโครงครึ่งวงกลมขนาด 8½″ (21.6 cm) กลไกเฟืองล็อกปรับเอียงได้หลายมุมจำนวนห้าชุดติดตั้งบนวงแหวน ช่วยให้ปรับมุมและความลึกของใบถ่างแต่ละชิ้นได้อย่างอิสระตามความต้องการในการเปิดบริเวณผ่าตัดที่เปลี่ยนไป

ชุดใบถ่างที่ให้มารองรับความต้องการในการเปิดบริเวณผ่าตัดที่หลากหลาย ได้แก่ ใบถ่างผนังช่องคลอดด้านหลังสองชิ้น ใบถ่าง Deaver สองชิ้นที่มีความยาว 5″ และ 3½″ และใบถ่างแบบดัดได้หกชิ้นในขนาด ½″ × 4″, ¾″ × 4″ และ 1″ × 5″ ส่วนประกอบทั้งหมดผลิตจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) และจัดส่งในกล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อโดยเฉพาะ

เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดฝีเย็บจัดส่งในสภาพไม่ปราศจากเชื้อ สามารถใช้ซ้ำและนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้ทุกส่วน ต้องทำความสะอาดและทำให้เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับการผ่าตัดฝีเย็บปราศจากเชื้อตามขั้นตอนที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของสถานพยาบาลก่อนใช้งาน Retractor Maker ผลิตระบบนี้ในเมืองเซียลโกต ประเทศปากีสถาน

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest