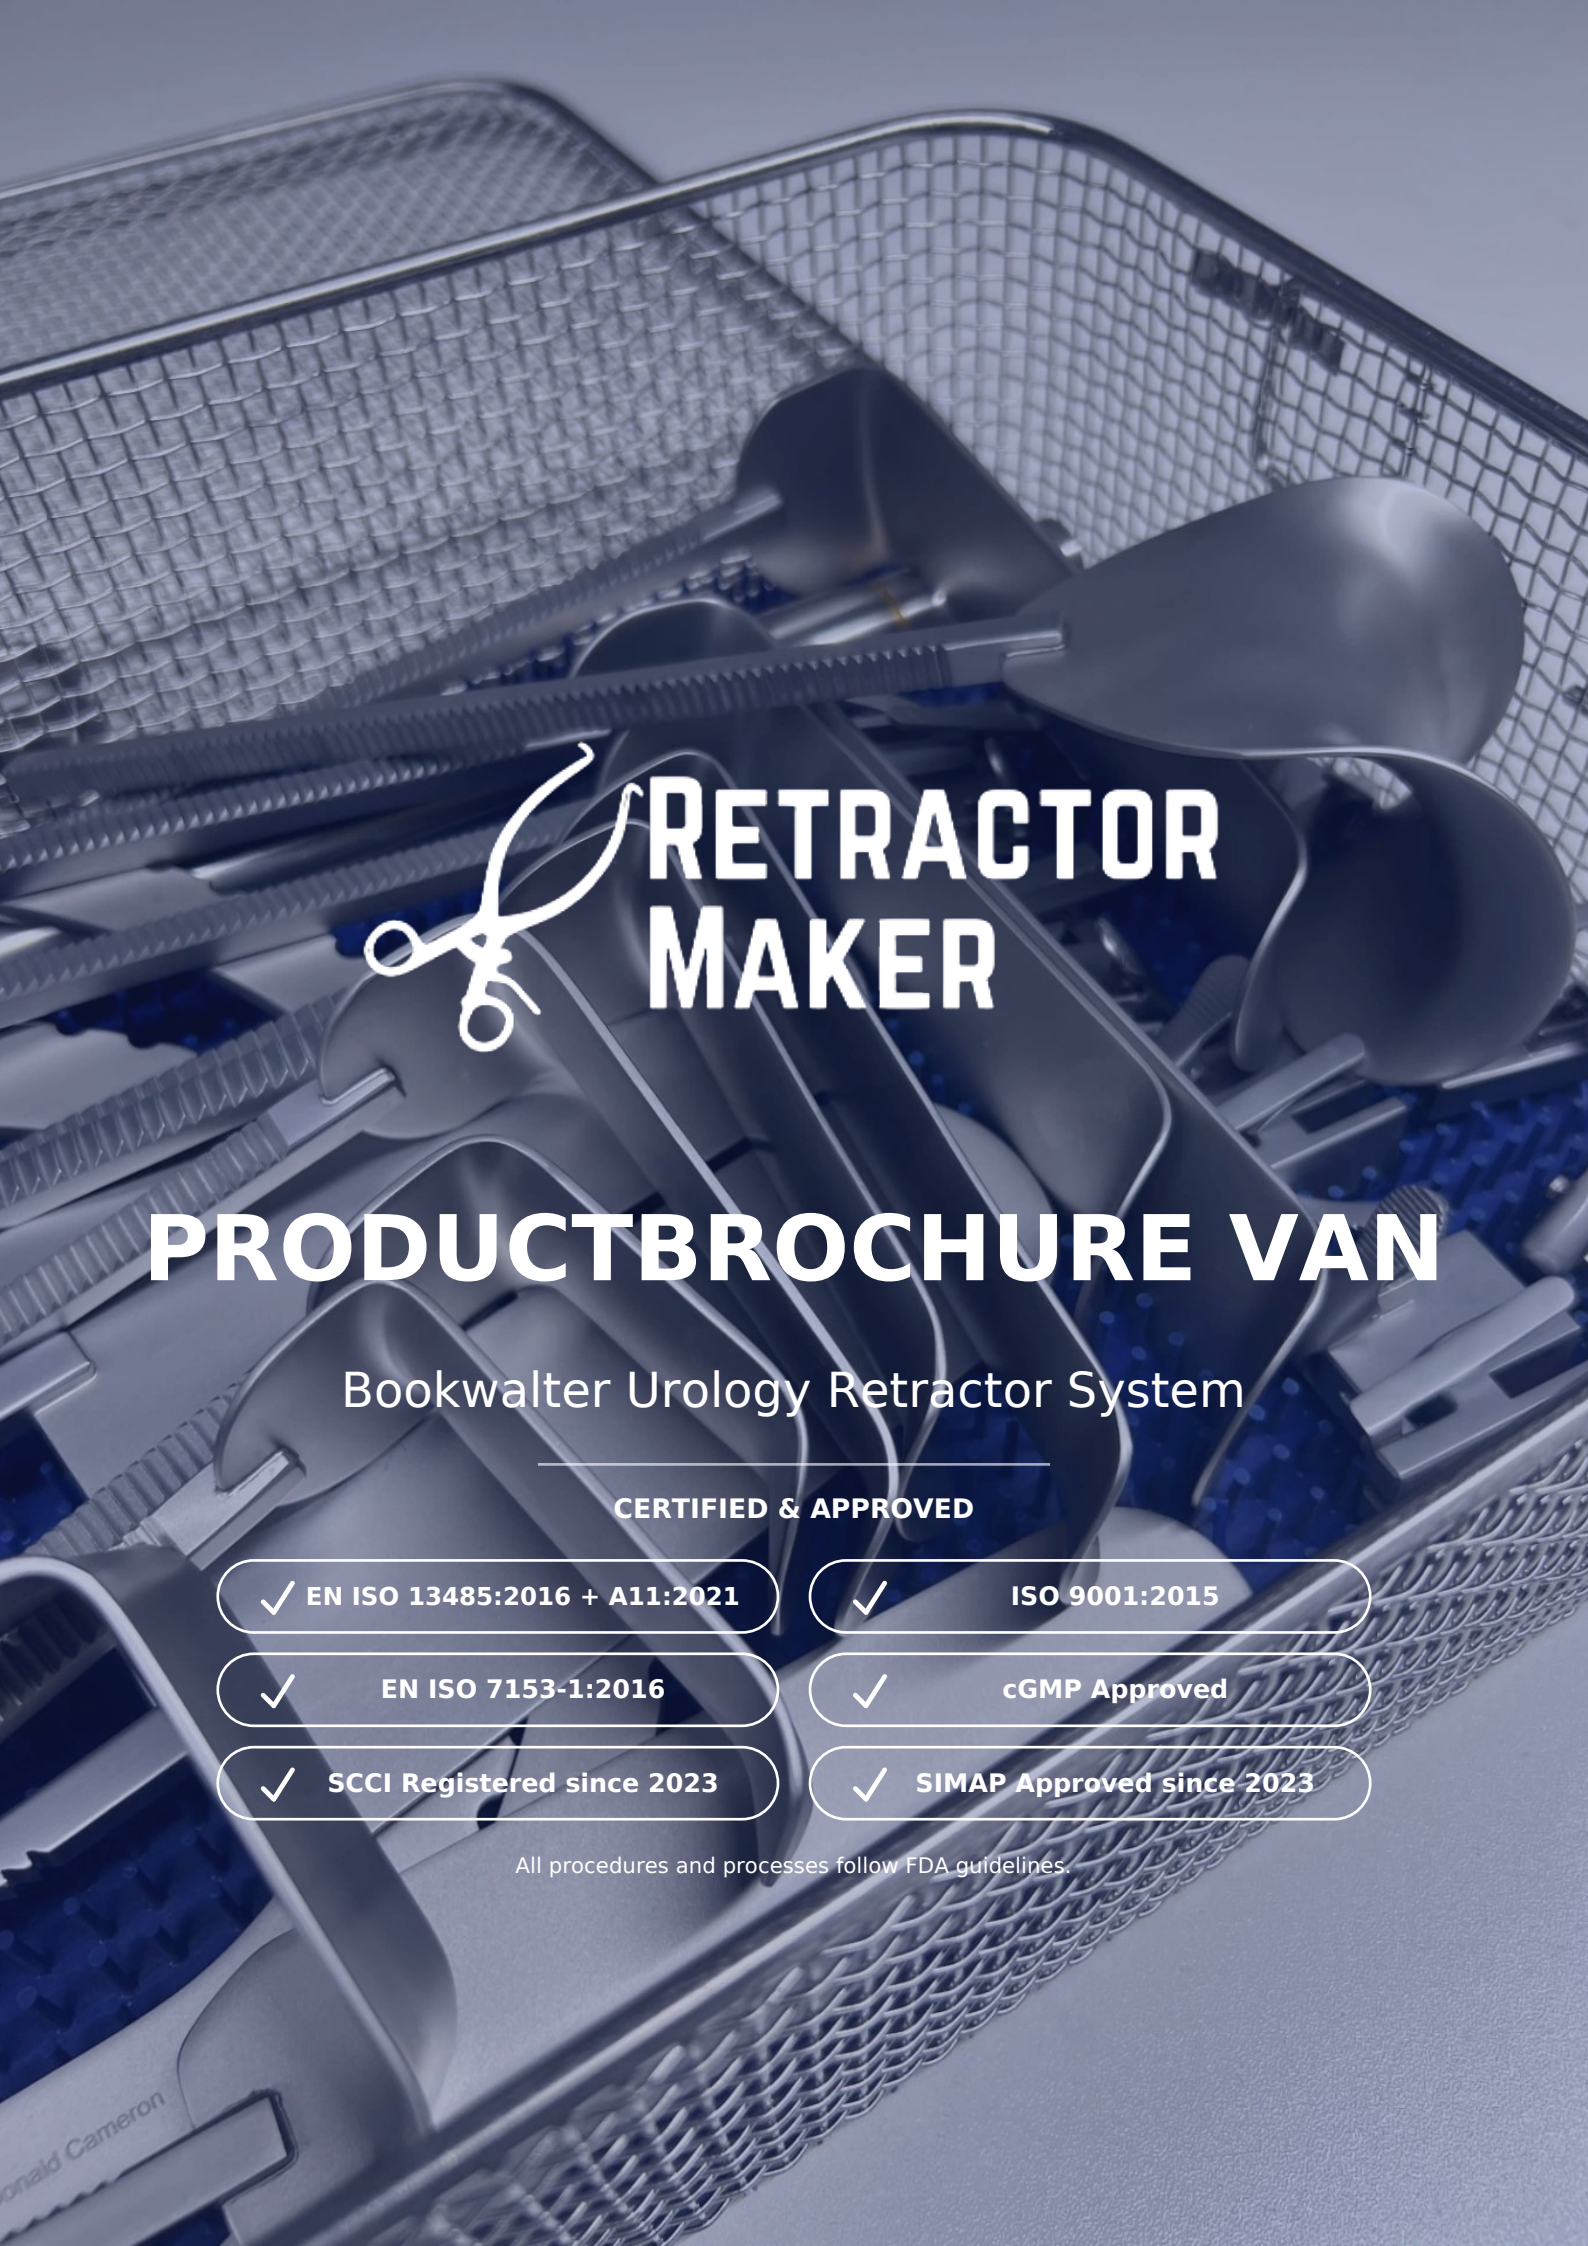


RETRACTOR MAKER


PRODUCTBROCHURE VAN

Bookwalter Urology Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

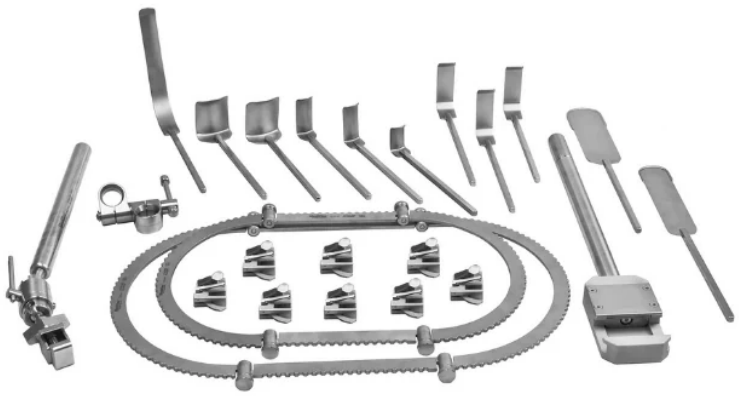

Bookwalter Urology Retractor System

SKU RM-BURS-1

$2,399 USD

COMPONENTENLIJST

AANTAL	COMPONENT	AFMETINGEN / OMSCHRIJVING
1	Statiefstaaf	12″ (30.5 cm)
1	Staafkoppeling	Standaard
1	Horizontale Flexarm	1″ diameter (2.5 cm)
8	Kantelbare ratelmechanismen	Meerhoekig
1	Gesegmenteerde ring	10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1	Gesegmenteerde ring	8½″ × 14″ (21.6 × 35.6 cm)
1	Buigbare klep	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	Buigbare klep	1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
2	Kelly-kleppen	1″ × 2½″ (2.5 × 6.4 cm)
1	Kelly-klep	1″ × 1½″ (2.5 × 3.8 cm)
2	Kelly-kleppen	2″ × 2½″ (5.1 × 6.4 cm)
3	Vaginal-Lateral-kleppen	1″ × 3″ (2.5 × 7.6 cm)
1	Renal Wylie Valve	1″ × 7″ (2.5 × 17.8 cm)
1	Sterilisatiebox	Beschermende container

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het Bookwalter Urology Retractor System is een aan de tafel gemonteerd, zelfhoudend retractorsysteem dat is ontwikkeld voor een stabiele, handsfree expositie bij abdominale en flankbenaderingen van nieren, ureters, blaas en retroperitoneale urologische structuren. Het Bookwalter Urology Retractor System wordt aan de operatietafel bevestigd met een 12″ (30.5 cm) statiefstaaf, een standaard staafkoppeling en een horizontale Flexarm met een diameter van 1″ (2.5 cm).

Er worden twee gesegmenteerde ringen meegeleverd – 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm) en 8½″ × 14″ (21.6 × 35.6 cm) – zodat het frame optimaal kan worden aangepast aan de incisie en de patiënt. Acht kantelbare meerhoekige ratelmechanismen fixeren de kleppen aan de ring en maken een onafhankelijke instelling van de retractiediepte en de hoek van de klep mogelijk.

Het instrumentarium dekt diepe en oppervlakkige exposities af: buigbare kleppen in 2″ × 6″ en 1½″ × 6″, Kelly-kleppen in de maten 1″ × 2½″, 1″ × 1½″ en 2″ × 2½″, drie 1″ × 3″ Vaginal-Lateral-kleppen en één 1″ × 7″ Wylie-nierklep. Alle componenten zijn vervaardigd uit niet-magnetisch, Hoogwaardig AISI 304/316 roestvrij staal (niet-magnetisch) en worden geleverd in een sterilisatiecontainer.

Het Bookwalter Urology Retractor System wordt niet-steriel geleverd, is herbruikbaar, volledig autoclaveerbaar en moet vóór gebruik worden gereinigd en gesteriliseerd volgens de gevalideerde procedures van uw instelling. Retractor Maker produceert en levert de set rechtstreeks vanuit Sialkot, Pakistan.

DANK U

We kijken ernaar uit om uw vereisten voor chirurgische retractoren te bespreken.

NEEM CONTACT OP MET RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

VOLG ONS

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest