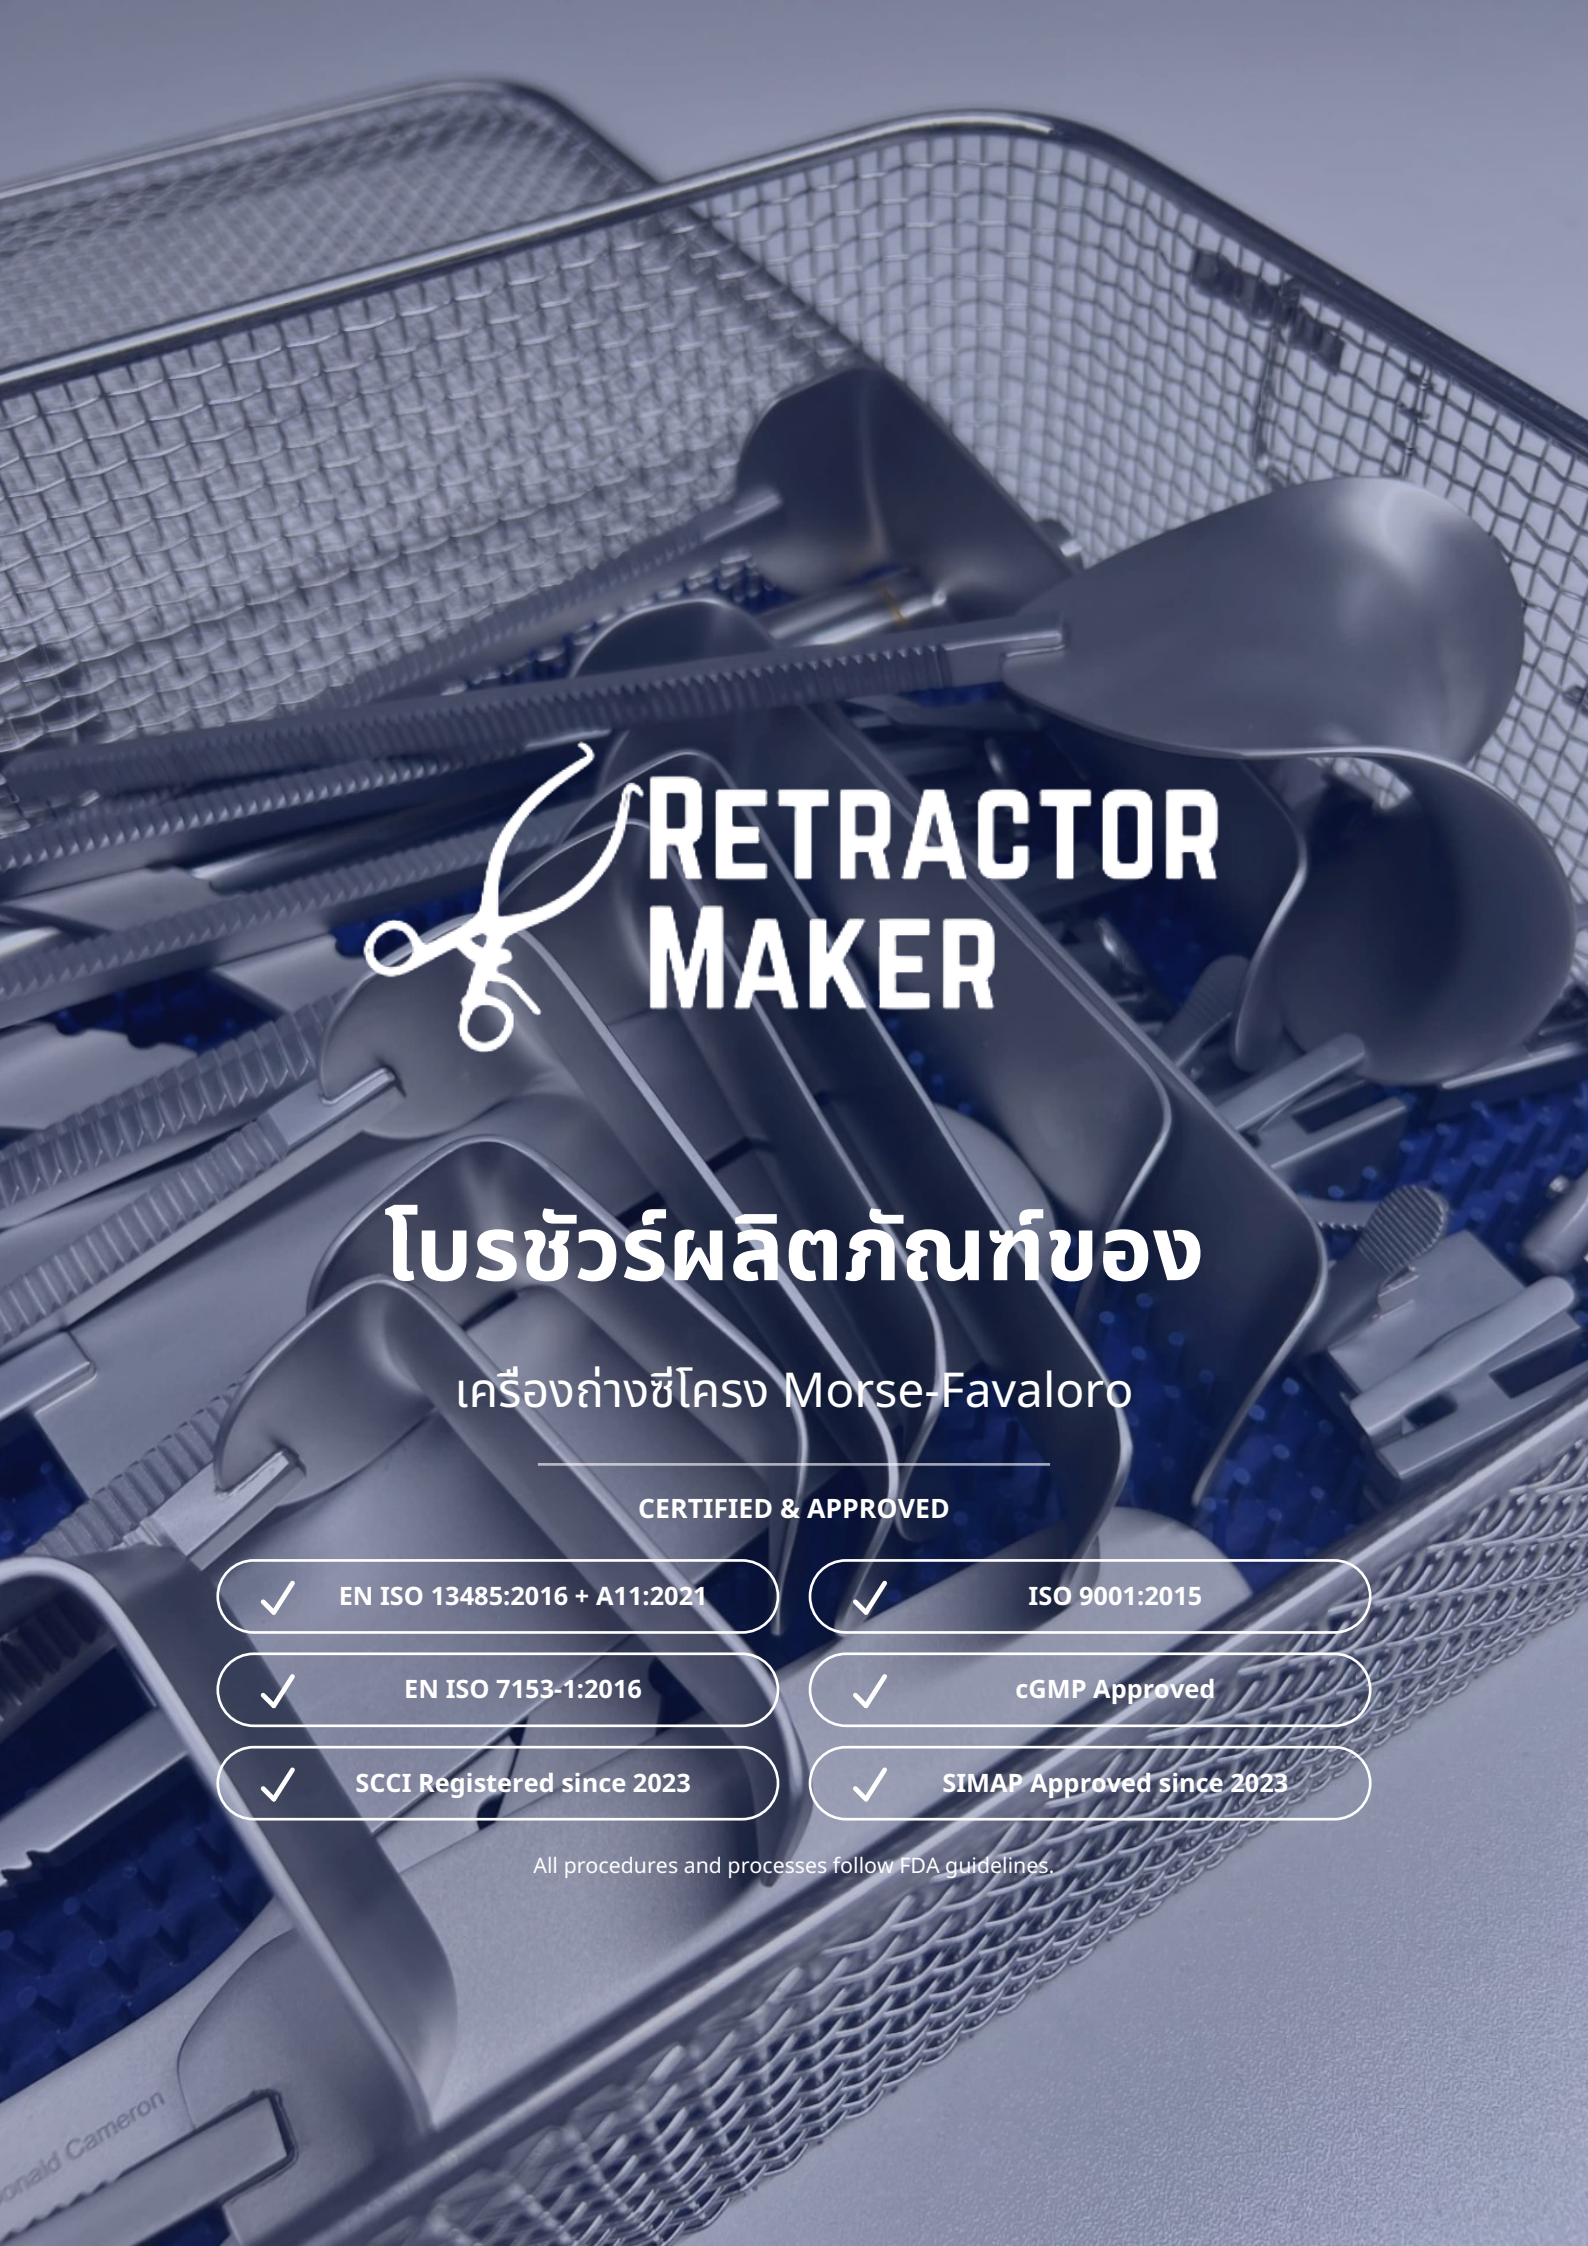


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างซีโครง Morse-Favaloro

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างซีโครง Morse-Favaloro

SKU RM-MFRS-160-1

$269 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	โครงรางนำเลื่อนขนาน	รางนำอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาทีทำหน้าทีเป็นโครงสำหรับการขยายระยะถ่าง
4 (2 คู่)	ใบถ่างด้านข้างแบบทำมุมและขยับได้	ใบถ่างสีใบขนาด 17 mm × 22 mm ปรับได้หลายตำแหน่งเพื่อให้สอดรับกับซีโครง
1	สกรูเกลียวหมุนล็อก	โบลต์ล็อกในตัวทียึดใบถ่างให้อยู่ทีระยะถ่างทีเหมาะสม
2	แขนคีมถ่างออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์	ก้านด้ามอะลูมิเนียมแบบเรียว ออกแบบให้มีขอบด้านนอกเรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บ / กล่องป้องกันความเสียหาย	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างซีโครง Morse-Favaloro เป็นเครื่องมือถ่างแผลทีสำคัญสำหรับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่างแยกซีโครงให้สอดรับกับแนวโค้งอย่างปลอดภัย และเปิดพื้นทีด้านหน้าทรวงอกระหว่างการผ่าตัดฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดหัวใจและหัตถการทีปอด ด้วยใบถ่างแบบขยับได้หลายตำแหน่ง เครื่องมือนีช่วยให้ใบถ่างด้านข้างหมุนและปรับแนวให้เข้ากับความโค้งของซีโครงผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ กระจายแรงถ่างอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการช้ำเฉพาะจุดของเยื่อหุ้มกระดูกหรือการหักของซีโครง

เครื่องถ่างซีโครง Morse-Favaloro รุ่นนีออกแบบเพื่อการควบคุมทีละเอียดแม่นยำระหว่างผ่าตัด มีระยะถ่างโดยรวมในแนวนอน 160 mm ($269)
ใบถ่างผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ติดตั้งบนรางนำอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา
ใบถ่างด้านข้างแบบขยับได้มีขนาด 17 mm × 22 mm ออกแบบให้ปรับรับกับกระดูกได้อย่างแม่นยำ
ทั้งในโครงทรวงอกทั่วไปและโครงทรวงอกทีบอบบาง ใบถ่างแบบขยับได้ทั้งสีใบ (สองใบต่อก้าน)
ล็อกค้างทีระยะถ่างทีเหมาะสมด้วยสกรูเกลียวหมุนล็อกในตัว ส่วนก้านด้ามอะลูมิเนียมแบบเรียวมีขอบด้านนอกเรียบเพื่อปกป้องเนื้อเยื่ออ่อนข้างเคียง

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างซีโครง Morse-Favaloro ด้วยการขึนรูปและตกแต่งผิวด้านแบบซาตินเพื่อลดแสงสะท้อน ออกแบบให้ทนต่อรอบการนึงฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟซ้ำ ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อให้ศูนย์ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด คลินิกศัลยกรรมทรวงอก

และห้องผ่าตัดหัวใจทั่วโลกได้รับเครื่องมือที่มีความมั่นคงเชิงกลสูง ทนต่อการกัดกร่อน และทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟได้ทั้งชิ้น

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest