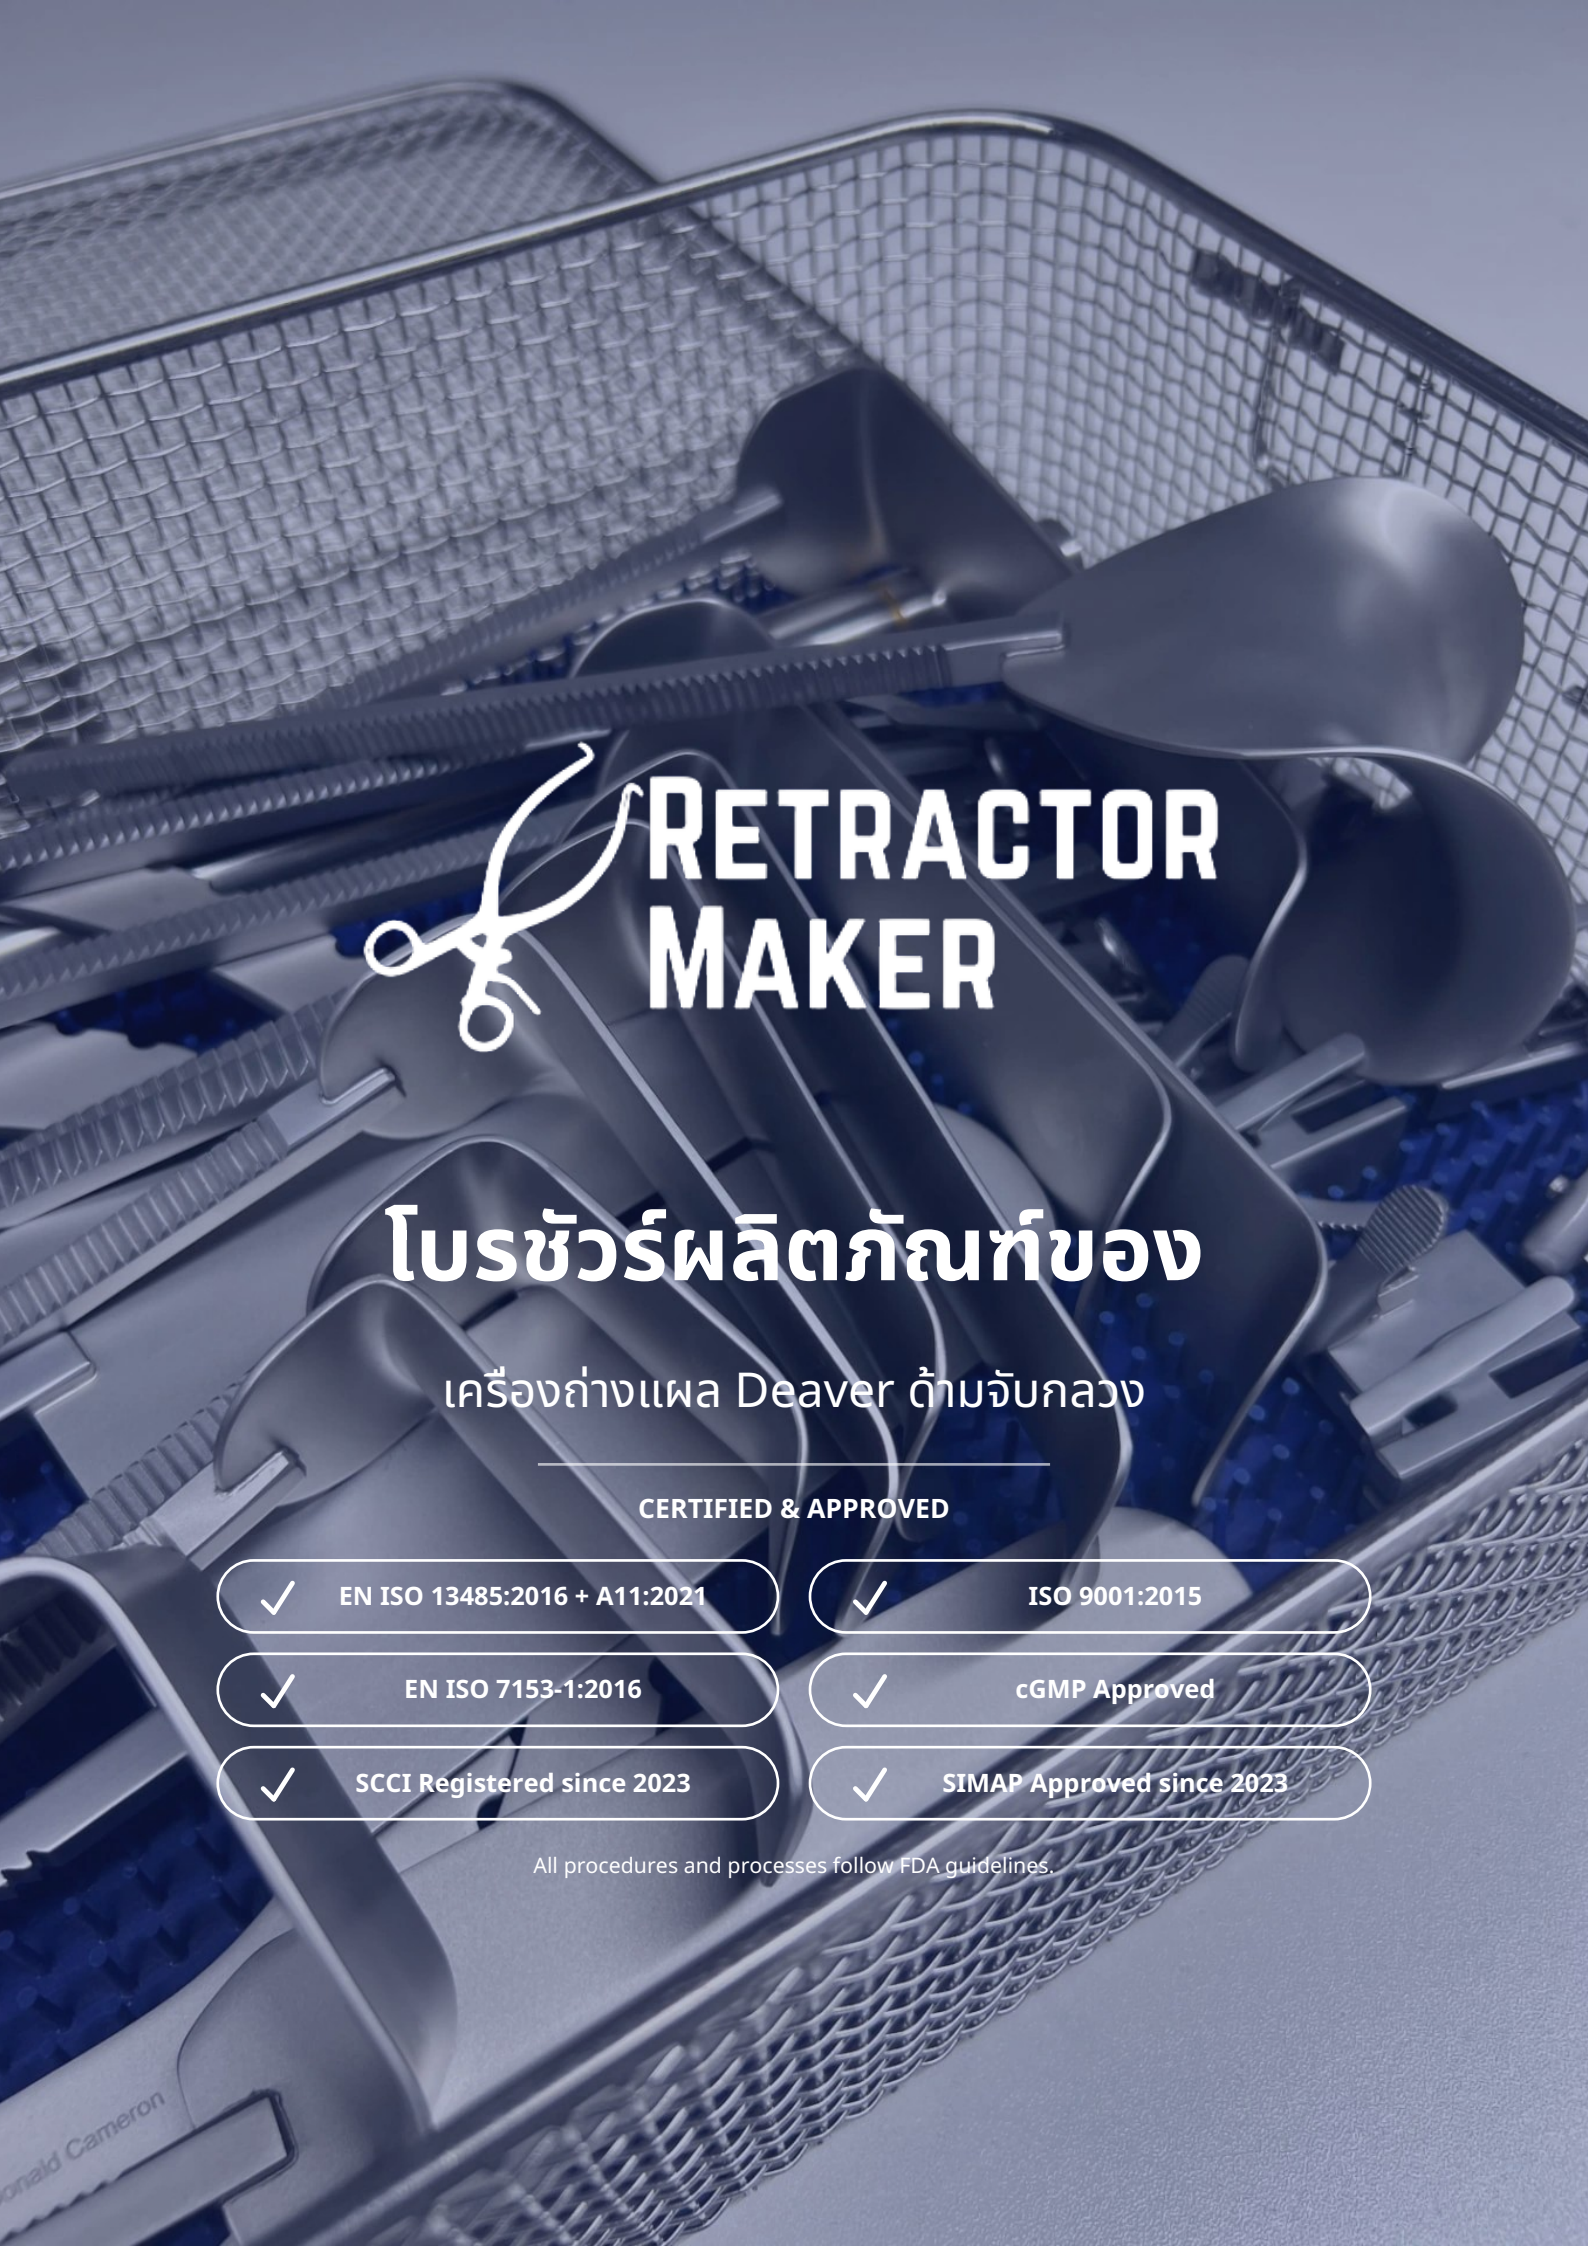


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Deaver ด้ามจับกลวง

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างแผล Deaver ด้ามจับกลวง

SKU RM-DRHGH-1

$64 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
7″ (ประมาณ 17.8 cm) — การถ่างเปิดบริเวณผ่าตัดในเด็กและแผลช่องท้องระดับตื้น	RM-DRHGH-1-1	$64
8″ – 8 ½″ (ประมาณ 20.3 – 21.6 cm) — การถ่างรั้งสำหรับการผ่าตัดไส้ตึง ต่อมไทรอยด์ และอุ้งเชิงกรานทั่วไป	RM-DRHGH-1-2	$66
9″ – 10″ (ประมาณ 22.9 – 25.4 cm) — การถ่างเปิดสำหรับการผ่าตัดเปิดสำรวจช่องท้องในผู้ใหญ่ทั่วไป	RM-DRHGH-1-3	$70
10 ½″ (ประมาณ 26.7 cm) — บริเวณผ่าตัดอุ้งเชิงกรานส่วนลึกและการผ่าตัดทางนรีเวช	RM-DRHGH-1-4	$74
12″ – 13″ (ประมาณ 30.5 – 33.0 cm) — การแหวกอวัยวะภายในส่วนลึกและการยกตับ/ม้าม	RM-DRHGH-1-5	$76
14″ (ประมาณ 35.6 cm) — การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและการผ่าตัดหลังเยื่อบุช่องท้องที่ต้องการระยะเข้าถึงสูงสุด	RM-DRHGH-1-6	$80

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Deaver รุ่นด้ามจับกลวง เป็นการพัฒนาเครื่องถ่างอวัยวะภายในแบบดั้งเดิมให้มีคุณสมบัติตามหลักสรีรศาสตร์ที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ควบคุมด้วยมือได้คล่องตัวยิ่งขึ้น พร้อมลดความตึงล้าของมือและปลายแขนของผู้ใช้อย่างมากระหว่างการถ่างเปิดบริเวณผ่าตัดเป็นเวลานาน ด้ามจับกลวงน้ำหนักเบาช่วยกระจายน้ำหนักเข้าหาฝ่ามือของศัลยแพทย์
ขจัดปัญหาน้ำหนักถ่วงไปด้านหน้าที่มักพบในเครื่องถ่างแผลลึกแบบตัน

เครื่องถ่างแผล Deaver รุ่นด้ามจับกลวง ออกแบบให้ปรับใช้ได้อย่างครอบคลุมกับหัตถการต่าง ๆ โดยมีความยาวรวมให้เลือกเก้าขนาด ได้แก่ 7″ ($64), 8″ ($66), 8 ½″ ($68), 9″ ($70), 10″ ($72), 10 ½″ ($74), 12″ ($76), 13″ ($78) และ 14″ ($80)
พร้อมตัวเลือกโครงสร้างทีให้ระยะเข้าถึงได้สูงสุด 14 ½-inch ใบถ่างขัดเงาทีโค้งลึกสามารถสอดเกียวใต้อวัยวะภายในและผนังหน้าท้องได้อย่างราบรืน ให้แรงดึงต้านกระจายเป็นบริเวณกว้าง พร้อมปกป้องเยือหุ้มอวัยวะทีบอบบางจากการบาดเจ็บเนืองจากแรงกดเฉพาะจุด

Retractor Maker ผลิตเครืองถ่างแผล Deaver ด้ามจับกลวงด้วยการตีขึนรูปจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) พร้อมผิวด้านแบบซาตินทีไม่สะท้อนแสง เพือให้ทนต่อแรงเชิงกลสูงและการนึงฆ่าเชือด้วยไอน้ำแรงดันสูงซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล มอบความทนทานในการใช้งานทางคลินิกทียอดเยียม ความสมดุลทีเหนือกว่า และการควบคุมผ่านสัมผัสทีเป็นเลิศให้แก่ห้องผ่าตัดทัวโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest