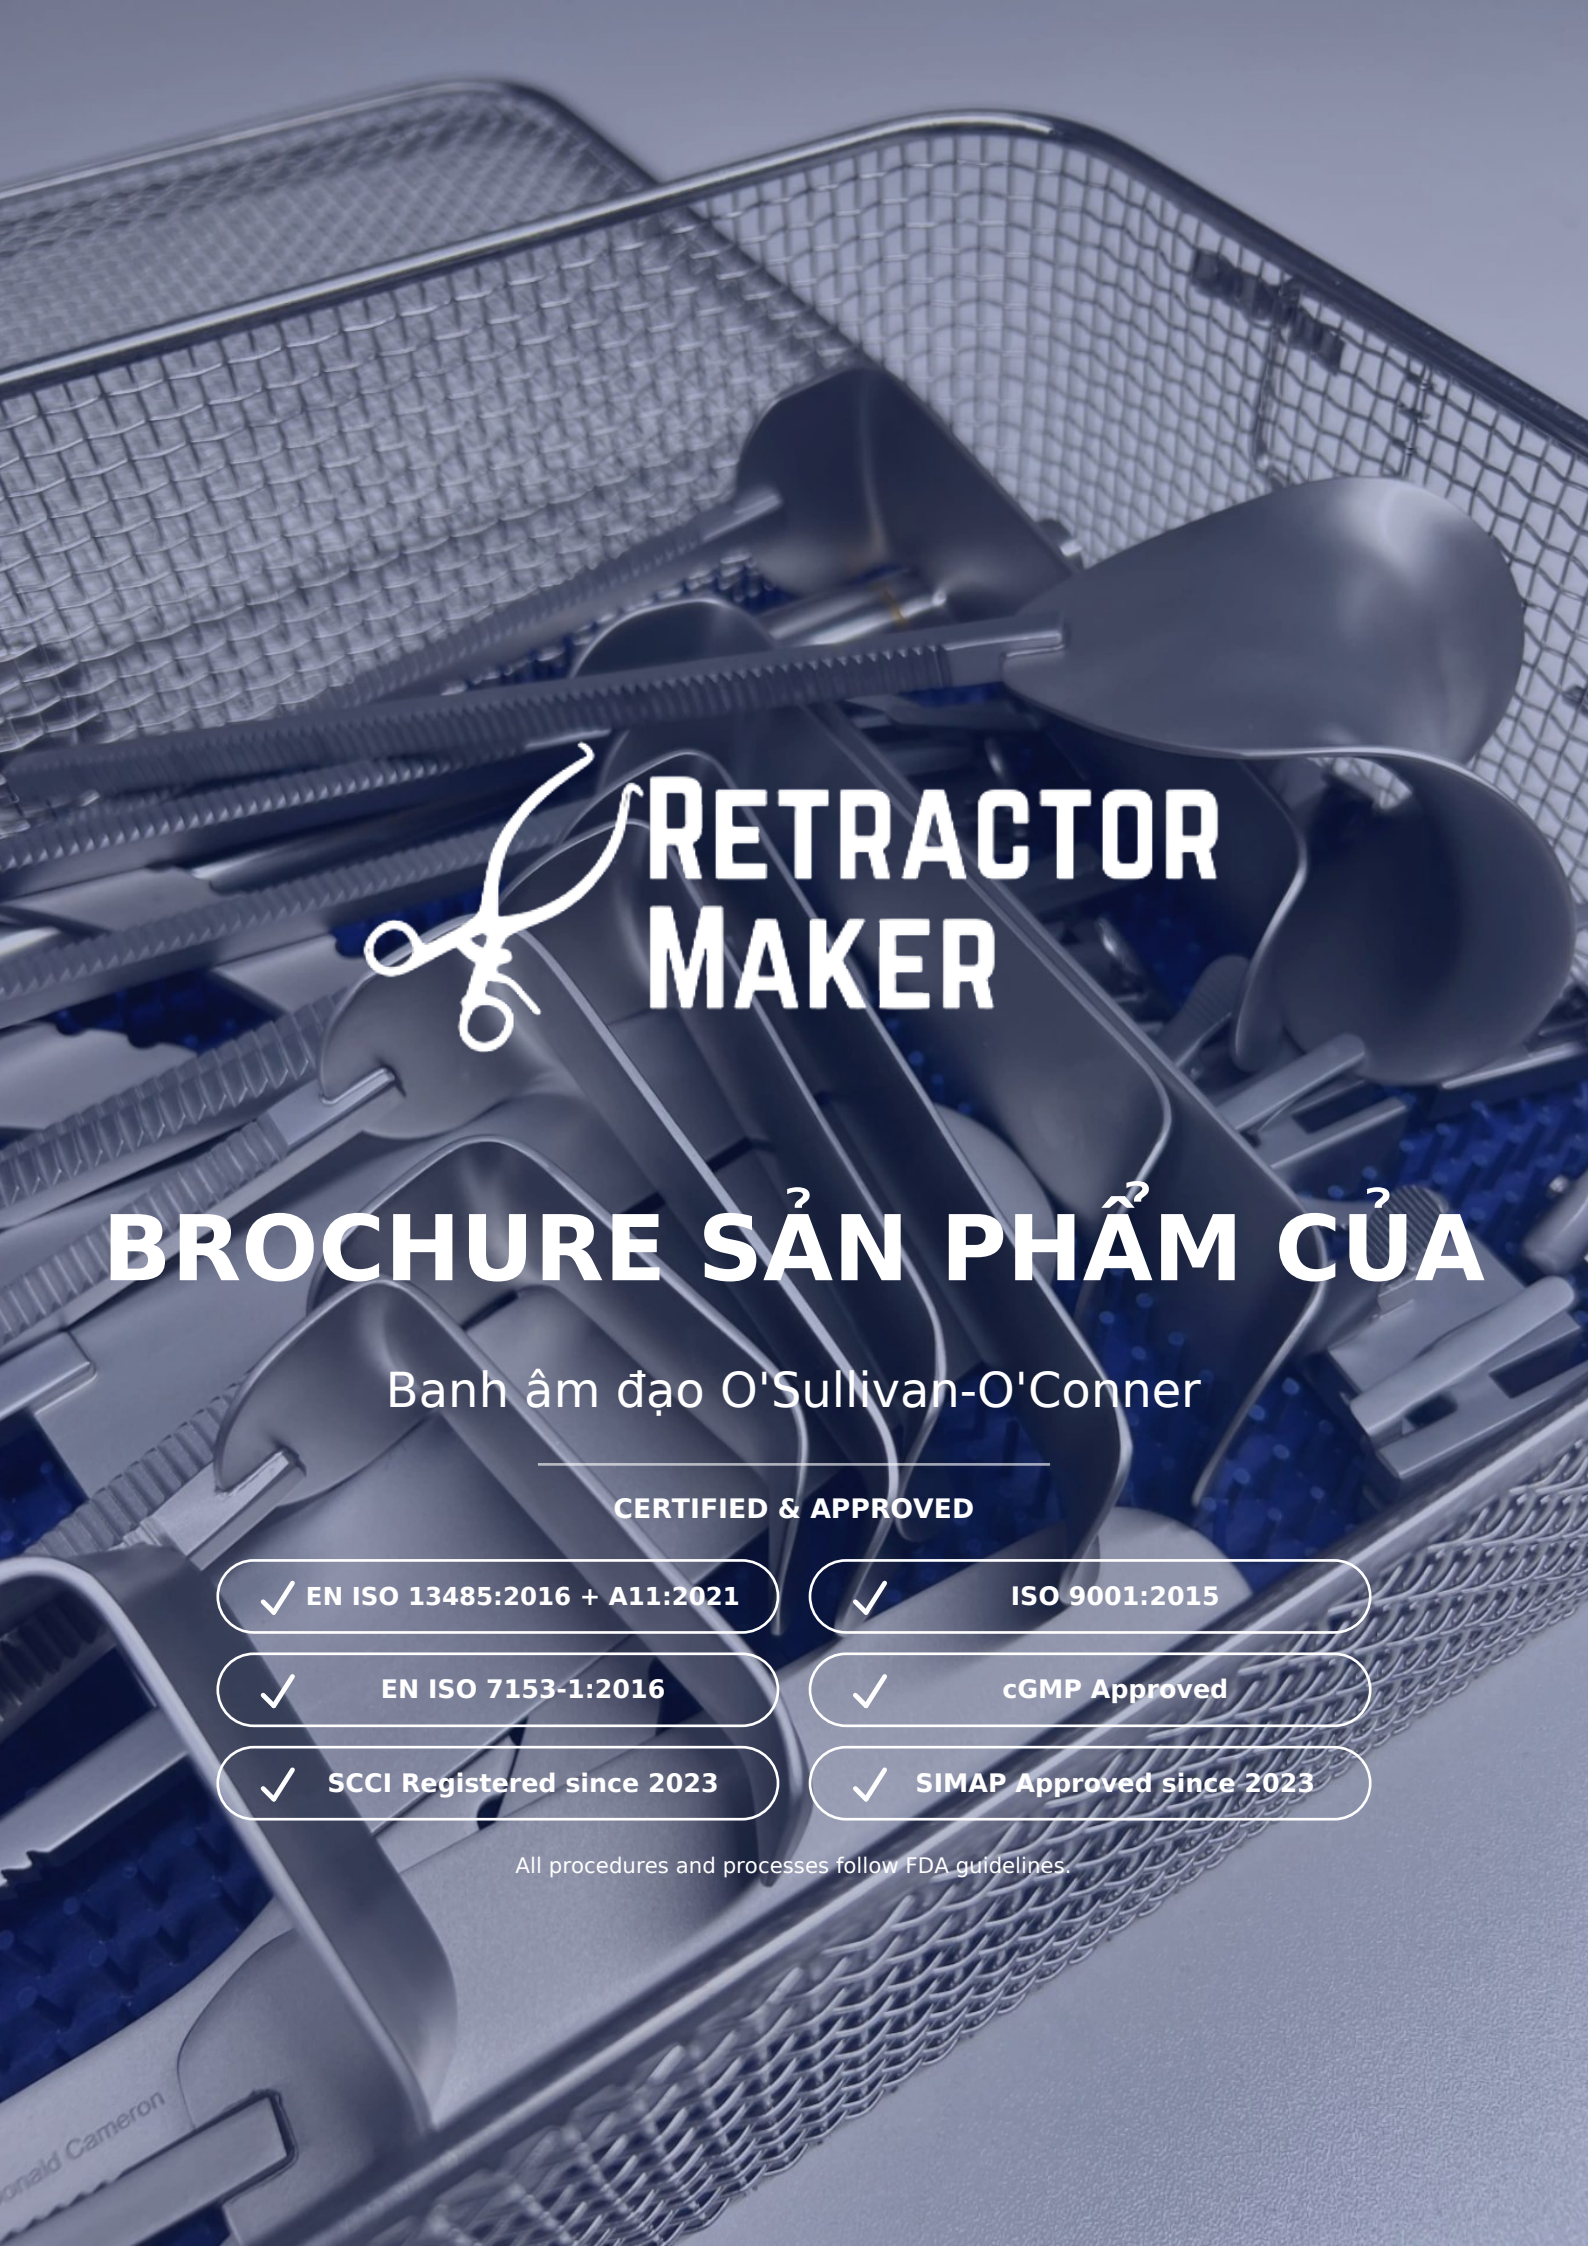


RETRACTOR MAKER

BROCHURE SẢN PHẨM CỦA

Banh âm đạo O'Sullivan-O'Conner

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Banh âm đạo O' Sullivan-O'Conner

SKU RM-OSVR-28-1

$399 USD

DANH SÁCH LINH KIỆN

SỐ LƯỢNG	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	Khung banh chính	Kích thước (Dài × Rộng): Khung 28 cm (dạng cong hoặc bầu dục) · Số lượng kèm theo: 1 khung · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ ($399.00)
1	Lưỡi thay thế cỡ nhỏ	Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi tù 1.3 cm × 4.7 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ
1	Lưỡi thay thế cỡ trung bình	Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi tù 3.8 cm × 8.9 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ
1	Lưỡi thay thế cỡ lớn	Kích thước (Dài × Rộng): Lưỡi tù 4.4 cm × 8.9 cm · Số lượng kèm theo: 1 lưỡi · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ
1	Hộp bảo vệ khi bảo quản / vận chuyển	Kích thước (Dài × Rộng): Bao bì vận chuyển tiêu chuẩn · Số lượng kèm theo: 1 hộp · Giá (USD): Đã bao gồm trong bộ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Banh âm đạo O'Sullivan-O'Conner là hệ thống banh phẫu thuật tự giữ cao cấp, được thiết kế chuyên biệt để vén rộng mô mềm mà không cần giữ bằng tay trong các phẫu thuật phụ khoa, âm đạo và vùng chậu phức tạp. Với khung bao quanh có thể điều chỉnh, dụng cụ duy trì lực kéo đối kháng liên tục theo nhiều hướng lên thành chậu và các tạng, loại bỏ tình trạng mỏi tay của người phụ mổ và duy trì đường tiếp cận phẫu thuật rộng, cố định.

Được thiết kế để phù hợp với các độ sâu mô khác nhau, bộ banh âm đạo O'Sullivan-O'Conner này có khung tiêu chuẩn với tổng chiều dài 28 cm ($399). Khung có cấu hình dạng cong hoặc bầu dục để thích ứng với nhiều cấu trúc giải phẫu vùng chậu. Hệ thống gồm ba cỡ lưỡi có thể thay thế: lưỡi nhỏ (1.3 cm × 4.7 cm), lưỡi trung bình (3.8 cm × 8.9 cm) và lưỡi lớn (4.4 cm × 8.9 cm). Tất cả các lưỡi đều có đầu tù để bảo đảm banh mô mềm an toàn, không gây sang chấn và không có nguy cơ làm thủng niêm mạc.

Retractor Maker chế tác thủ công banh âm đạo O'Sullivan-O'Conner từ thép không gỉ cao cấp AISI 304/316 (không nhiễm từ), với bề mặt hoàn thiện mờ satin chống chói, để chịu được các chu trình hấp tiệt khuẩn lặp lại tại bệnh viện, mang lại độ ổn định cơ học vượt trội, khả năng chống ăn mòn và độ tin cậy lâm sàng toàn diện cho các trung tâm phẫu thuật phụ khoa và niệu phụ khoa trên toàn thế giới.

XIN CẢM ƠN

Chúng tôi mong muốn được thảo luận về các yêu cầu banh phẫu thuật của quý vị.

LIÊN HỆ RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Website

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ĐỊA CHỈ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

THEO DÕI CHÚNG TÔI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest