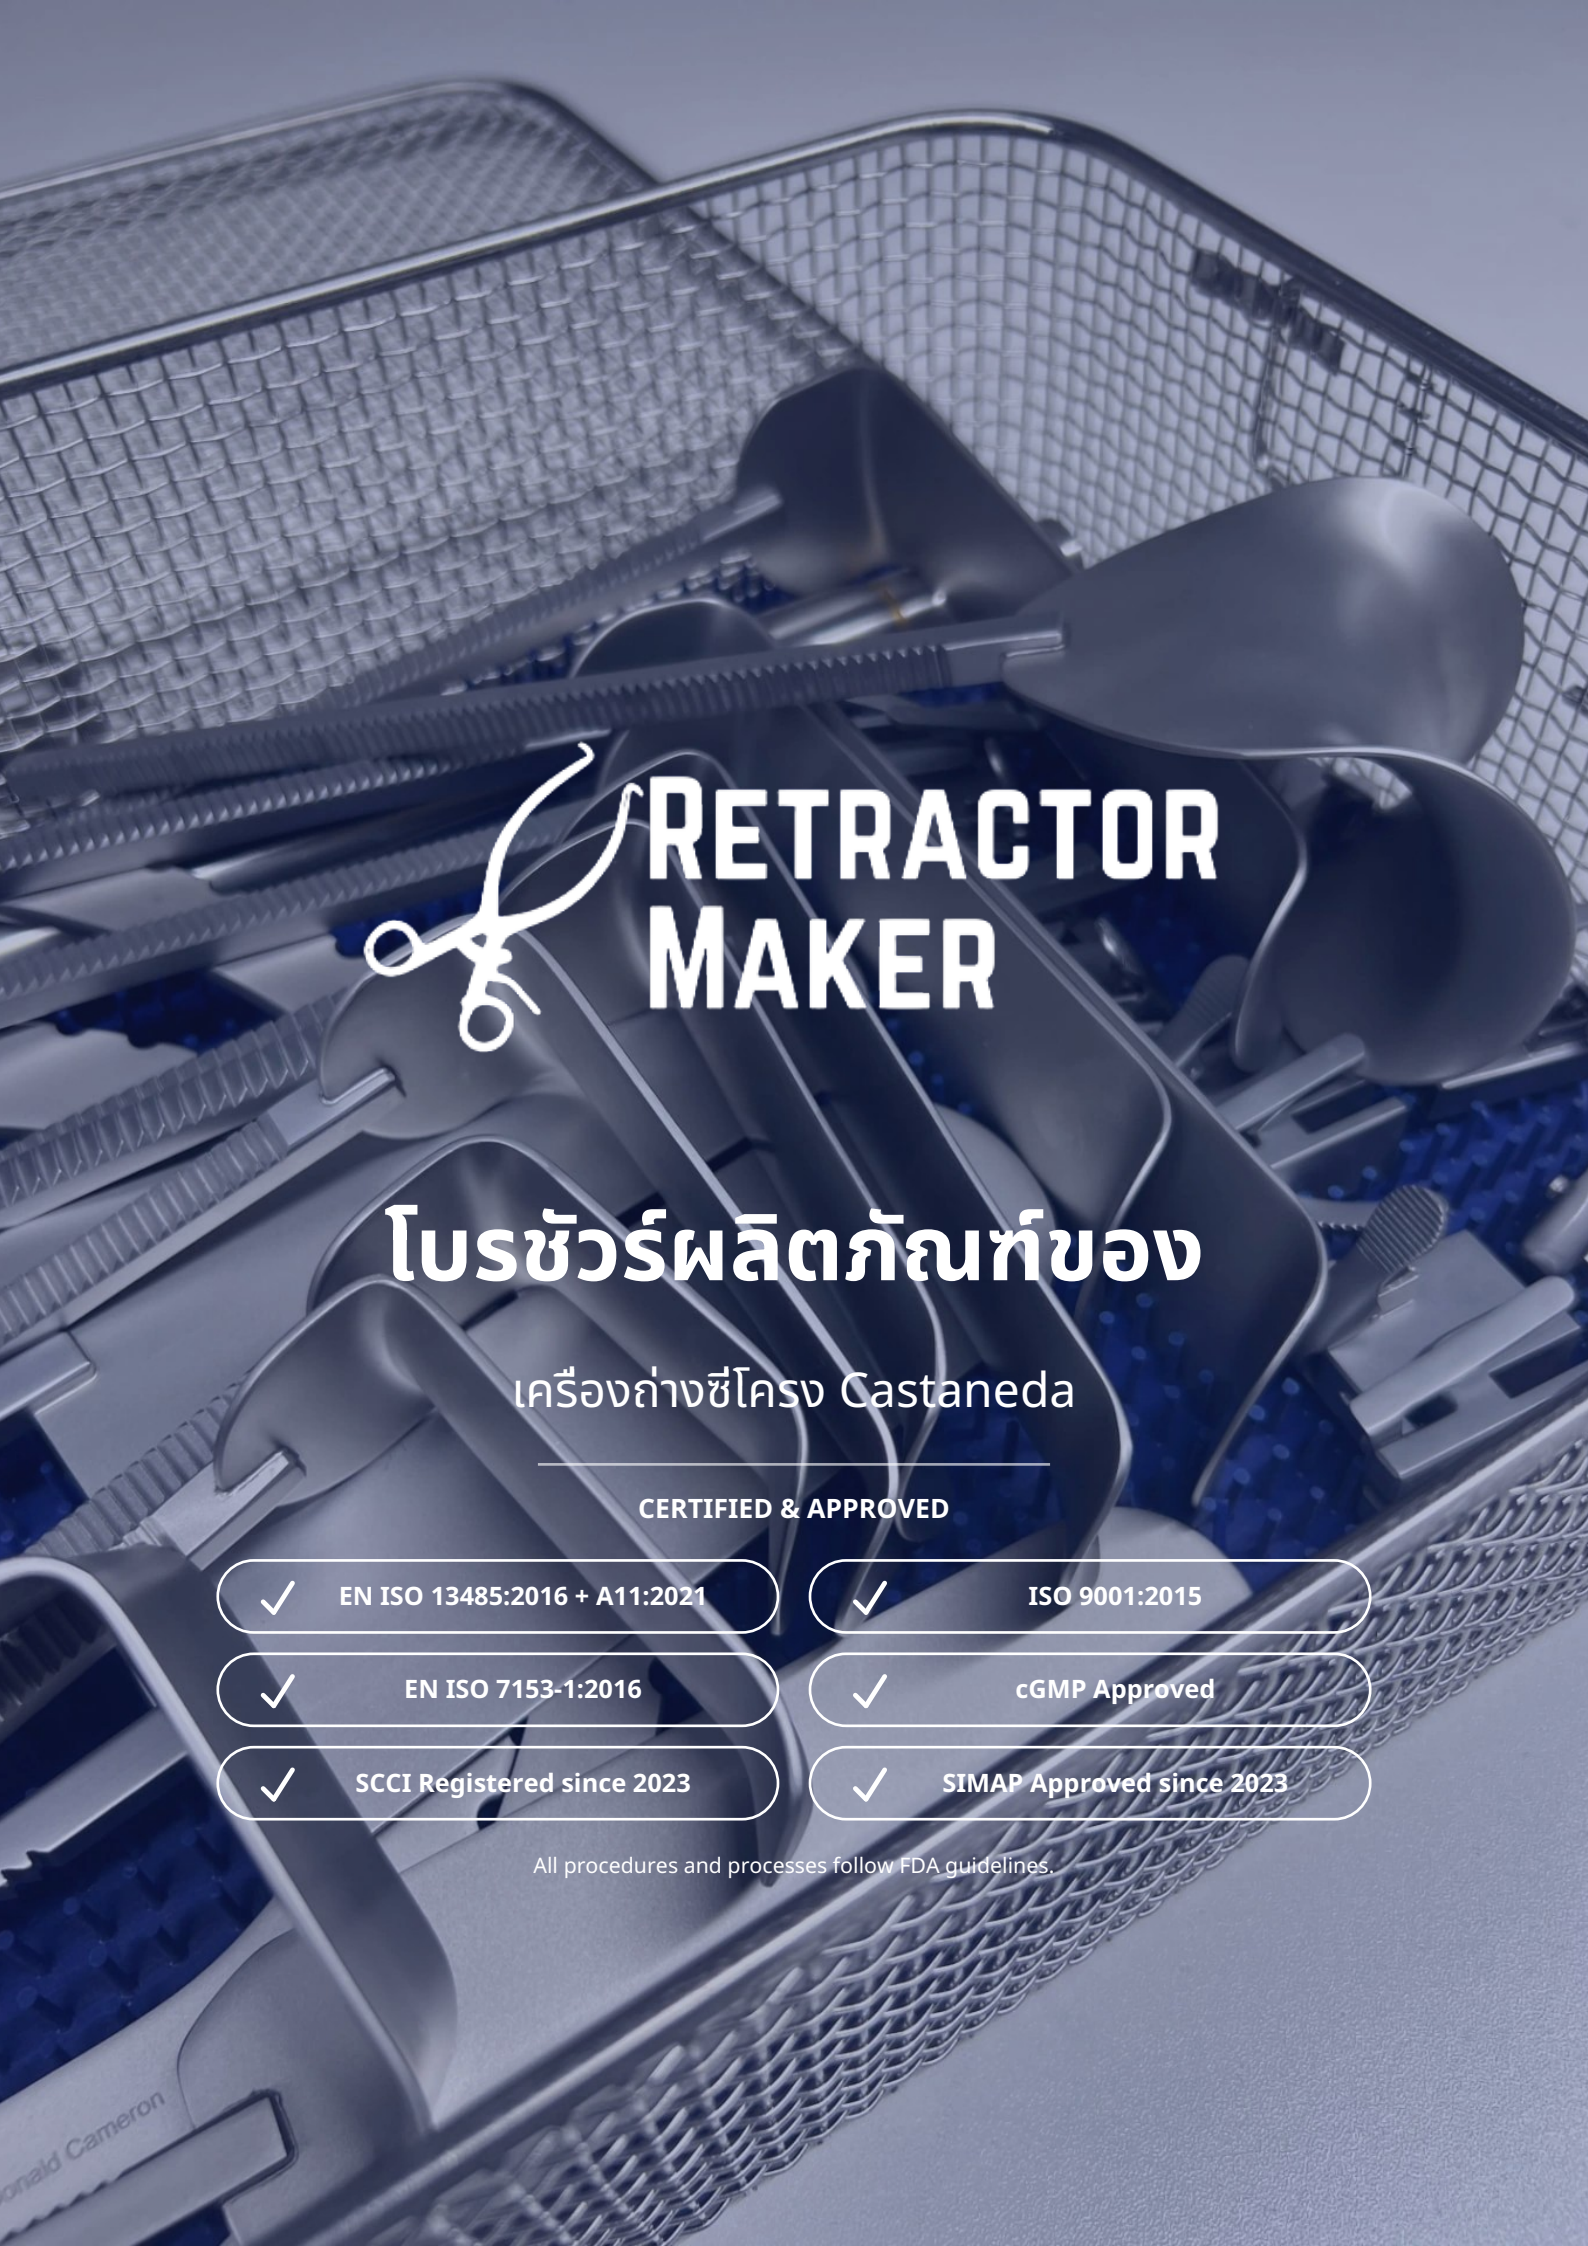


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างซีโครง Castaneda

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างซีโครง Castaneda

SKU RM-CRS-SERIES-1

$309 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
ตัวเลือก 1 — 10.5 mm × 32 mm — ระยะถ่างสูงสุด 65 mm — การผ่าตัดเปิดทรวงอกในทารกแรกเกิด การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบแคบ การผูกปิด PDA ในทารก	RM-CRS-SERIES-1-1	$309
ตัวเลือก 2 — 12.0 mm × 45 mm — ระยะถ่างสูงสุด 70 mm — การผ่าตัดแก้ไขหัวใจพิการแต่กำเนิดในทารก การผ่าตัดแยกวงแหวนหลอดเลือด	RM-CRS-SERIES-1-2	$329
ตัวเลือก 3 — 15.0 mm × 60 mm — ระยะถ่างสูงสุด 120 mm — การผ่าตัดเปิดทรวงอกในเด็กและวัยรุ่น การผ่าตัดสร้างทางเชื่อมหลอดเลือดไปปอด	RM-CRS-SERIES-1-3	$349

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างซีโครง Castaneda เป็นเครื่องถ่างสำหรับการผ่าตัดทรวงอกโดยเฉพาะในเด็กและทารกแรกเกิด ออกแบบมาเพื่อถ่างแยกซีโครงอย่างปลอดภัยและควบคุมได้ระหว่างการผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและการผ่าตัดเปิดทรวงอกในเด็ก รางเลื่อนที่ออกแบบอย่างประณีตและปรับระยะได้ละเอียดช่วยให้ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกเด็กกระจายแรงถ่างได้อย่างละเอียดแม่นยำสูง ลดการเกิดกระดูกซี่โครงหักหรือข้อเชื่อมต่อระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกอ่อนเคลื่อนในโครงทรวงอกที่บอบบางของทารก

เครื่องถ่างซีโครง Castaneda รุ่นนี้ออกแบบให้รองรับสรีระที่แตกต่างกันของผู้ป่วยเด็ก โดยมีให้เลือกสามขนาด ได้แก่ ตัวเลือก 1 ($309) มีใบถ่างขนาด 10.5 mm × 32 mm และระยะถ่างสูงสุดของราง 65 mm สำหรับทารกแรกเกิด; ตัวเลือก 2 ($329) มีใบถ่างขนาด 12 mm × 45 mm และระยะถ่างสูงสุดของราง 70 mm สำหรับทารก; และตัวเลือก 3 ($349) มีใบถ่างขนาด 15 mm × 60 mm และระยะถ่างสูงสุดของราง 120 mm สำหรับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก)
ใบถ่างด้านข้างทีโค้งมนเรียบช่วยประคองขอบซีโครงโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บ ขณะที่ชุดขับสกรูแบบหมุนล็อกได้อย่างมั่นคงโดยไม่เลื่อนถอยกลับ

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างซีโครง Castaneda ด้วยการตีขึ้นรูปและตกแต่งผิวซาตินด้านเพื่อลดแสงสะท้อน ให้ทนต่อการทำให้ปราศจากเชื้อซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล มอบความทนทานของโครงสร้างที่โดดเด่น ความต้านทานการกัดกร่อน และความเชื่อมั่นในการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำ สำหรับห้องผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลเด็ก และศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest