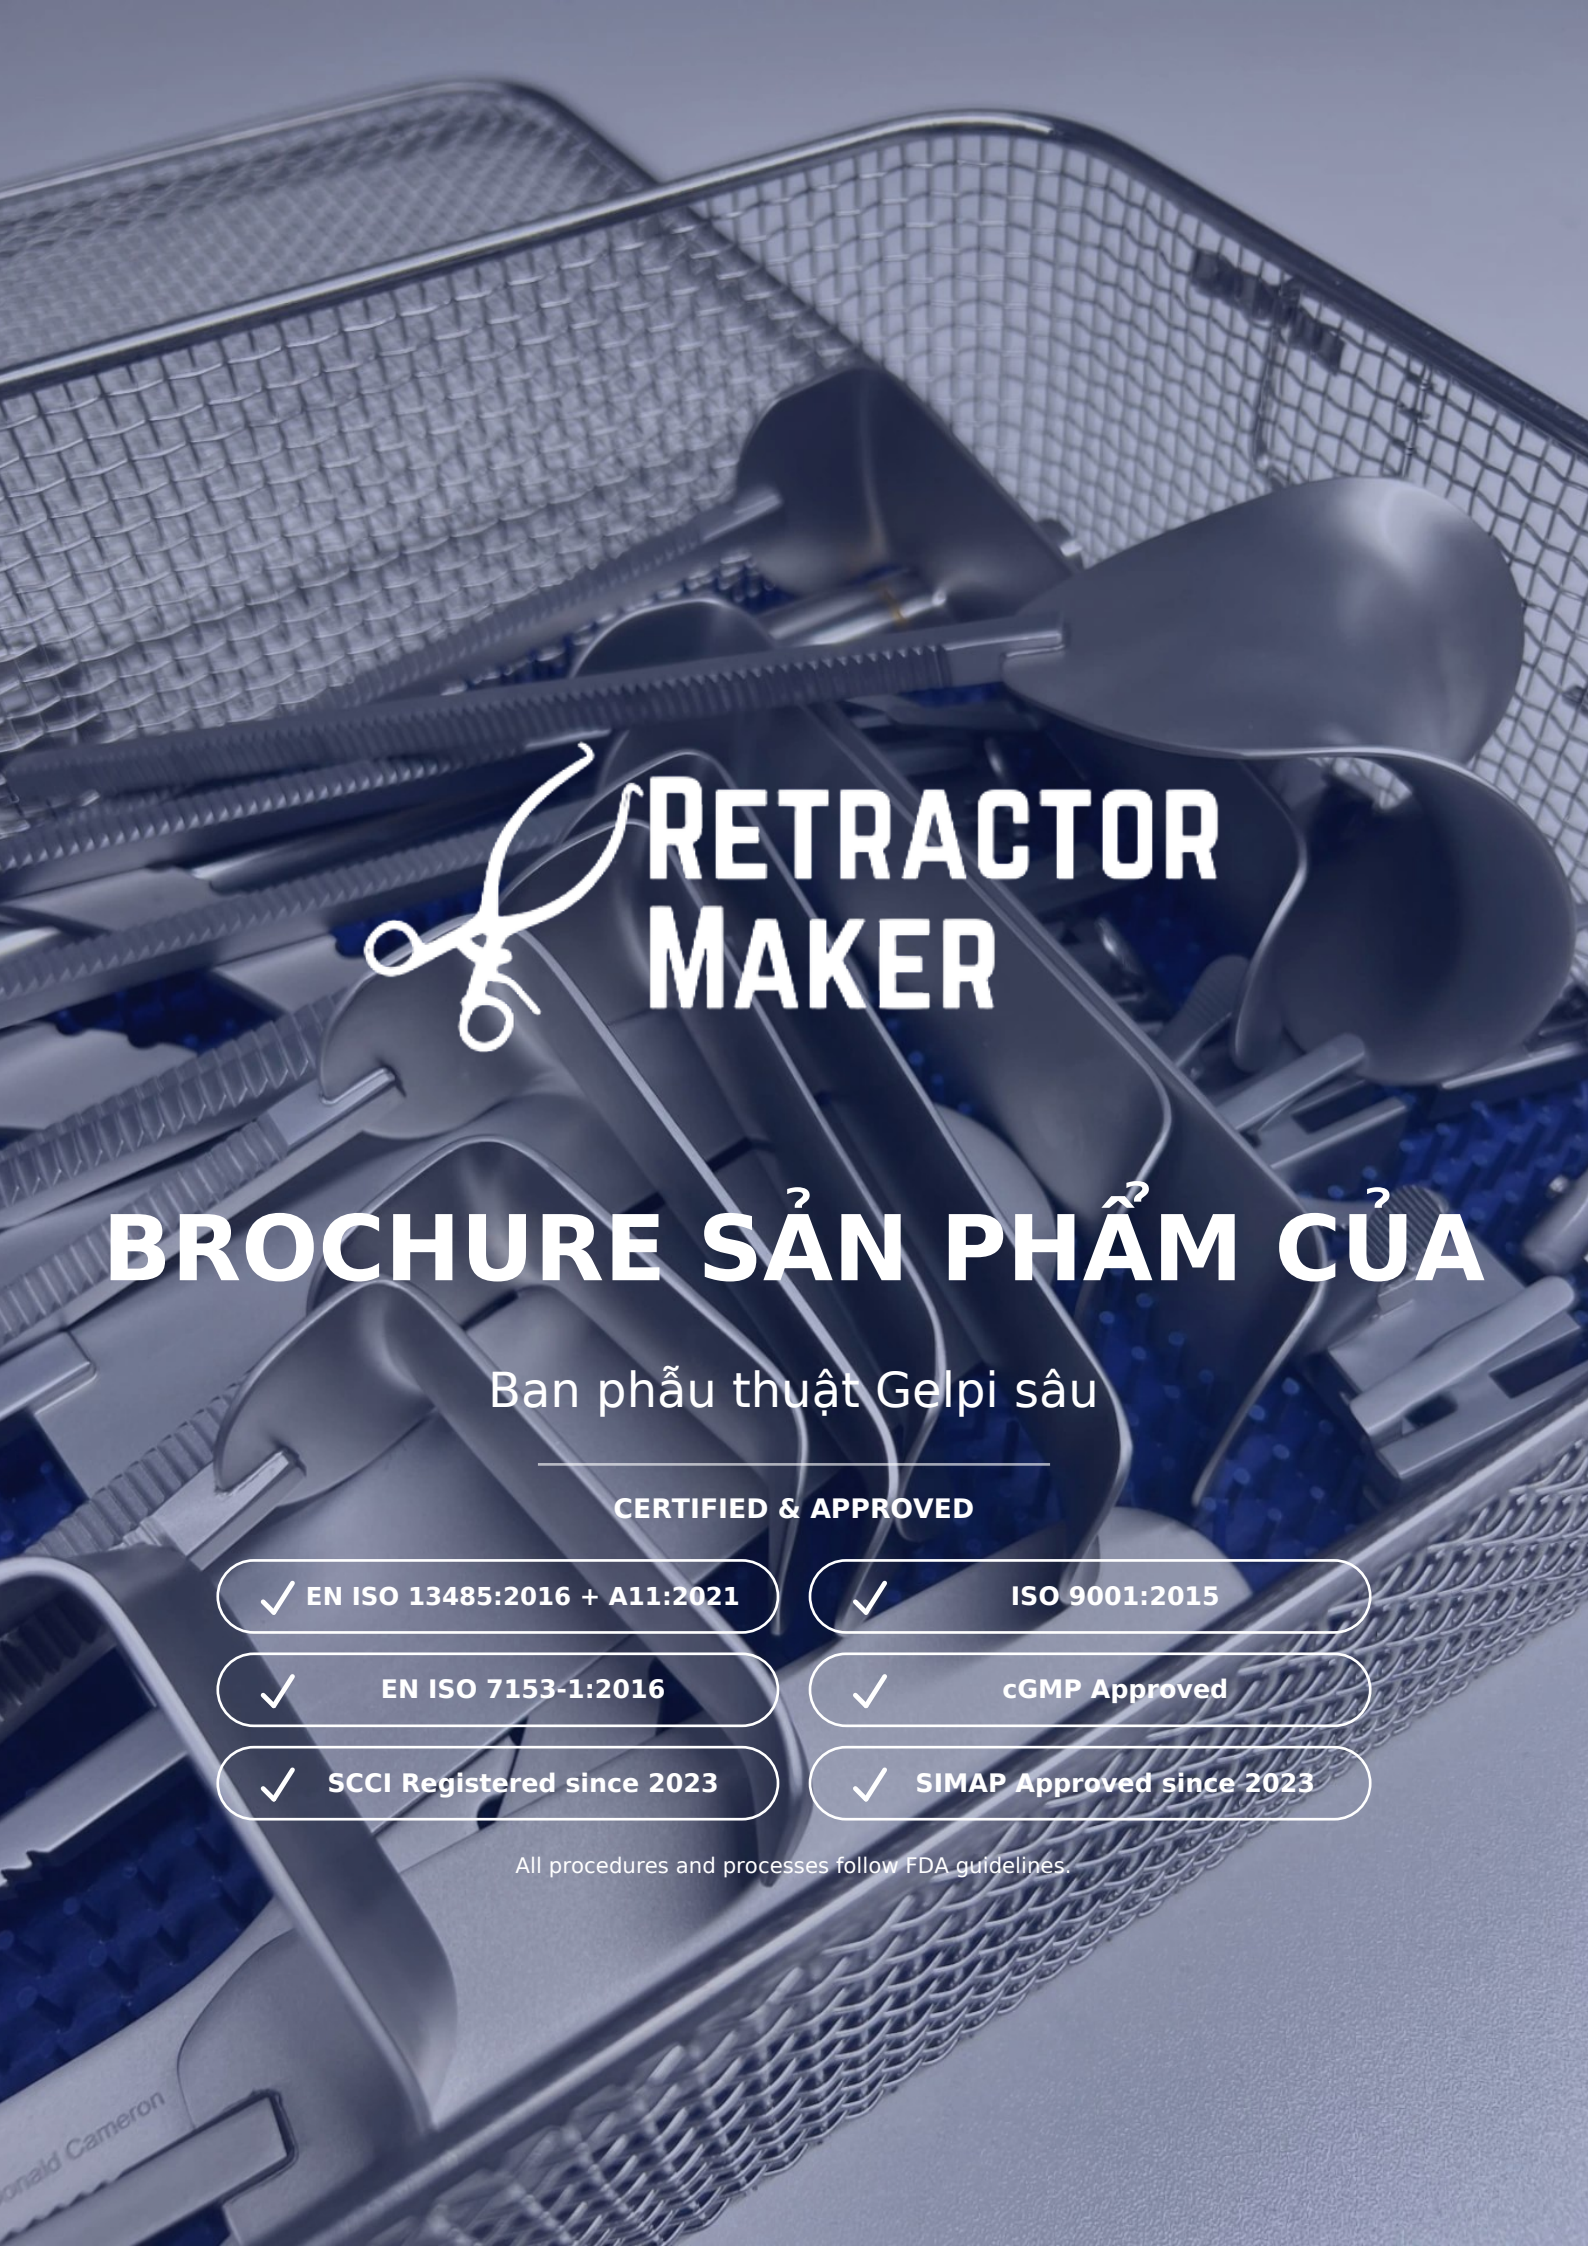


RETRACTOR MAKER

BROCHURE SẢN PHẨM CỦA

Ban phẫu thuật Gelpi sâu

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ban phẫu thuật Gelpi sâu

SKU RM-DGR-SERIES-1

$68 USD

KÍCH THƯỚC & GIÁ BÁN HIỆN CÓ

KÍCH THƯỚC / TÙY CHỌN	SKU / CHI TIẾT	GIÁ (USD)
3 ½″ – 4 ½″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc — Bộc lộ phẫu trường trong tiểu phẫu nông, phẫu thuật bàn tay và phẫu thuật nhi	RM-DGR-SERIES-1-1	$68
5 ½″ – 6 ¾″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc — Tiếp cận mô mềm ở độ sâu trung bình, phẫu thuật tạo hình và vùng cột sống cổ	RM-DGR-SERIES-1-2	$74
7 ½″ – 7 ¾″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc — Phẫu thuật cắt bản sống thắt lưng tiêu chuẩn và banh bộc lộ khớp	RM-DGR-SERIES-1-3	$84
9 ¼″ – 12″ — Đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gập góc, 90°, gập vuông góc — Phẫu thuật khoang chậu sâu, phẫu thuật điều trị béo phì và hàn xương cột sống nhiều tầng	RM-DGR-SERIES-1-4	$94

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Ban phẫu thuật Gelpi sâu là dụng cụ phẫu thuật tự giữ thiết yếu, được thiết kế chuyên biệt để banh mô ổn định ở nhiều độ sâu trong nhiều chuyên khoa phẫu thuật. Với các mấu hướng ra ngoài bám chắc vào mép vết mổ, dụng cụ này giúp ê-kíp phẫu thuật mở rộng phẫu trường mà không gây mỏi cho người phụ mổ do phải giữ banh bằng tay.

Được thiết kế để phù hợp với mọi độ sâu giải phẫu và tình huống lâm sàng, dòng ban phẫu thuật Gelpi sâu cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình linh hoạt. Phẫu thuật viên có thể lựa chọn mười chiều dài tổng thể: 3 ½″ ($68), 4 ½″ ($72), 5 ½″ ($76), 6 ½″ ($74), 6 ¾″ ($80), 7 ½″ ($84), 7 ¾″ ($88), 9 ¼″ ($94), 11″ ($102) và 12″ ($109). Các tùy chọn đầu làm việc và tay banh gồm đầu nhọn, đầu tù, đầu nhọn gập góc, gập góc 90 độ và tay banh gập vuông góc. Cơ cấu khóa bánh cóc chính xác trên tay cầm vòng ngón khóa chắc chắn khi chịu lực căng ngược từ mô.

Retractor Maker chế tạo ban phẫu thuật Gelpi sâu từ thép không gỉ AISI 304/316 cao cấp (không nhiễm từ), được rèn và hoàn thiện bề mặt mờ satin không phản chiếu, để chịu được nhiều chu kỳ hấp tiệt khuẩn tại bệnh viện, mang đến cho các phòng mổ trên toàn thế giới độ cứng vững cơ học vượt trội, cơ cấu bánh cóc vận hành trơn tru và độ bền suốt vòng đời sử dụng.

XIN CẢM ƠN

Chúng tôi mong muốn được thảo luận về các yêu cầu banh phẫu thuật của quý vị.

LIÊN HỆ RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Website

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ĐỊA CHỈ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

THEO DÕI CHÚNG TÔI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest