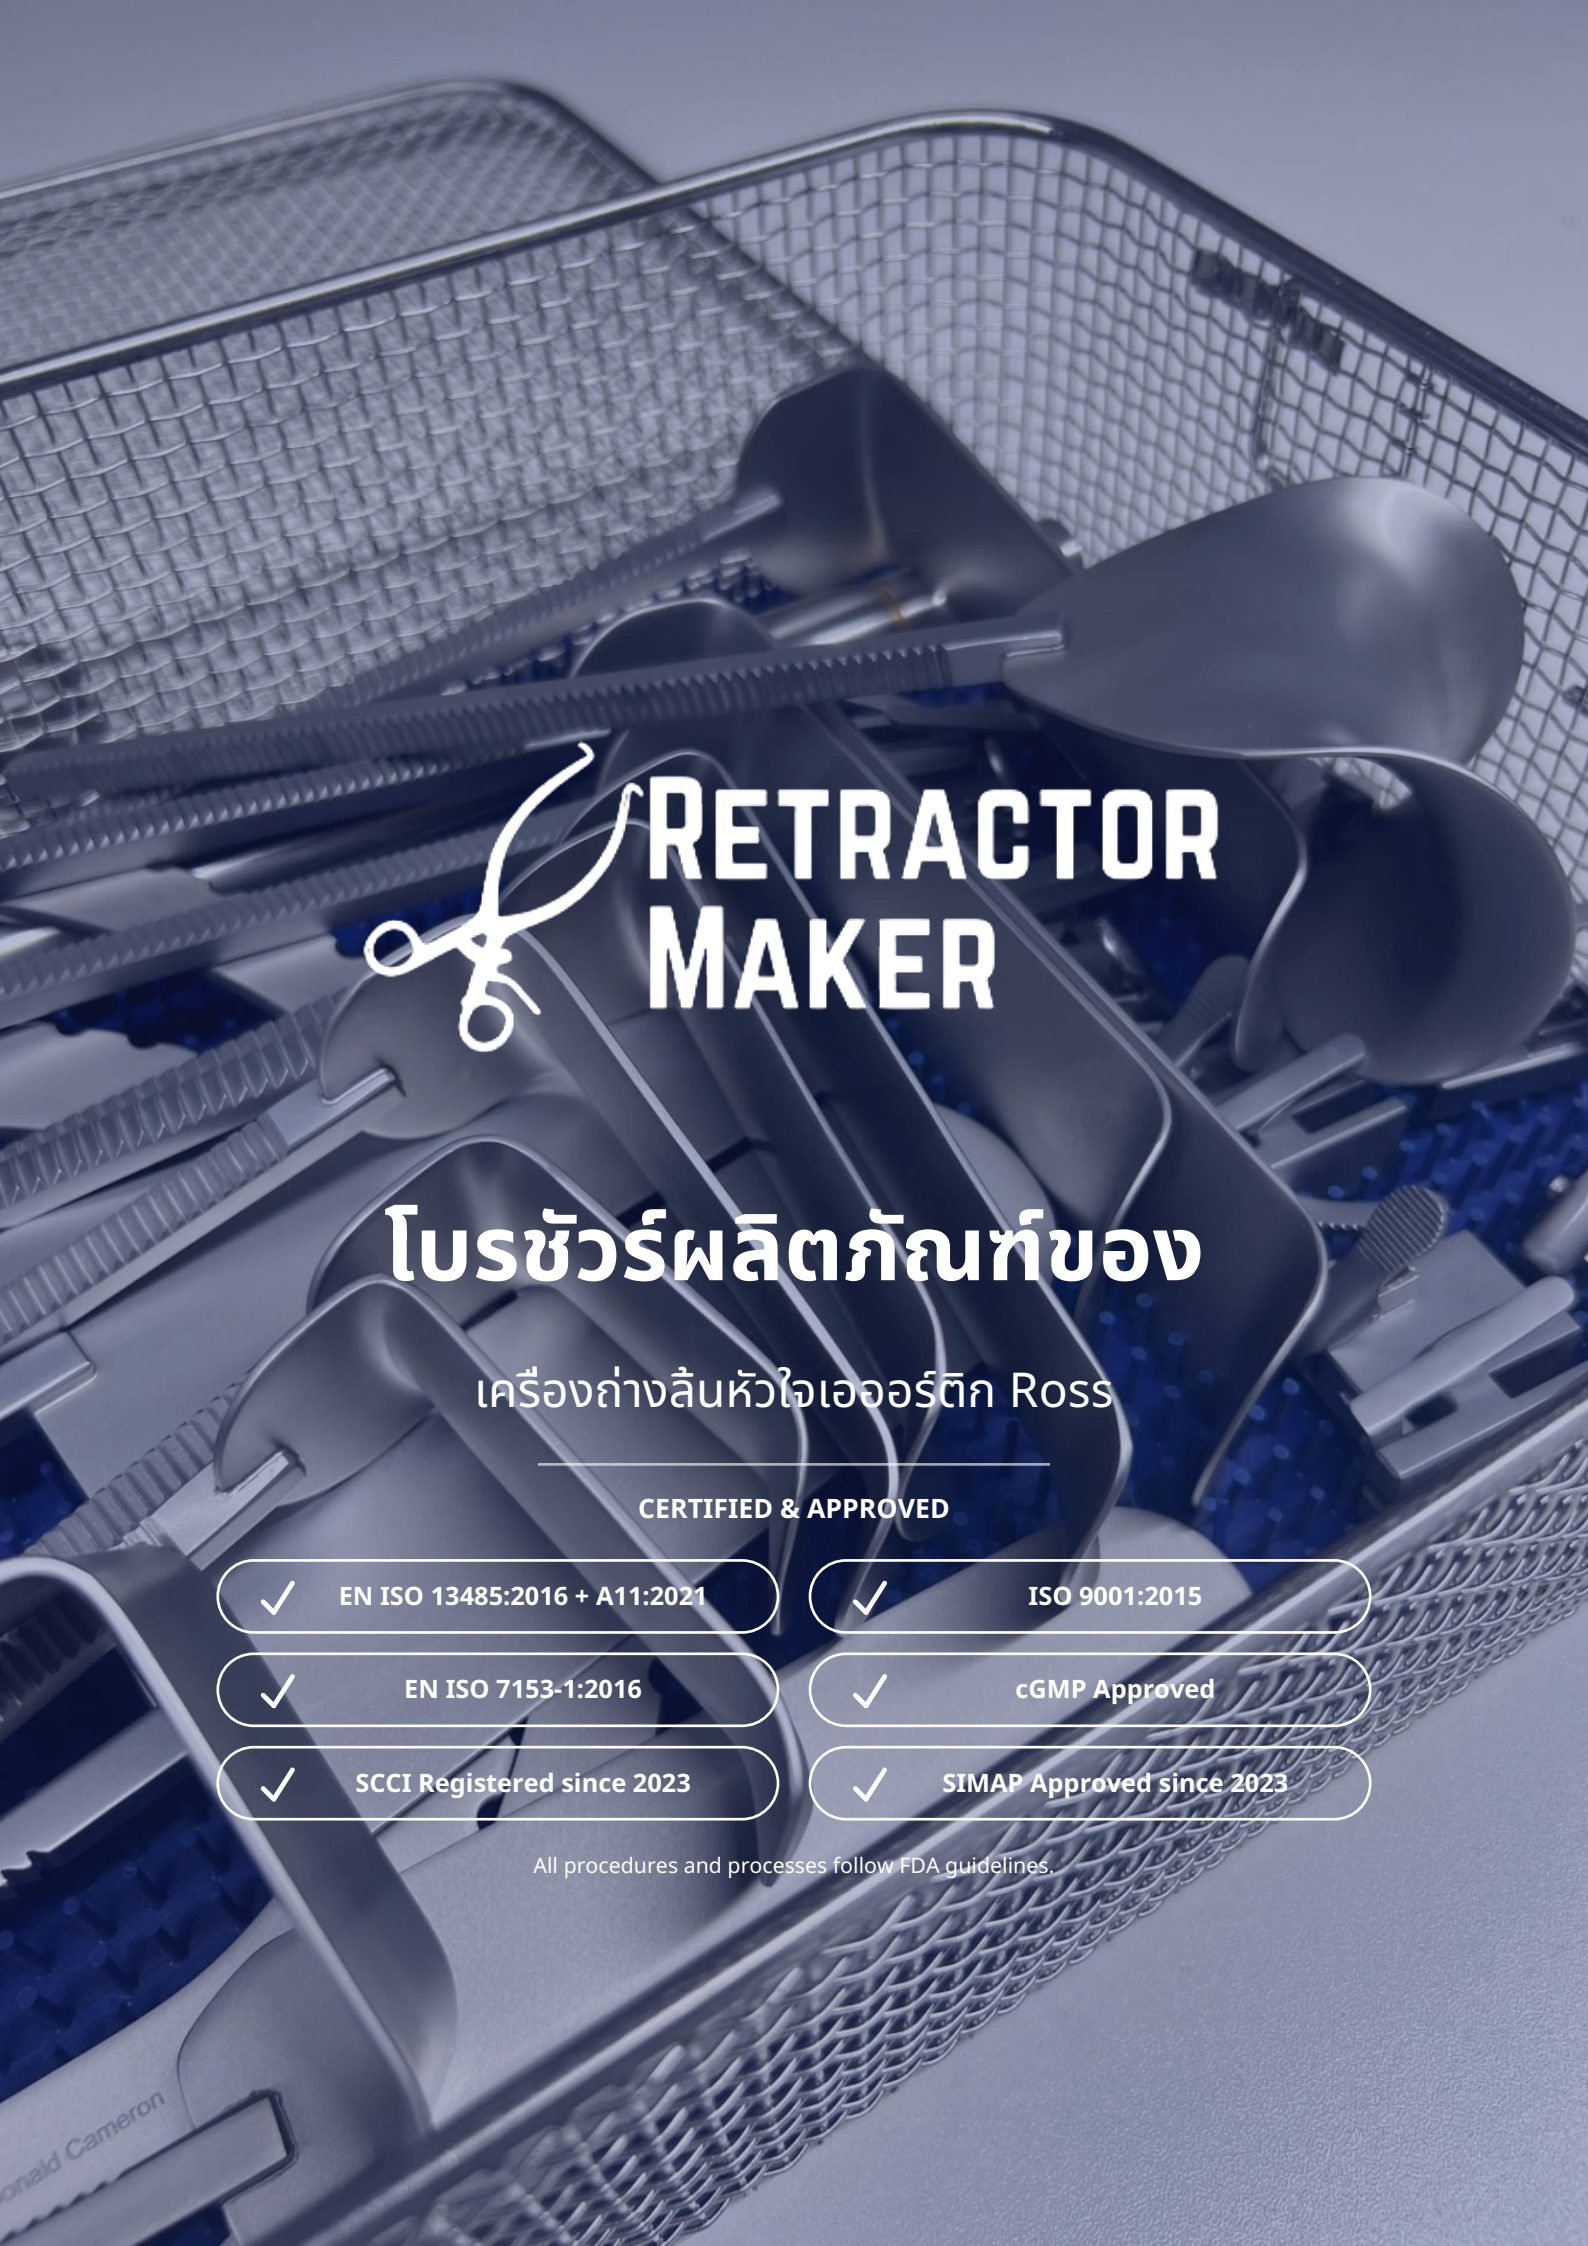


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างลิ้นหัวใจเอออร์ติก Ross

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างลิ้นหัวใจเออออร์ติก Ross

SKU RM-RAVR-25-1

$89 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
ขนาด #1 — ⅝″ × ⅝″ (ประมาณ 16 × 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	$89
ขนาด #2 — ½″ × ⅞″ (ประมาณ 13 × 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	$89
ขนาด #3 — ¾″ × 1″ (ประมาณ 19 × 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	$89
ขนาด #4 — ¾″ × 1 ⅛″ (ประมาณ 19 × 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	$89
ขนาด #5 — 1 ⅛″ × 1 ⅛″ (ประมาณ 29 × 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	$89
ขนาด #6 — 1 ⅜″ × ⅞″ (ประมาณ 35 × 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	$89

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างลิ้นหัวใจเออออร์ติก Ross เป็นเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่างกลีบลิ้นหัวใจเออออร์ติกและรากหลอดเลือดเออออร์ตาอย่างปลอดภัยโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บระหว่างการเปลี่ยนลิ้นหัวใจและการผ่าตัดสร้างซ่อม ด้วยหน้าแผ่นถ่างที่โค้งรับกับกายวิภาค เครื่องมือนี้ช่วยให้ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกตรวจดูวงแหวนลิ้นหัวใจเออออร์ติก รูเปิดหลอดเลือดโคโรนารี และโครงสร้างใต้ลิ้นหัวใจได้อย่างชัดเจน โดยไม่ทำให้กลีบลิ้นหัวใจที่บอบบางเกิดรอยช้ำ

เครื่องถ่างลิ้นหัวใจเออออร์ติก Ross รุ่นนี้ผลิตตามมาตรฐานการใช้งานทางคลินิก มีความยาวรวม 25 cm ($89) สามารถเข้าถึงส่วนลึกของรากหลอดเลือดเออออร์ตาได้ โดยมือของผู้ช่วยยังคงอยู่นอกบริเวณผ่าตัดหลัก ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ชุดด้ามจับมีโครงสร้างหกเหลี่ยมแบบตันตามหลักสรีรศาสตร์ ให้ความมั่นคงในการหมุนและการควบคุมที่ไม่ลื่นหลุดได้อย่างดีเยี่ยม ศัลยแพทย์สามารถเลือกแผ่นถ่างตามกายวิภาคได้หกขนาด ได้แก่ ขนาด #1 (⅝″ × ⅝″), ขนาด #2 (½″ × ⅞″), ขนาด #3 (¾″ × 1″), ขนาด #4 (¾″ × 1 ⅛″), ขนาด #5 (1 ⅛″ × 1 ⅛″) และขนาด #6 (1 ⅜″ × ⅞″)

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างลิ้นหัวใจเออออร์ติก Ross ด้วยการตีขึ้นรูปและแต่งผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน ให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำแรงดันของโรงพยาบาลซ้ำหลายรอบ เพื่อให้ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจและห้องผ่าตัดทรวงอกทั่วโลกได้รับเครื่องมือ

ที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งไม่เสียรูป ทนต่อการกัดกร่อนสูง และทนทานต่อการใช้งานทางคลินิกอย่างครบถ้วน

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest