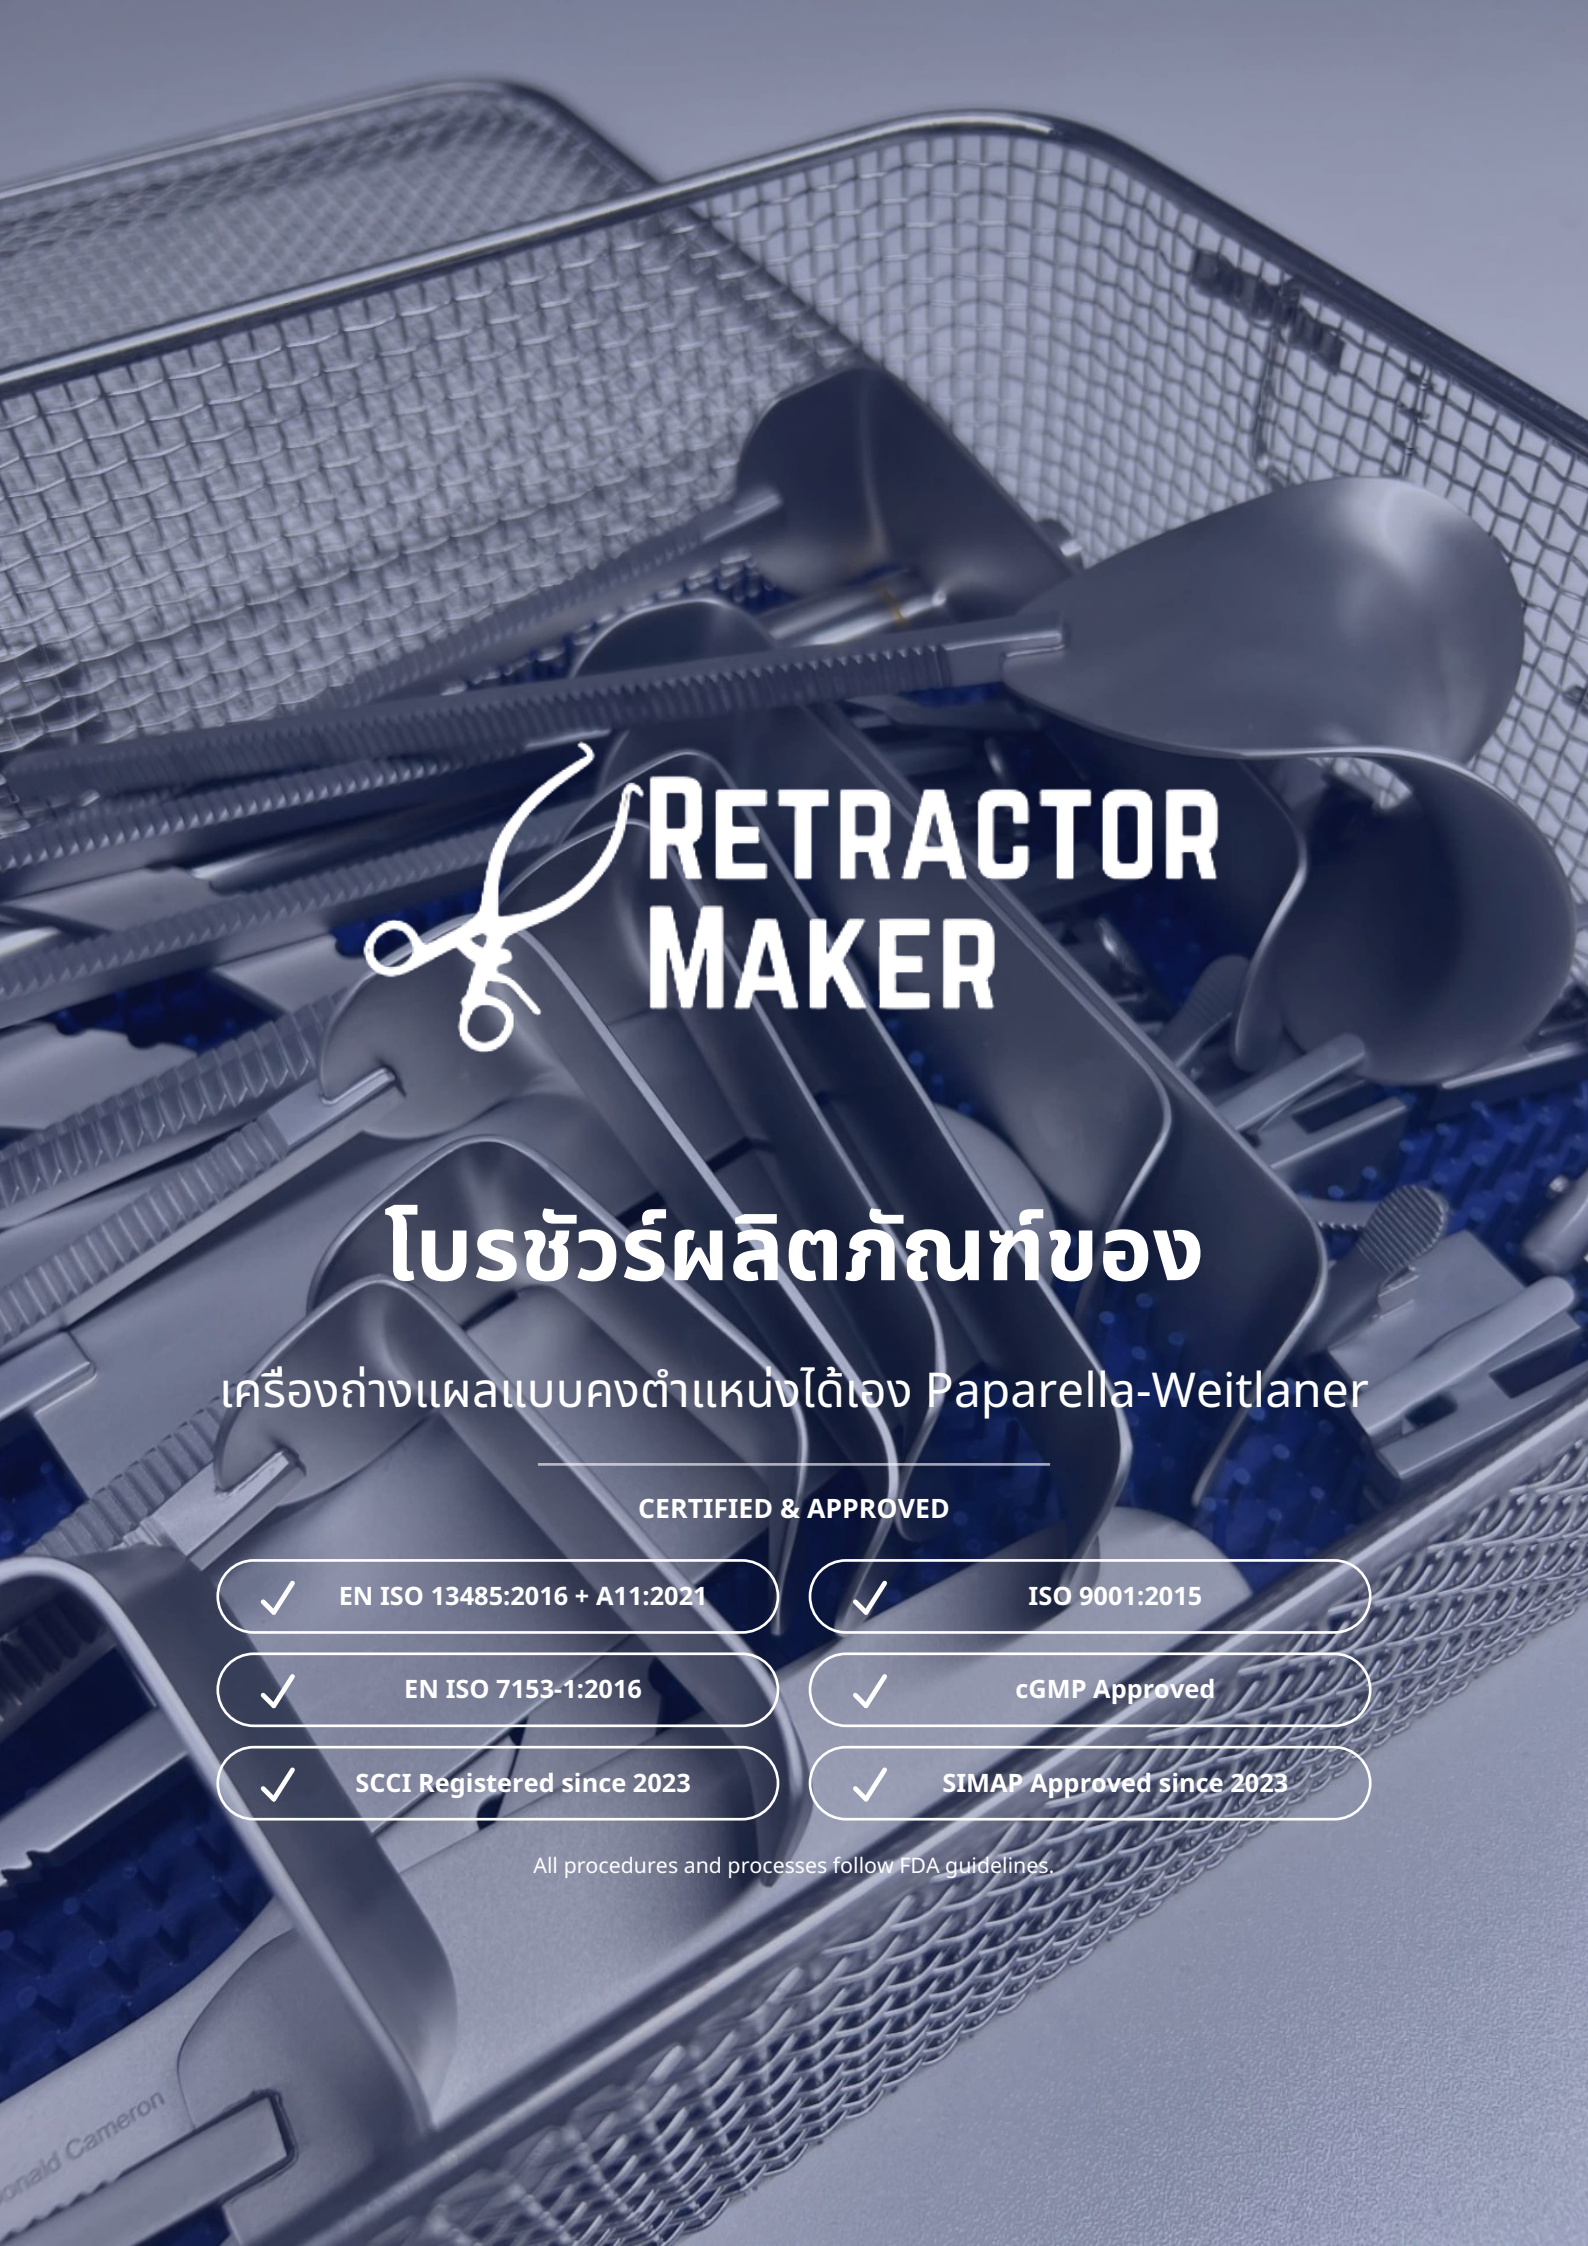


RETRACTOR MAKER

# โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

## เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner

**CERTIFIED & APPROVED**

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



# เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner

**SKU** RM-PWSRR-5IN-1

## $89 USD

## ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

| ขนาด / ตัวเลือก | SKU / รายละเอียด | ราคา (USD) |
|---|---|---|
| เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner | ความยาวรวม 5″ (12.7 cm), เขี้ยว 2×2 (13 mm), ระยะถ่าง 33 mm, ตัวล็อกแบบเฟืองสับ | $89 |
| ปลอก / กล่องป้องกัน | บรรจุภัณฑ์แยกชิ้นสำหรับการขนส่ง | $89 |

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner เป็นเครื่องถ่างแผลเฉพาะทางสำหรับศัลยกรรมหูและจุลศัลยกรรม ออกแบบมาเพื่อถ่างเนื้อเยื่ออ่อนและเยื่อหุ้มกระดูกอย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้มือจับค้างไว้ ในช่องทางเข้าผ่าตัดที่แคบ โครงด้ามห่วงสอดนิ้วแบบเยื้องแนวและเตี้ยช่วยคงการเปิดแผลหลังใบหูและหนังศีรษะด้วยแรงดึงเชิงกล ลดปัญหาความเมื่อยล้าของมือผู้ช่วย พร้อมรักษาทัศนวิสัยที่เปิดโล่งภายใต้กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด

เครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner รุ่นนี้มีรูปแบบมาตรฐานที่ออกแบบให้มองเห็นได้โดยไม่มีสิ่งบดบัง และมีความยาวรวม 5 inches (12.7 cm, $89) ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ส่วนปลายใช้งานมีเขี้ยวจัดเรียงแบบไม่สมมาตร 2×2 ความยาวเขี้ยว 13.0 mm และระยะถ่างสูงสุดซึ่งวัดจากระยะเคลื่อนที่รวมของปากถ่าง 33.0 mm ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกสำหรับการยึดเนื้อเยื่อ ได้แก่ เขี้ยวแหลมเพื่อยึดเนื้อเยื่อที่เหนียวได้อย่างมั่นคง หรือเขี้ยวทู่สำหรับจัดเนื้อเยื่ออ่อนโดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เฟืองล็อกแบบเฟืองสับที่ยึดแน่นช่วยคงแรงดึงได้อย่างเชื่อถือได้ตลอดการกรอกระดูก

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เอง Paparella-Weitlaner ด้วยการตีขึ้นรูปและตกแต่งผิวด้านแบบซาตินเพื่อลดแสงสะท้อน ให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่องออโตเคลฟซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล พร้อมมอบความมั่นคงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความทนทานครบถ้วนสำหรับการใช้งานทางคลินิกในห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิกและประสาทศัลยกรรมทั่วโลก

# ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

## ติดต่อ RETRACTOR MAKER


อีเมล

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

เว็บไซต์

**retractormaker.com**
**retractormanufacturer.com**

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan


## ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest