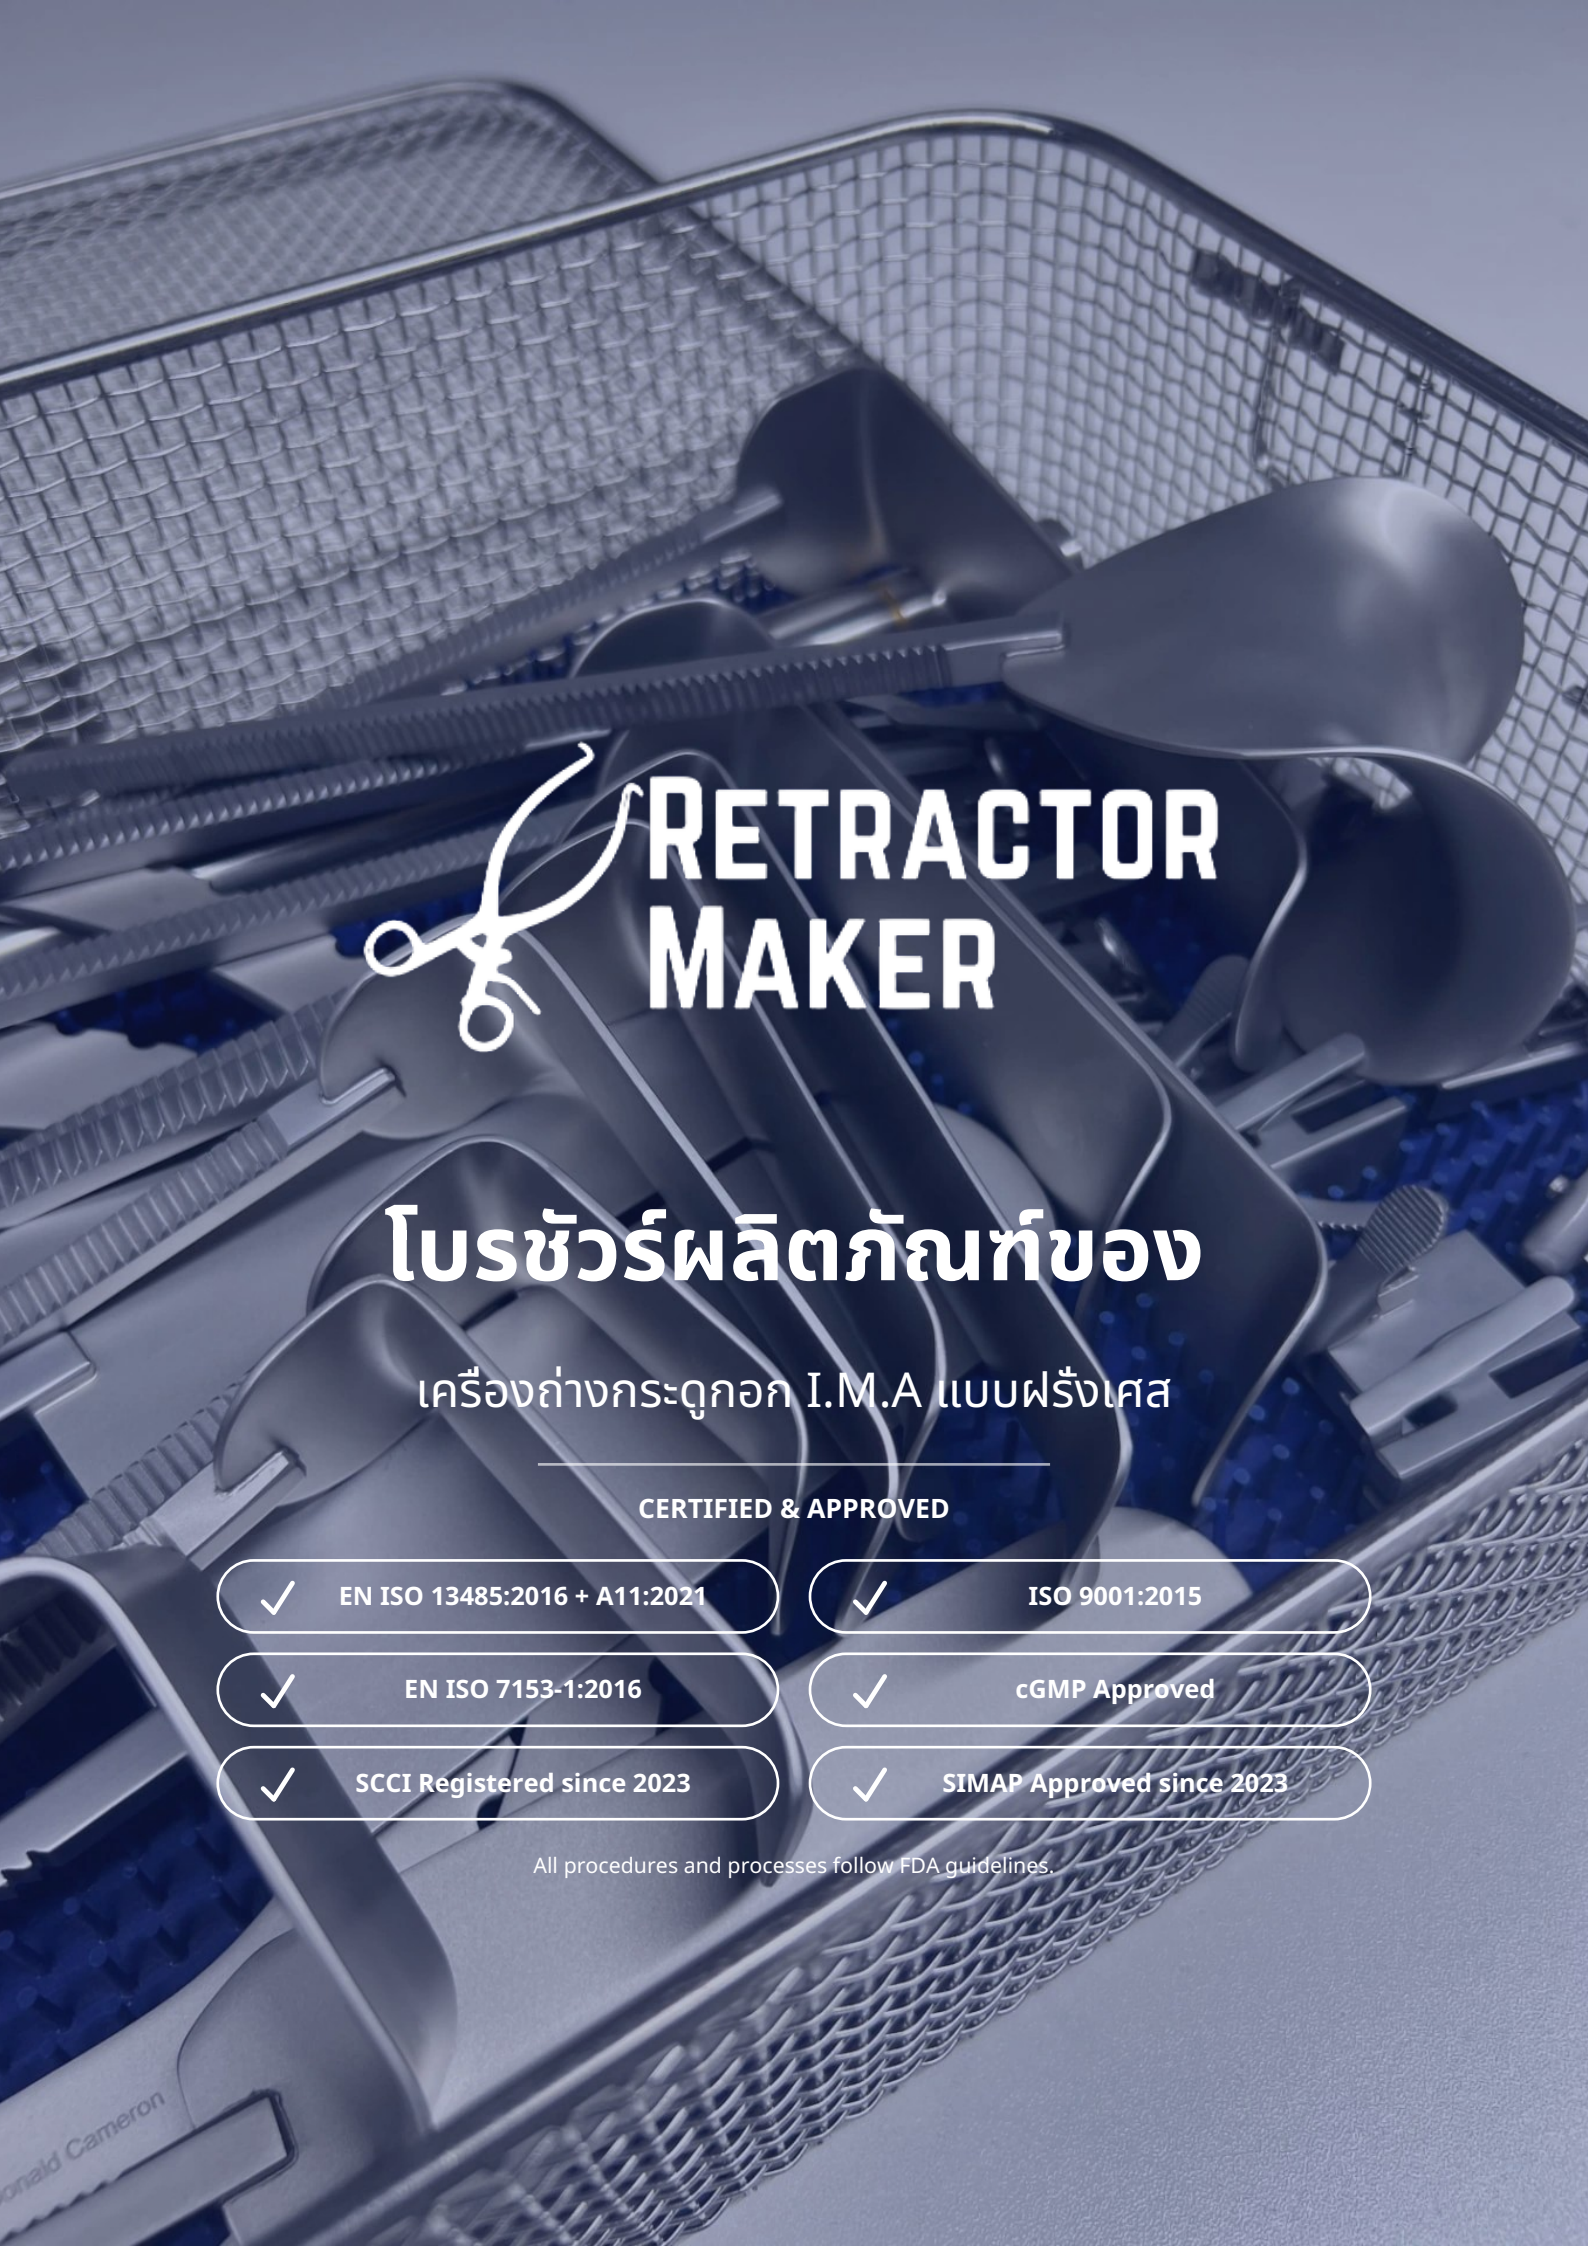


RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างกระดูกอก I.M.A แบบฝรั่งเศส

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

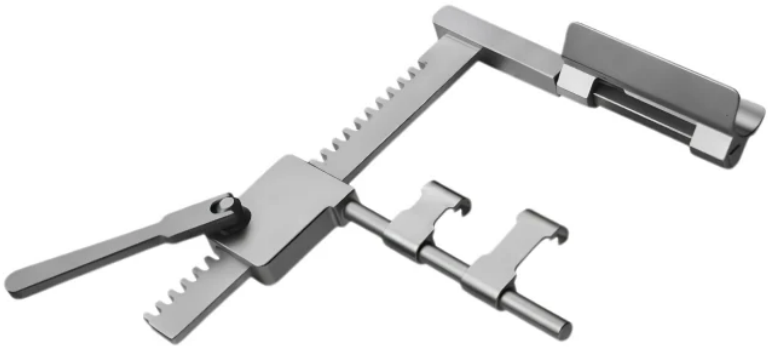

เครื่องถ่างกระดูกอก I.M.A แบบฝรั่งเศส

SKU RM-FPIMASR-429-1

$429 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	รางโครงหลักแบบเลื่อน	โครงด้านข้างออกแบบเพื่อกำหนดแนวและถ่างแยกโครงสร้างทรวงอก
1	ชิ้นส่วนใบถ่างกระดูกอกหน้ากว้าง	ใบถ่างทรงพายแบนเรียบขนาด 100 mm × 20 mm สำหรับกระจายแรงบนกระดูกอก
2	ใบถ่างกระดูกอกแบบตะขอทีไม่สมมาตร	ตะขอดึงโค้งคู่ ออกแบบให้มีความลึกของตะขอ 28 mm หรือ 32 mm
3	สกรูล็อกแรงดึงเฉพาะใบถ่าง	กลไกล็อกแยกอิสระ ติดตั้งเพื่อยึดใบถ่างทุกใบให้อยู่ในตำแหน่ง
2	แขนคีมถ่างตามหลักสรีรศาสตร์	คานด้ามจับน้ำหนักเบารูปทรงเพรียว พร้อมขอบด้านนอกทีเรียบ
1	ภาชนะจัดเก็บป้องกันความเสียหาย / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับการขนส่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างกระดูกอก I.M.A แบบฝรั่งเศส เป็นระบบถ่างชั้นนำสำหรับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อยกกระดูกอกด้านเดียวและเปิดพื้นที่ผ่าตัดให้กว้างระหว่างการเก็บหลอดเลือดแดงทรวงอกภายใน (IMA / LIMA) ในการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โครงแบบหลายใบถ่างทีไม่สมมาตรช่วยให้ศัลยแพทย์ยกขอบกระดูกอกด้านหนึ่ง พร้อมออกแรงดึงต้านเพื่อรักษาความมั่นคงที่ด้านตรงข้าม ทำให้มองเห็นแนวหลอดเลือดทรวงอกภายในได้อย่างชัดเจน

เครื่องถ่างกระดูกอก I.M.A แบบฝรั่งเศสชุดสมบูรณ์ ($429) ผลิตตามข้อกำหนดด้านโครงสร้างสำหรับการใช้งานทางคลินิก ประกอบด้วยรางโครงหลักแบบเลื่อนที่แข็งแรงทนทาน พร้อมแขนคีมถ่างทีออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และขึ้นรูปด้วยขอบด้านนอกทีเรียบ ผลิตด้วยมือจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ใบถ่างกระดูกอกหลักแบบหน้ากว้างมีพื้นที่สัมผัสขนาด 100 mm × 20 mm (กว้าง 20 mm × ยาว 100 mm) เพื่อกระจายแรงยกบนกระดูกอกอย่างสม่ำเสมอ ระบบนี้มีใบถ่างกระดูกอกแบบตะขอคู่ทีไม่สมมาตร พร้อมตัวเลือกความลึกแบบโมดูลาร์ 28 mm หรือ 32 mm โดยแต่ละใบยึดแน่นด้วยสกรูล็อกแรงดึงเฉพาะใบ เพื่อให้คงตำแหน่งได้อย่างมั่นคง

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างกระดูกอก I.M.A แบบฝรั่งเศสด้วยการขึ้นรูปและตกแต่งผิวซาตินด้านลดแสงสะท้อน เพื่อให้ทนต่อรอบการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งไอน้ำของโรงพยาบาลซ้ำ ๆ มอบความมั่นคงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความทนทานต่อการนึ่งฆ่าเชื้อครบทั้งระบบ สำหรับห้องผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ศูนย์โรคหัวใจ และห้องผ่าตัดทรวงอกทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest