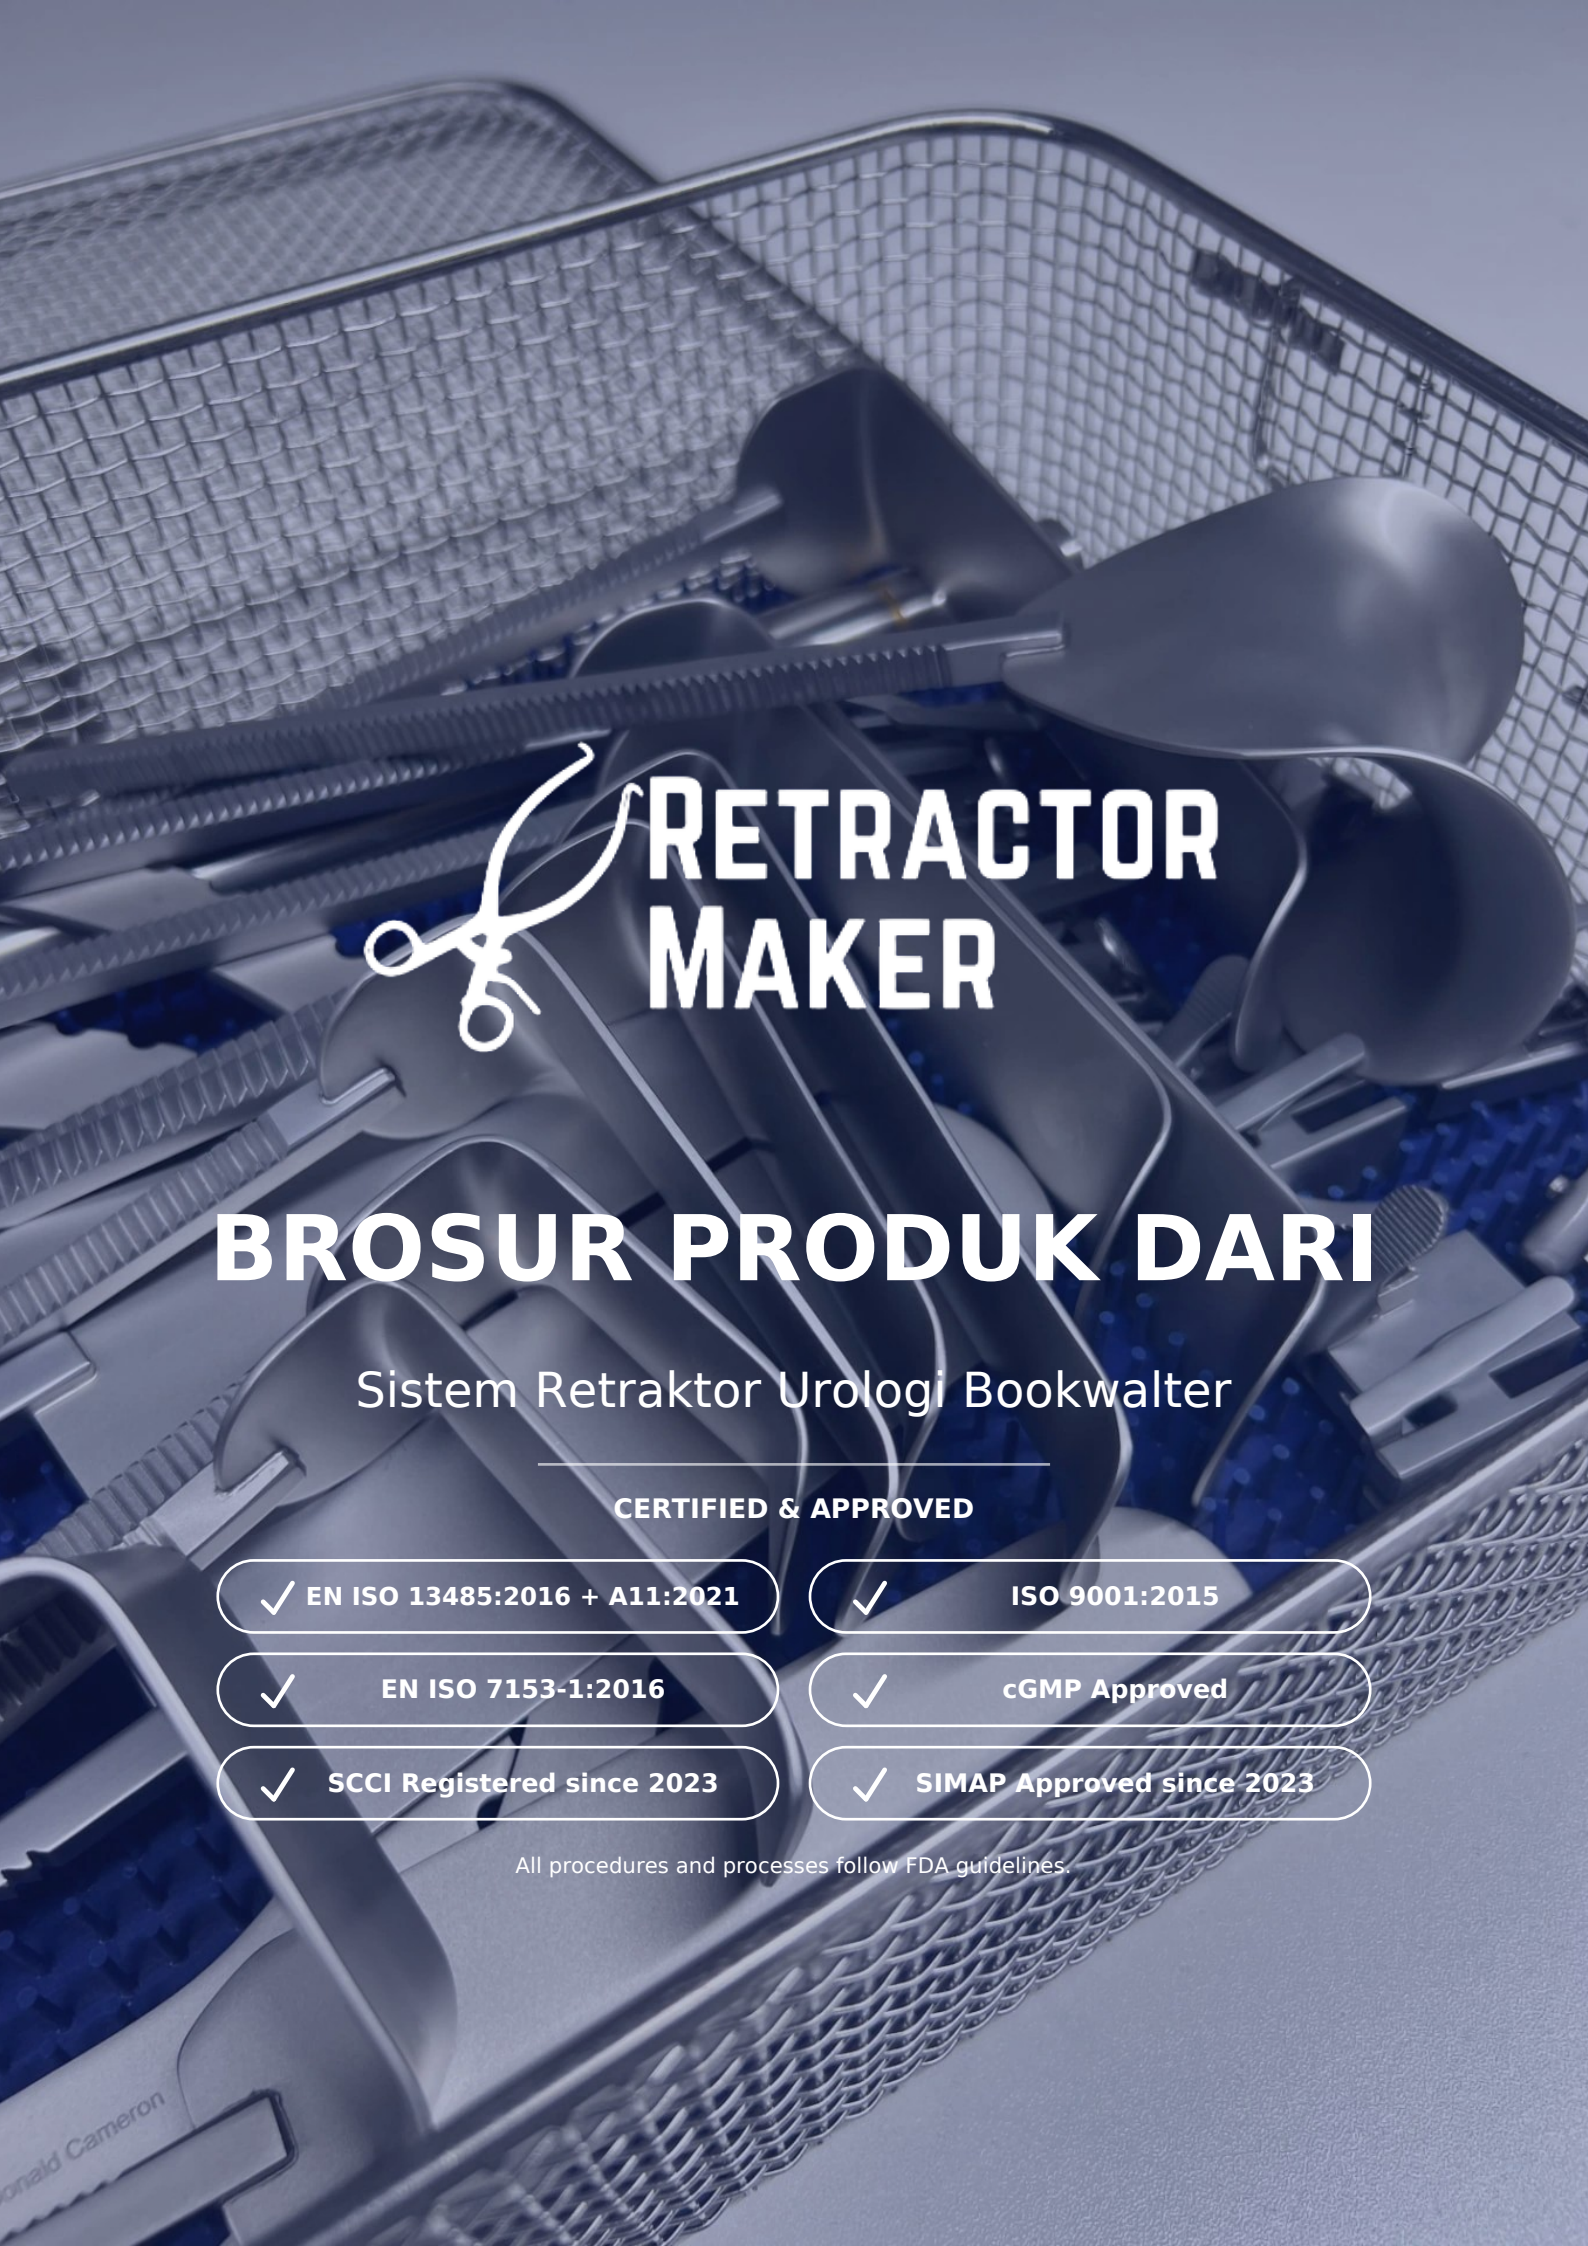


RETRACTOR MAKER


BROSUR PRODUK DARI

Sistem Retraktor Urologi Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

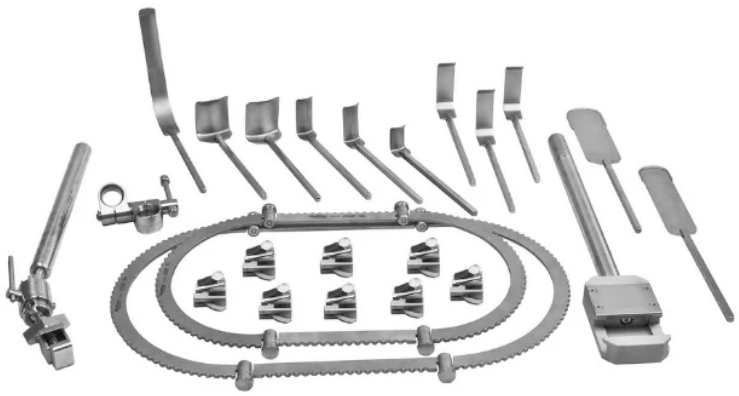

Sistem Retraktor Urologi Bookwalter

SKU RM-BURS-1

$2,399 USD

DAFTAR KOMPONEN

JUMLAH	KOMPONEN	DIMENSI / DESKRIPSI
1	Tiang Penyangga	12″ (30.5 cm)
1	Konektor Tiang	Standar
1	Batang Fleksibel Horizontal	Diameter 1″ (2.5 cm)
8	Mekanisme Ratchet Pengatur Kemiringan	Multisudut
1	Cincin Bersegmen	10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1	Cincin Bersegmen	8½″ × 14″ (21.6 × 35.6 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	Bilah yang Dapat Dibentuk	1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
2	Bilah Kelly	1″ × 2½″ (2.5 × 6.4 cm)
1	Bilah Kelly	1″ × 1½″ (2.5 × 3.8 cm)
2	Bilah Kelly	2″ × 2½″ (5.1 × 6.4 cm)
3	Bilah Lateral Vagina	1″ × 3″ (2.5 × 7.6 cm)
1	Bilah Ginjal Wylie	1″ × 7″ (2.5 × 17.8 cm)
1	Kotak Sterilisasi	Wadah Pelindung

DESKRIPSI PRODUK

Sistem Retraktor Urologi Bookwalter adalah set retraktor yang dipasang pada meja operasi dan dapat menahan posisinya sendiri, dirancang untuk memberikan eksposur yang stabil tanpa perlu dipegang selama pendekatan abdomen dan pinggang ke ginjal, ureter, kandung kemih, serta struktur urologi retroperitoneal. Sistem Retraktor Urologi Bookwalter dipasang pada meja operasi menggunakan tiang penyangga 12″ (30.5 cm), konektor tiang standar, dan batang fleksibel horizontal berdiameter 1″ (2.5 cm).

Dua cincin bersegmen disertakan — 10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm) dan 8½″ × 14″ (21.6 × 35.6 cm) — sehingga rangka dapat disesuaikan dengan insisi dan pasien. Delapan mekanisme ratchet pengatur kemiringan multisudut mengunci bilah pada cincin dan memungkinkan kedalaman retraksi serta sudut bilah diatur secara terpisah.

Komponen retraksi mencakup kebutuhan eksposur dalam dan superfisial: bilah yang dapat dibentuk berukuran 2″ × 6″ dan 1½″ × 6″, bilah Kelly berukuran 1″ × 2½″, 1″ × 1½″, dan 2″ × 2½″, tiga bilah lateral vagina 1″ × 3″, serta satu bilah ginjal Wylie 1″ × 7″. Semua komponen dibuat dari Baja Tahan Karat AISI 304/316 Kualitas Premium (Nonmagnetik) dan disertakan dalam kotak sterilisasi.

Sistem Retraktor Urologi Bookwalter dipasok dalam kondisi nonsteril, dapat digunakan kembali dan seluruhnya dapat disterilkan dengan autoklaf, serta harus dibersihkan dan disterilkan sesuai prosedur tervalidasi di fasilitas Anda sebelum digunakan. Retractor Maker memproduksi dan memasok set ini langsung dari Sialkot, Pakistan.

TERIMA KASIH

Kami menantikan kesempatan untuk mendiskusikan kebutuhan retraktor bedah Anda.

HUBUNGI RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Situs Web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ALAMAT

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

IKUTI KAMI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest