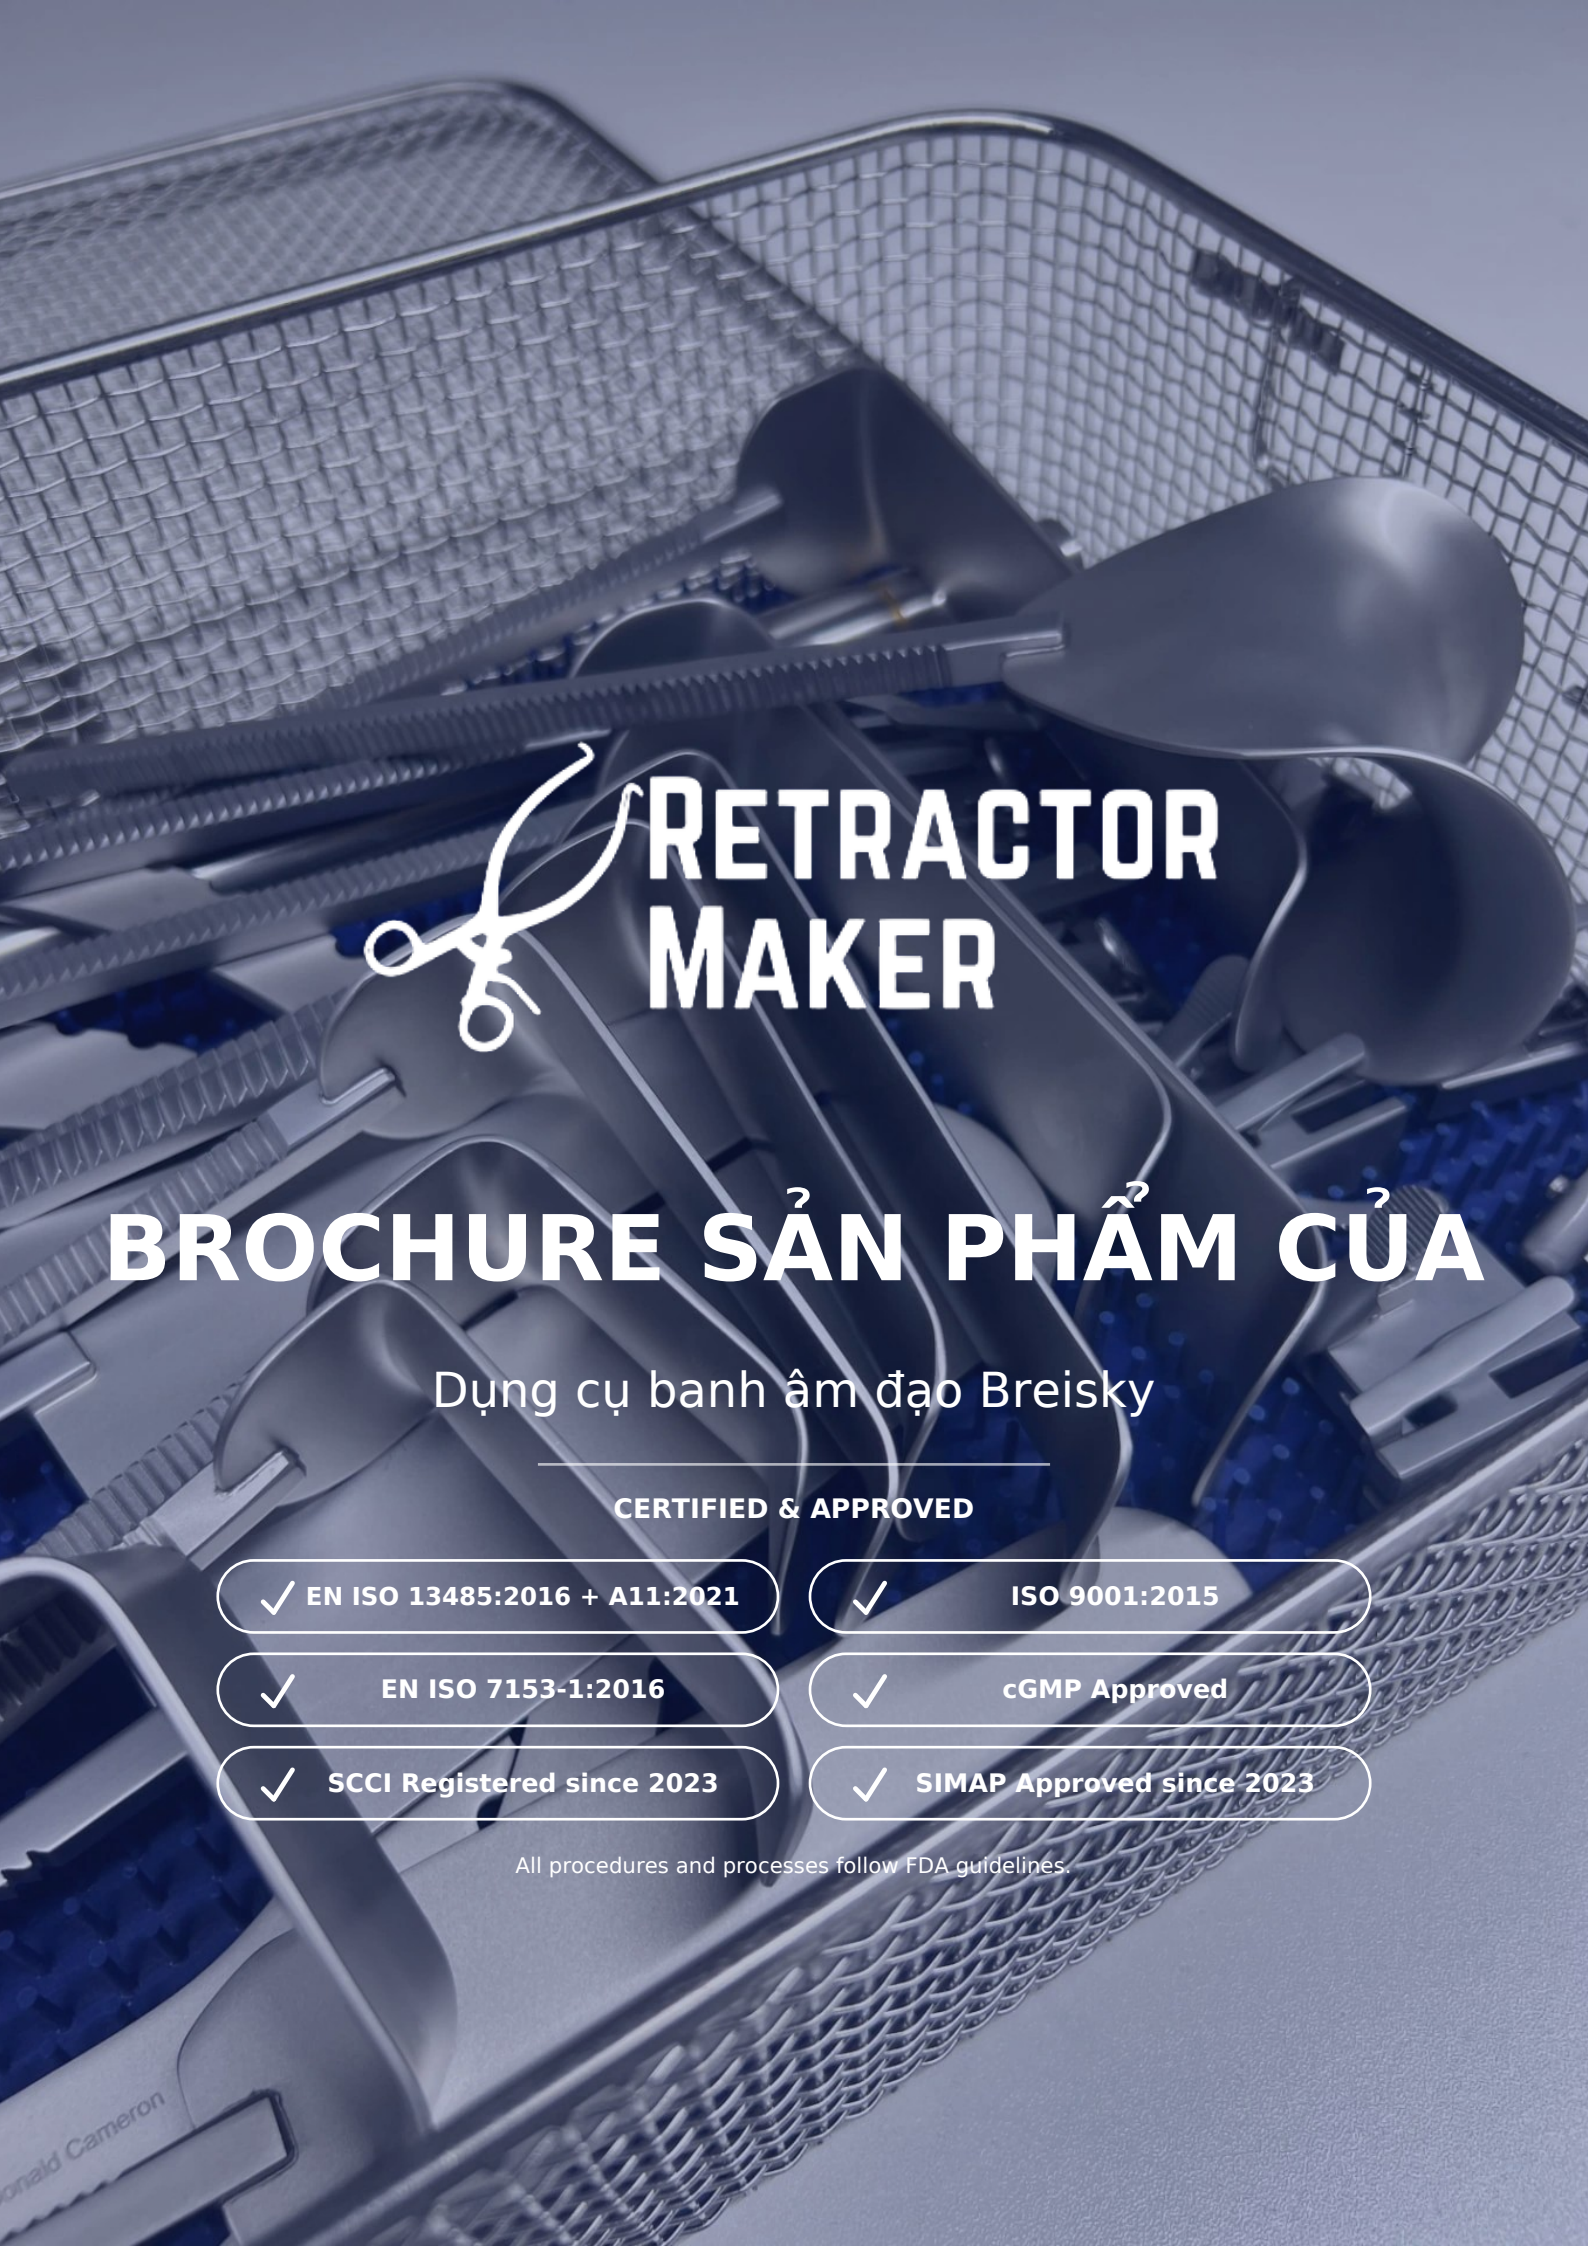


RETRACTOR MAKER

BROCHURE SẢN PHẨM CỦA

Dụng cụ banh âm đạo Breisky

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dụng cụ banh âm đạo Breisky

SKU RM-BVR-1

$89 USD

DANH SÁCH LINH KIỆN

SỐ LƯỢNG	LINH KIỆN	KÍCH THƯỚC / MÔ TẢ
1	100 mm × 25 mm — 28 cm đến 36 cm	Bộc lộ phần nông âm đạo và cửa âm đạo — $89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm đến 36 cm	Giữ thành trước/sau âm đạo trên diện rộng — $89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm đến 36 cm	Bộc lộ vòm âm đạo ở độ sâu trung bình — $94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm đến 36 cm	Tái tạo sàn chậu sâu — $94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm đến 36 cm	Tiếp cận cổ tử cung trong phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo — $99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm đến 36 cm	Tiếp cận sâu vòm âm đạo ở bệnh nhân đã sinh con — $99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm đến 36 cm	Tiếp cận vùng chậu và đỉnh âm đạo ở độ sâu tối đa — $104.00
1	Bao bảo vệ / Hộp	Bao bì tiêu chuẩn — Đã bao gồm

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Dụng cụ banh âm đạo Breisky là dụng cụ banh cao cấp dùng trong phẫu thuật phụ khoa và tái tạo vùng chậu, được thiết kế chuyên biệt để quan sát sâu, không bị che khuất vùng vòm âm đạo và cổ tử cung. Với lưỡi dạng thìa dài, nhẵn và cong nhẹ ở đầu xa, dụng cụ này đè thành âm đạo và đẩy các mô mềm xung quanh sang bên mà không kẹp hoặc làm rách niêm mạc.

Để phù hợp với sự khác biệt về giải phẫu ở từng bệnh nhân và các thủ thuật vùng chậu sâu, dụng cụ banh âm đạo Breisky có các tùy chọn chiều dài tổng thể 28 cm ($89), 31 cm ($94), 33.5 cm ($99) và 36 cm ($104), cùng các đợt sản xuất mở rộng đáp ứng kích thước tổng thể lên đến 15.25 inches (38.73 cm). Phẫu thuật viên có thể lựa chọn 10 kích thước lưỡi khác nhau, từ 100 × 25 mm đến 180 × 25 mm. Tay cầm phẳng có rãnh, tạo góc theo công thái học, giúp người phụ mổ duy trì lực kéo đối kháng ổn định và kiểm soát chắc chắn, không trượt trong các ca phẫu thuật vùng chậu kéo dài.

Được rèn từ thép không gỉ cao cấp AISI 304/316 (không nhiễm từ) với bề mặt hoàn thiện satin mờ không phản chiếu, dụng cụ banh âm đạo Breisky do Retractor Maker sản xuất có khả năng chịu được các chu trình tiệt khuẩn lặp lại tại bệnh viện, mang đến cho đội ngũ sản khoa, phụ khoa và niệu phụ khoa khả năng chống ăn mòn cao cùng độ bền đáng tin cậy.

XIN CẢM ƠN

Chúng tôi mong muốn được thảo luận về các yêu cầu banh phẫu thuật của quý vị.

LIÊN HỆ RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Website

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ĐỊA CHỈ

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

THEO DÕI CHÚNG TÔI

LinkedIn Facebook Instagram X (Twitter) YouTube Pinterest