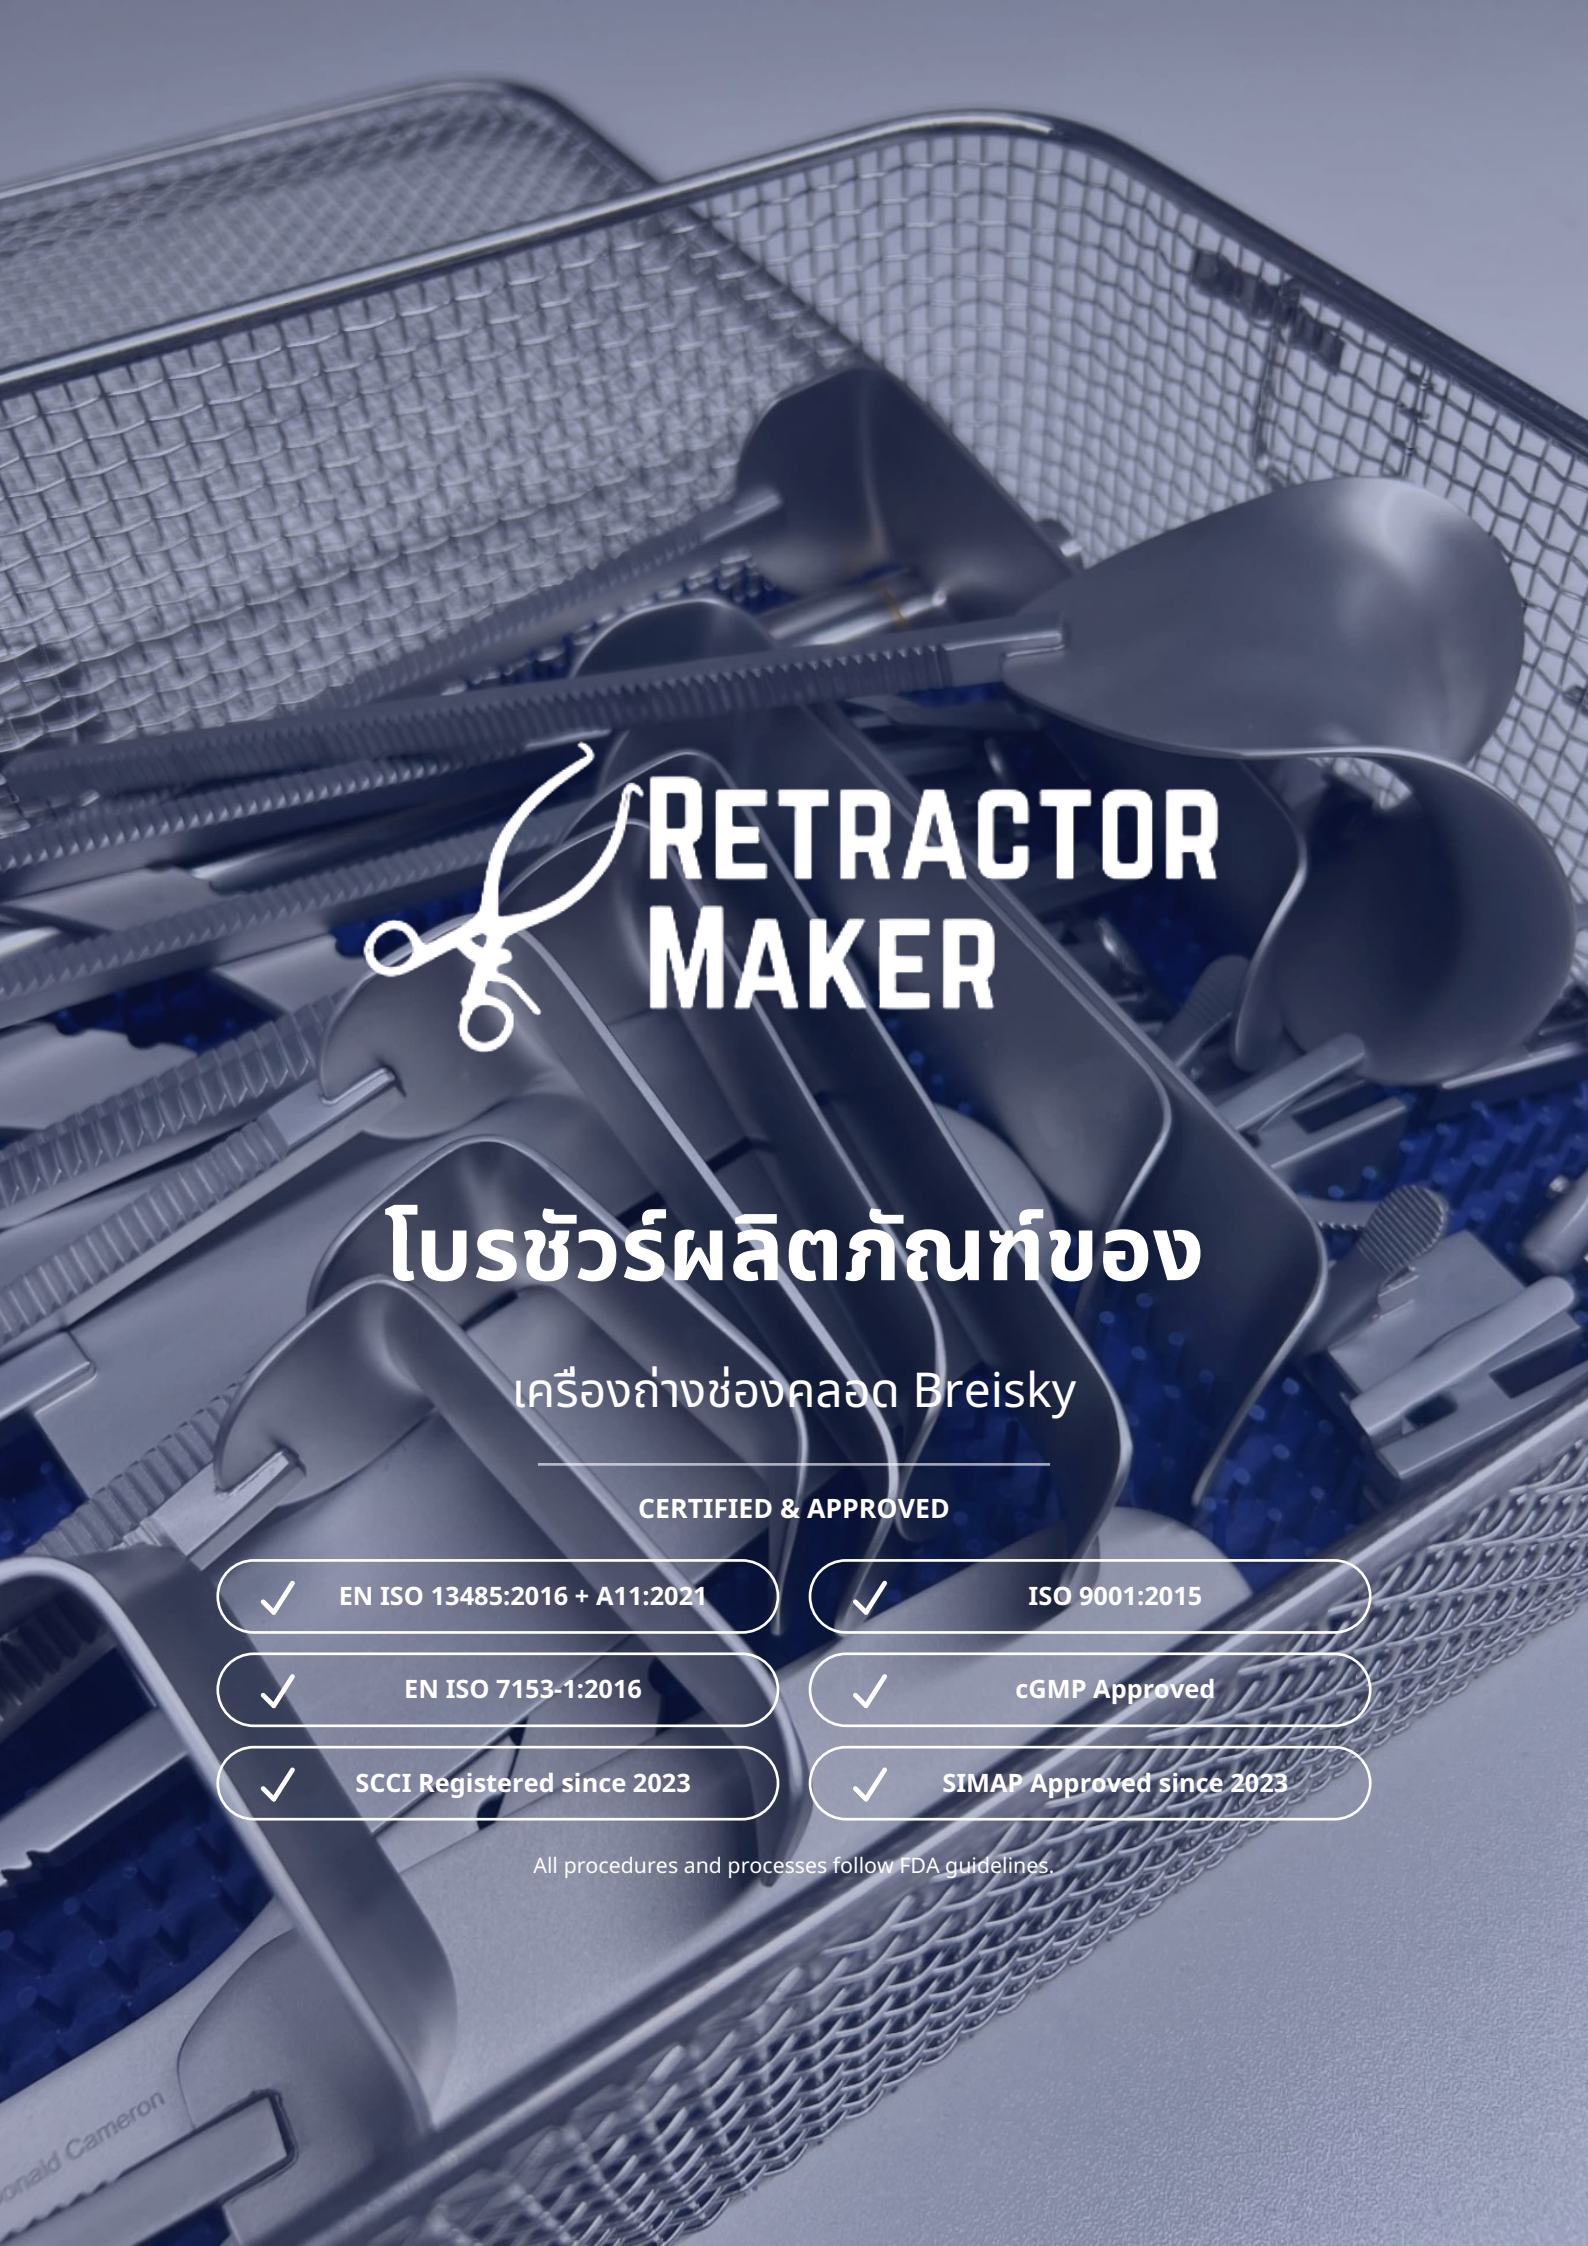


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างช่องคลอด Breisky

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างช่องคลอด Breisky

SKU RM-BVR-1

$89 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	100 mm × 25 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เปิดช่องคลอดส่วนต้นและปากช่องคลอด — $89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm ถึง 36 cm	ถ่างค้างผนังช่องคลอดด้านหน้า/ด้านหลังเป็นบริเวณกว้าง — $89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เปิดส่วนยอดช่องคลอดที่ความลึกปานกลาง — $94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm ถึง 36 cm	ผ่าตัดเสริมสร้างอุ้งเชิงกรานส่วนลึก — $94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เข้าถึงปากมดลูกในการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด — $99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เข้าถึงส่วนยอดช่องคลอดที่อยู่ลึกในผู้ที่เคยคลอดบุตร — $99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm ถึง 36 cm	เข้าถึงอุ้งเชิงกรานและส่วนยอดช่องคลอดที่ระดับความลึกสูงสุด — $104.00
1	ปลอกป้องกัน / กล่อง	บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน — รวมอยู่แล้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างช่องคลอด Breisky เป็นเครื่องถ่างคุณภาพสูงสำหรับการผ่าตัดทางนรีเวชและการผ่าตัดเสริมสร้างอุ้งเชิงกราน ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มองเห็นส่วนยอดช่องคลอดและปากมดลูกในระดับลึกได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งบดบัง ใบถ่างรูปไม้พายที่เรียบและยาว พร้อมปลายโค้งมนอย่างนุ่มนวล ช่วยกดผนังช่องคลอดและแหวกเนื้อเยื่ออ่อนโดยรอบออกโดยไม่หนีบหรือทำให้เยื่อบุฉีกขาด

เครื่องถ่างช่องคลอด Breisky ออกแบบมาให้รองรับความแตกต่างทางกายวิภาคของผู้ป่วยและหัตถการในอุ้งเชิงกรานส่วนลึก มีความยาวรวมให้เลือก ได้แก่ 28 cm ($89), 31 cm ($94), 33.5 cm ($99) และ 36 cm ($104) พร้อมการผลิตเพิ่มเติมที่รองรับรูปแบบความยาวได้ถึง 15.25 inches (38.73 cm) ศัลยแพทย์สามารถเลือกใบถ่างได้ 10 ขนาด ตั้งแต่ 100 × 25 mm ถึง 180 × 25 mm ด้ามจับแบนเซาะร่องที่ทำมุมตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ผู้ช่วยผ่าตัดออกแรงดึงต้านได้อย่างมั่นคงและควบคุมเครื่องมือได้โ

ดยไม่ลื่นหลุดระหว่างการผ่าตัดอุ้งเชิงกรานที่ใช้เวลานาน

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างช่องคลอด Breisky โดยขึ้นรูปด้วยการตีจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก) พร้อมผิวซาตินด้านที่ไม่สะท้อนแสง เพื่อให้ทนต่อรอบการทำให้ปราศจากเชื้อซ้ำในโรงพยาบาล
มอบความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงและความคงทนที่เชื่อถือได้สำหรับทีมสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา และนรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest