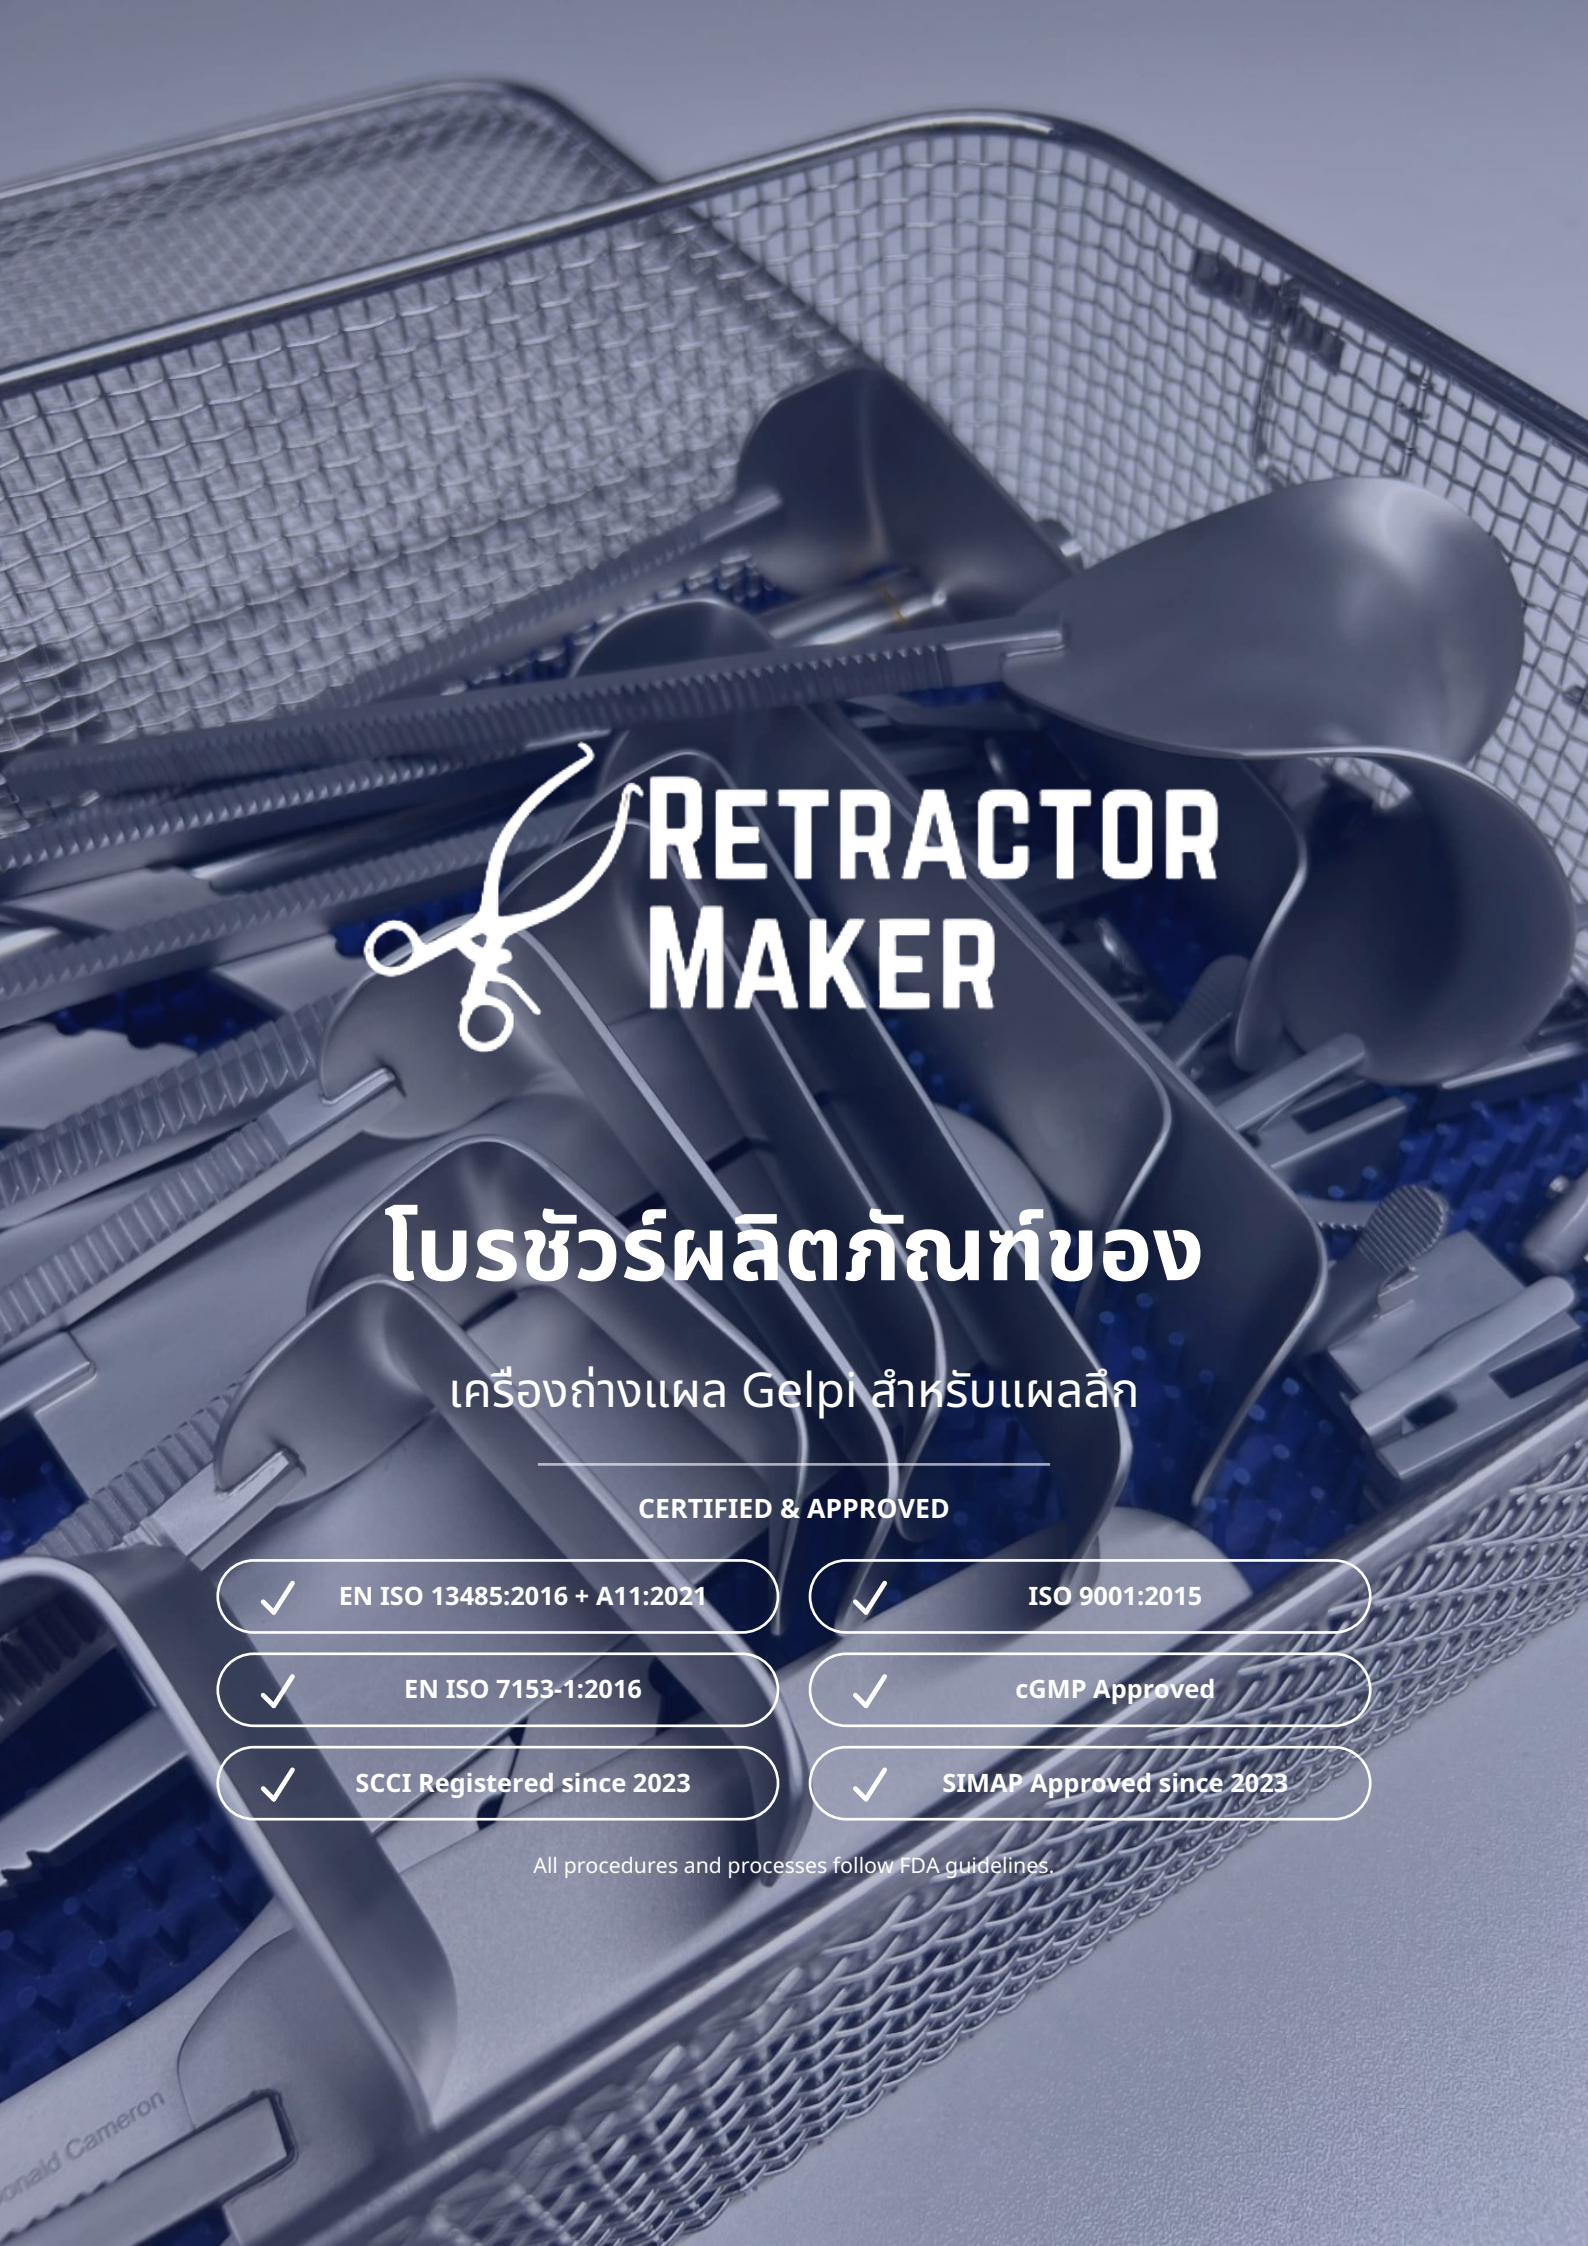


RETRACTOR MAKER

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Gelpi สำหรับแผลลึก

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



เครื่องถ่างแผล Gelpi สำหรับแผลลึก

SKU RM-DGR-SERIES-1

$68 USD

ขนาดและราคาที่มีจำหน่าย

ขนาด / ตัวเลือก	SKU / รายละเอียด	ราคา (USD)
3 ½″ – 4 ½″ — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทำมุม, 90°, หักมุมฉาก — การเปิดบริเวณผ่าตัดสำหรับศัลยกรรมเล็กระดับตื้น การผ่าตัดมือ และศัลยกรรมเด็ก	RM-DGR-SERIES-1-1	$68
5 ½″ – 6 ¾″ — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทำมุม, 90°, หักมุมฉาก — การเปิดเข้าถึงเนื้อเยื่ออ่อนระดับความลึกปานกลาง งานศัลยกรรมตกแต่ง และบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ	RM-DGR-SERIES-1-2	$74
7 ½″ – 7 ¾″ — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทำมุม, 90°, หักมุมฉาก — การผ่าตัดตัดแผ่นกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบมาตรฐาน และการถ่างบริเวณข้อ	RM-DGR-SERIES-1-3	$84
9 ¼″ – 12″ — ปลายแหลม, ปลายทู่, ปลายแหลมทำมุม, 90°, หักมุมฉาก — การผ่าตัดในช่องลึกบริเวณอุ้งเชิงกราน การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน และการเชื่อมกระดูกสันหลังหลายระดับ	RM-DGR-SERIES-1-4	$94

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Gelpi สำหรับแผลลึก เป็นเครื่องมือผ่าตัดแบบค้างได้เองที่สำคัญ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่างเนื้อเยื่อในระดับความลึกต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง สำหรับการผ่าตัดหลากหลายสาขา ปลายเขี้ยวโค้งออกด้านนอกยึดกับขอบแผลได้แน่น
ช่วยให้ทีมผ่าตัดเปิดพื้นที่เข้าถึงบริเวณผ่าตัดได้กว้าง โดยไม่ทำให้ผู้ช่วยเกิดความเมื่อยล้าจากการถือเครื่องมือถ่างแผลด้วยมือ

เครื่องถ่างแผล Gelpi สำหรับแผลลึกรุ่นนี้ออกแบบให้รองรับทุกระดับความลึกทางกายวิภาคและสถานการณ์ทางคลินิก
โดยมีตัวเลือกที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย ศัลยแพทย์สามารถเลือกความยาวรวมได้สิบขนาด ได้แก่ 3 ½″ ($68), 4 ½″ ($72), 5 ½″ ($76), 6 ½″ ($74), 6 ¾″ ($80), 7 ½″ ($84), 7 ¾″ ($88), 9 ¼″ ($94), 11″ ($102) และ 12″ ($109)
ส่วนปลายและแขนใช้งานมีให้เลือกทั้งแบบปลายแหลม ปลายทู่ ปลายแหลมทำมุม ทำมุม 90 องศา และแขนหักมุมฉาก
กลไกล็อกเฟืองบนด้ามห่วงนิ้วทีผลิตอย่างแม่นยำช่วยล็อกตำแหน่งได้มั่นคงแม้มีแรงต้านจากเนื้อเยื่อ

Retractor Maker ผลิตเครื่องถ่างแผล Gelpi สำหรับแผลลึกด้วยการขึ้นรูปจากสเตนเลสเกรดพรีเมียม AISI 304/316 (ไม่เป็นแม่เหล็ก)
พร้อมผิวซาตินด้านที่ไม่สะท้อนแสง เพื่อให้ทนต่อการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงซ้ำหลายรอบในโรงพยาบาล
มอบความแข็งแกร่งเชิงกลที่ยอดเยี่ยม กลไกเฟืองที่ทำงานราบรื่น และความทนทานตลอดอายุการใช้งานให้แก่ห้องผ่าตัดทั่วโลก

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest