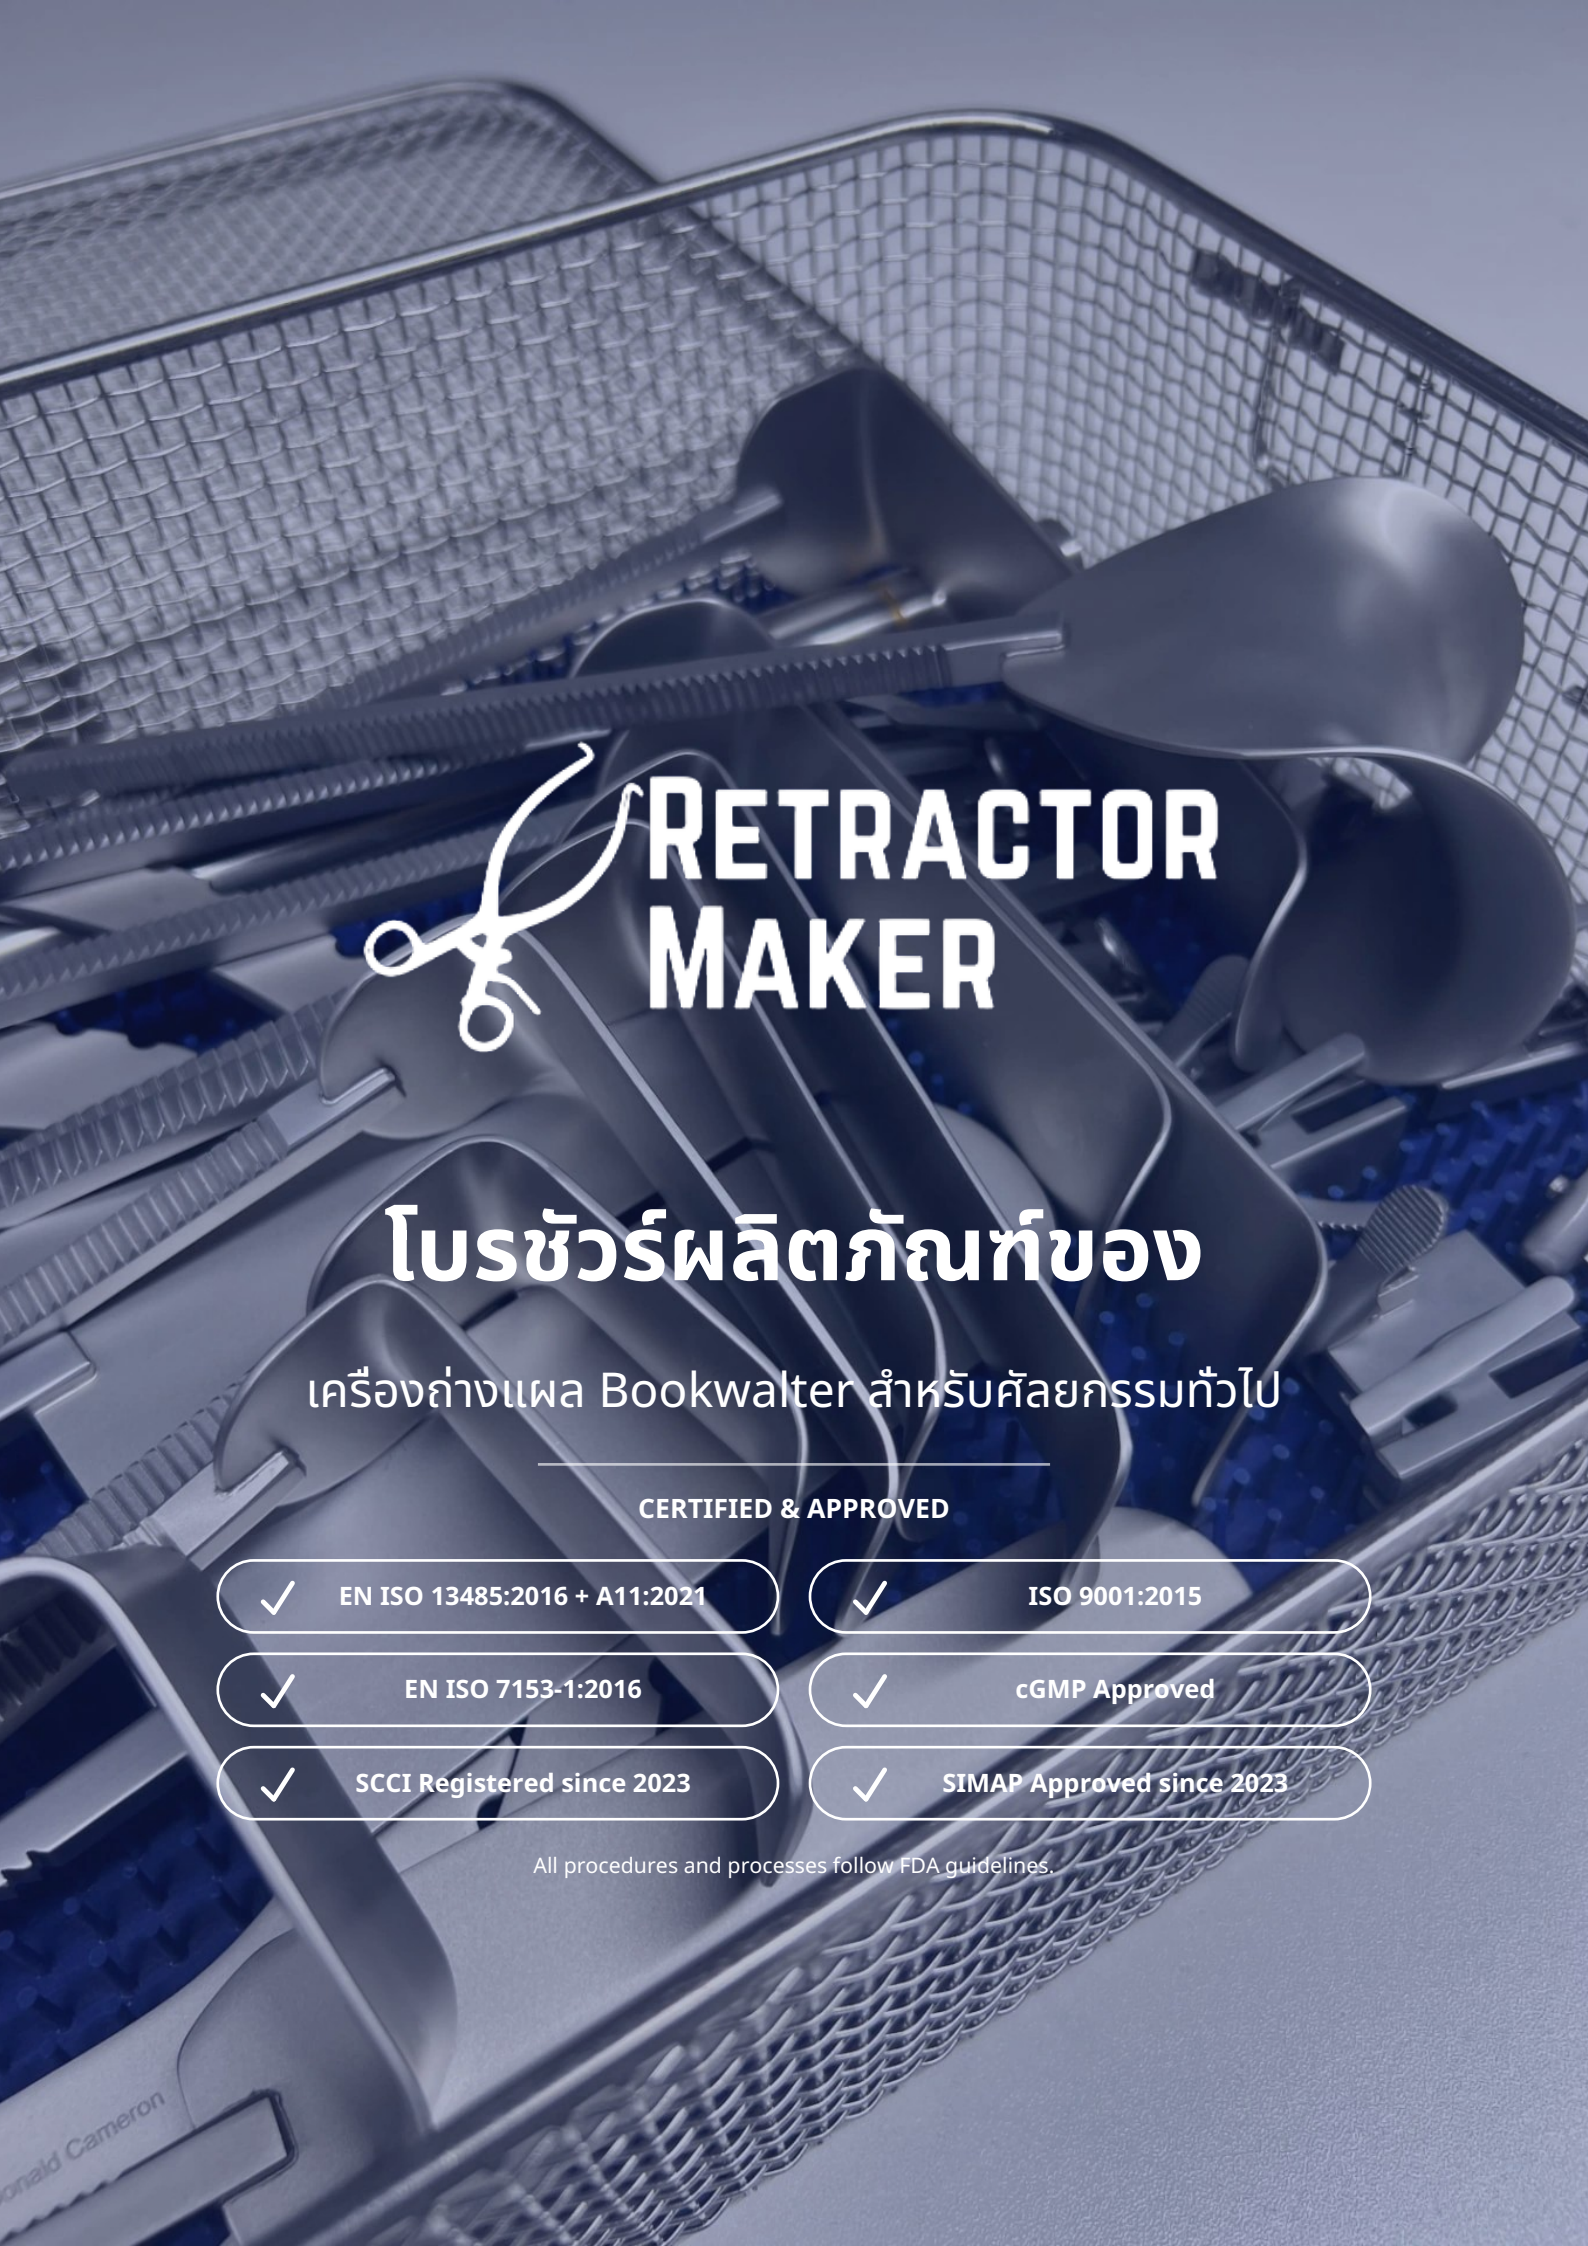


RETRACTOR MAKER


โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ของ

เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับศัลยกรรมทั่วไป

CERTIFIED & APPROVED

- ✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021
- ✓ ISO 9001:2015
- ✓ EN ISO 7153-1:2016
- ✓ cGMP Approved
- ✓ SCCI Registered since 2023
- ✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

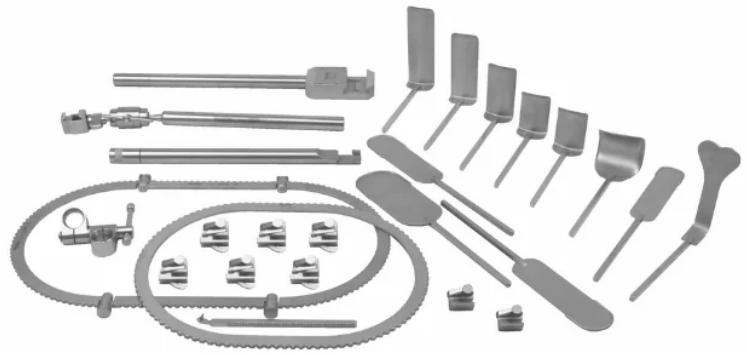

เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับศัลยกรรมทั่วไป

SKU RM-BGSR-1

$1,999 USD

รายการส่วนประกอบ

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
1	เสายึดบริเวณผ่าตัด	12″ (30.5 cm)
1	คานแนวนอน	แบบมาตรฐาน
1	ข้อต่อเสา	แบบมาตรฐาน
1	คานแนวนอนแบบปรับแนวได้	เส้นผ่านศูนย์กลาง 1″ (2.5 cm)
2	กลไกเฟืองล็อกมาตรฐาน	แบบปรับเอียงไม่ได้
6	กลไกเฟืองล็อกแบบปรับเอียงได้	ปรับได้หลายมุม
1	วงแหวนรูปไข่ ขนาดกลาง	10½″ × 14½″ (26.7 × 36.8 cm)
1	วงแหวนแบบแบ่งส่วน ขนาดกลาง	10½″ × 19″ (26.7 × 48.3 cm)
1	ใบถ่างแผล Balfour	2⅝″ × 3″ (6.7 × 7.6 cm)
2	ใบถ่างแผล Kelly	2″ × 3″ (5.1 × 7.6 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2″ × 4″ (5.1 × 10.2 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2″ × 5″ (5.1 × 12.7 cm)
1	ใบถ่างแผล Kelly	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	3″ × 6″ (7.6 × 15.2 cm)

จำนวน	ส่วนประกอบ	ขนาด / รายละเอียด
2	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	2″ × 6″ (5.1 × 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผลแบบดัดโค้งได้	1½″ × 6″ (3.8 × 15.2 cm)
1	ใบถ่างแผล Harrington	1″ × 5⅝″ × 2½″ (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	ใบถ่างแผล Gelpi	แบบมาตรฐาน
1	กล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ	กล่องป้องกันเครื่องมือ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับศัลยกรรมทั่วไป เป็นเครื่องถ่างแผลแบบคงตำแหน่งได้เองที่ยึดกับโต๊ะผ่าตัด ออกแบบมาเพื่อเปิดบริเวณผ่าตัดให้เห็นได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้มือจับระหว่างการผ่าตัดช่องท้องแบบเปิดและการผ่าตัดทั่วไป โครงสร้างแบบโมดูลาร์ประกอบด้วยเสายึดบริเวณผ่าตัด คานแนวนอน คานแนวนอนแบบปรับแนวได้ ข้อต่อเสา วงแหวนเครื่องถ่างแผล และกลไกเฟืองล็อกที่ปรับได้ เพื่อรองรับใบถ่างแผลที่เลือกใช้รอบบริเวณผ่าตัด

ชุดสำหรับศัลยกรรมทั่วไปประกอบด้วยวงแหวนรูปไข่ขนาดกลาง วงแหวนแบบแบ่งส่วนขนาดกลาง กลไกเฟืองล็อกมาตรฐานแบบปรับเอียงไม่ได้สองชิ้น และกลไกเฟืองล็อกแบบปรับเอียงได้หลายมุมหกชิ้น ภายในชุดยังมีใบถ่างแผล Balfour, Kelly, แบบดัดโค้งได้, Harrington และ Gelpi ในรูปแบบต่าง ๆ

ระบบครบชุดบรรจุในกล่องสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อโดยเฉพาะ เพื่อให้จัดเก็บและดำเนินกระบวนการเตรียมเครื่องมือได้อย่างเป็นระเบียบ เครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับศัลยกรรมทั่วไปจัดส่งในสภาพไม่ปราศจากเชื้อ และออกแบบให้ใช้ซ้ำและนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้ ก่อนใช้งานควรทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อตามขั้นตอนที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของสถานพยาบาล

Retractor Maker จัดจำหน่ายเครื่องถ่างแผล Bookwalter สำหรับศัลยกรรมทั่วไปโดยตรงให้แก่โรงพยาบาล ผู้จัดจำหน่าย และลูกค้าธุรกิจ (B2B) อื่น ๆ

ขอบคุณ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้หารือเกี่ยวกับความต้องการเครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดของคุณ

ติดต่อ RETRACTOR MAKER

อีเมล

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

เว็บไซต์

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ที่อยู่

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ติดตามเรา

LinkedIn | Facebook | Instagram | X (Twitter) | YouTube | Pinterest